




METROLOGIA Y SERVICIOS MYC S.A. DE C.V.
Isla Martinica # 2710, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco
Tel. 01 (33) 5009-2659 monse.cortes@mycmetrology.com.mx



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Calibration Certificate

Acreditación / Accreditation: 88795
Certificado / Certificate: L25-313

Orden de trabajo: **7002**
Work Order

Folio: **MYCA-07-2026-0001**
Certificate No.

Datos del usuario / User data

Atención / Attention: SUSANA HORIA
Empresa / Company: American Industries
Dirección / Address: Blvd. Puerta de Hierro No. 5200 Int. 7 Puerta de Hierro Business Center, Zapopan, Zapopan, Jalisco, 45116, Mexico

Instrumento a calibrar

Instrument under calibration

Instrumento: <u>Manometro</u>	Marca: <u>winters</u>	Ubicación: <u>Taller</u>
Instrument	Manufacturer	Ubicación
Intervalo: <u>0 - 200</u> psi	Div. Mínima: <u>0.01</u>	Lugar de calibración: <u>Laboratorio</u>
Interval	Resolution	Calibration location
No. de Serie: <u>2423424989</u>	Modelo: <u>ojin</u>	Unidades: <u>psi</u>
Serial No.	Model	Units
Identificación: <u>MAN-03</u>		
ID		
Fecha de recepción: <u>2026-07-20</u>	Fecha de calibración: <u>2026-07-20</u>	
Reception date	Calibration date	
Fecha de emisión: <u>2026-07-23</u>	Próxima calibración: <u>2027-07-20</u>	
Date of issue	Next calibration	

Instrumento de referencia

Reference instrument

Instrumento: <u>Calibrador de Manómetros</u>	Marca: <u>Ametek</u>	
Master	Manufacturer	<u>Hahnway</u>
Intervalo: <u>0 - 200 psi</u>	Div. Mínima: <u>0.1</u> psi	
interval	Resolution	<u>0.001</u> psi
No. de Serie Celda: <u>No disponible</u>	Modelo: <u>No disponible</u>	
Serial Number Cell	Model	<u>Beta gauge II</u>
Identificación: <u>PRESS-06</u>	Vigencia: <u>2027-12-05</u>	
ID	Next calibration date	<u>2027-12-05</u>
No. de Certificado: <u>IBC-C-P-0675-2025</u>	Incertidumbre: <u>0.32</u> psi	
Certificate No.	Uncertainty	<u>0.020</u> psi

Condiciones ambientales

Environmental conditions

Humedad relativa: <u>20.0%</u>	Temperatura Inicio: <u>20.1 °C</u>	Temperatura final: <u>20.4 °C</u>
Relative humidity	Initial temperature	Final temperature

Observaciones: Equipo en buen estado general
Observations
Procedimiento: PMP-01-01: Procedimiento para calibrar manómetros y vacuómetros
Procedure
Método: Comparación directa
Method

Norma: NMX-CH-003-SCFI vigente / NOM-013-SCFI-2004
Norm

Calibró Técnico / Calibrating Technician

Autorizó / Authorized

Miguel Angel Muñoz Torres

Miguel Felipe Ordaz Higareda



METROLOGIA Y SERVICIOS MYC S.A. DE C.V.
Isla Martinica # 2710, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco
Tel. 01 (33) 5009-2659 monse.cortes@mycmetrology.com.mx

Resultados de la calibración



Calibration Results

Folio: MYCA-07-2026-0001

Certificate No.

Unidades: psi
Units

Valores Medidos IBC / Measured values of the IBC	Valores Medidos Patrón / Measured values of the Standard			Error de indicación / Indication error	Incertidumbre [psi] ± Uncertainty [psi] ±
	Ascendente / Upward	Descendente / Falling	Ascendente / Upward		
10	10.0	10.0	10.0	0.01	0.34
20	20.1	20.1	20.1	0.07	0.34
30	30.1	30.1	30.1	0.09	0.3
40	40.1	40.1	40.1	0.08	0.34
50	50.1	50.1	50.1	0.08	0.34

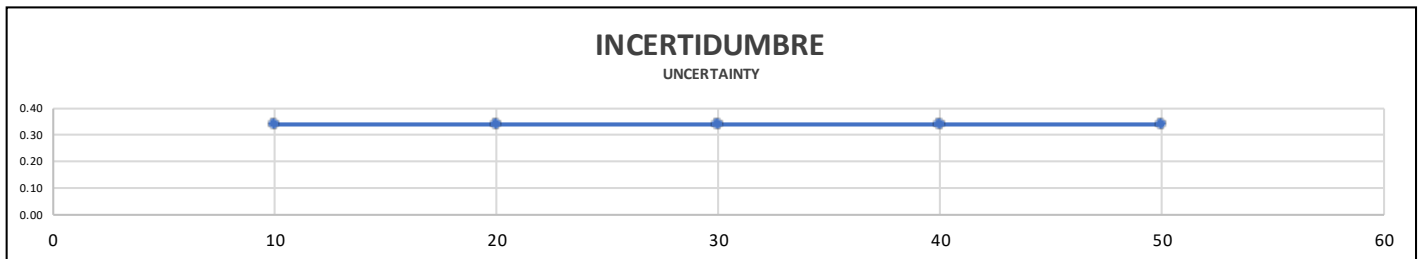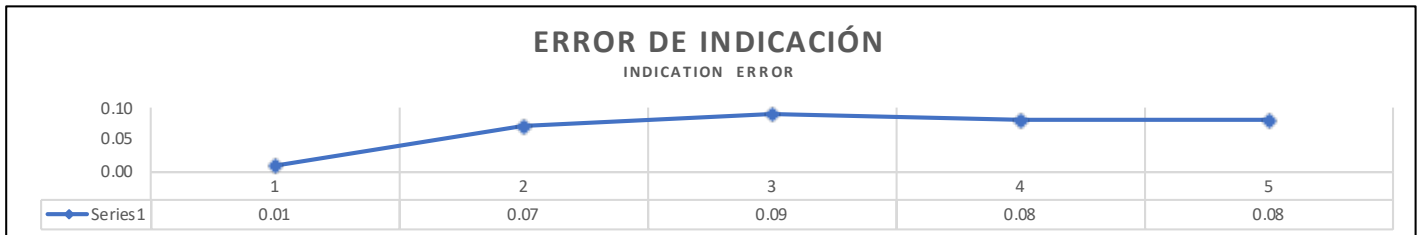

Observaciones / Observations

- El presente certificado ampara sólo los resultados y mediciones reportados en el mismo, únicamente tiene validez en su forma original y se prohíbe la reproducción del mismo sin el consentimiento por parte de este laboratorio.
- Los resultados de la calibración emitidos son trazables al sistema internacional de unidades (SI)
- La calibración fue realizada bajo procedimientos internos, elaborados en referencia a normas nacionales e internacionales asegurando su calidad y funcionamiento.
- La incertidumbre de la medición se reporta como una incertidumbre expandida con un factor de cobertura $K=2$ (95.45%), calculada en base a la guía NMX-CH-140-INMC-2002.
- Este informe fue elaborado por Metrología y Servicios MYC S.A. de C.V.
- Vigencia acordada con el cliente.
- This certificate covers only the results and measurements reported in it, it is only valid in its original form and its reproduction is prohibited without their consent.
- The calibration results issued are traceable to the international system of units (SI)
- The calibration was carried out under internal procedures, elaborated reference to national and international standards, ensuring its quality and functioning.
- The uncertainty of the measurement is reported as an expanded uncertainty with a coverage factor of $K=2$ (95.45 %), calculated based on the guide NMX-CH-140-INMC-2002.
- This report was prepared by Metrología y Servicios MYC S.A. de C.V.
- Validity agreed with the client.

Fin del certificado
End of the Certificate



METROLOGIA Y SERVICIOS MYC S.A. DE C.V.

Isla Martinica # 2710, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco

Tel. 01 (33) 5009-2659 monse.cortes@mycmetrology.com.mx

Carta de Trazabilidad

Traceability letter

**Sistema Internacional de Unidades
(SI)**



CENAM

National Institute of Metrology

- National Pressure master
- CNM-PNM 19



IBC

Modulo de temperatura

- Identificación: IBC-014
Marca: fluke
Modelo: PV350
Serie: 4904070
- Certificado: 1-17017



Metrologia y Servicios MYC S.A. de C.V.

Pressure cell hathaway beta gauge II

- Marca: Hathaway, Ametek
- Modelo: Betaport-P
- Serial: P612109
- ID: PRESS-02 y PRESS-06
- Certificado: IBC-C-P-0675-2025, 0676-2025
- Incertidumbre: ± 0.02 psi, $y \pm 0.32$ psi



Usuario Final