

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Calibration Certificate

Acreditación / Accreditation: 88795

Certificado / Certificate: L25-313

Orden de trabajo: **7004**

Work order

Folio: **MYCA-07-2026-0002**

Certificate No.

Datos del usuario / User data

Atención / Attention: susana horia

Empresa / Company: LEONARDO AGUILAR LERMA

Dirección / Address: ANDADOR CUERVO, 1442, MORELOS, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, 44910, Mexico

Instrumento a calibrar

Instrument under calibration

Instrumento: termometro
Instrument

Intervalo: 0 -150 °C
Interval

No. de Serie: uhbubu
Serial No.

Identificación: ubuhb
ID

Marca: ihubub
Manufacturer

Div. Mínima: 0.01 °C
Resolution

Modelo: buhbubu
Model

Lugar de Calibración: myc
Calibration Location

Tipo: K
Type

Fecha de recepción: 2026-07-28
Reception date

Fecha en emisión: 2026-07-24
Date of issue

Fecha de calibración: 2026-07-21
Calibration date

Próxima calibración: 2027-07-21
Next calibration

Instrumento de referencia

Reference instrument

Instrumento: Medidor con sensor RTD (TLD)
Master

Intervalo: -200 a 500 °C
interval

No. de Serie: 230099163
Serial Number

Identificación: TEM-06
ID

No. de Certificado: IBC-C-T-0681-2025
Certificate No.

Medio Isotermo: Jofra / 912353 / Cert: IBC-C-E-0679-2025 / ID: TEM-03.

Marca: Traceable

Div. Mínima: 0.001 °C
Resolution

Modelo: 38CZ59
Model

Vigencia: 2027-12-05
Next calibration date

Incertidumbre: 1.5°C
Uncertainty

Condiciones ambientales

Environmental conditions

Humedad relativa: 64.0%
Relative humidity

Temperatura Inicio: 20.1 °C
Initial temperature

Temperatura final: 20.1 °C
Final temperature

Observaciones: Equipo en buen estado general
Observations
Equipment in good general condition

Procedimiento: PMT-02: Procedimiento de calibración de temperatura lectura directa.
Procedure
PMT-02: Procedure for calibration of temperature meters

Método: Comparación directa
Method
Direct comparison

Norma: NMX-CH-70-1993-SCFT
Norm

Calibró Técnico / Calibrating Technician

Autorizó / Authorized

Miguel Ángel Muñoz Torres

Miguel Felipe Ordaz Higareda



Resultados de la calibración

Calibration Results



Folio: **MYCA-07-2026-0002**

Certificate No.

Unidades: **°C**

Units

Valor Nominal Nominal value	Valores Medidos / Measured values		Sesgo Instrumental	Incertidumbre [°C] ± Uncertainty [°C] ±
	PATRON	IBC		
50	50.000	50.4	0.40	0.74
75	75.000	75.3	0.30	0.74
100	100.000	100.8	0.80	0.75
150	150.000	151.2	1.20	0.74
200	200.000	202.6	2.60	0.74
220	220.000	222.90	2.90	0.74

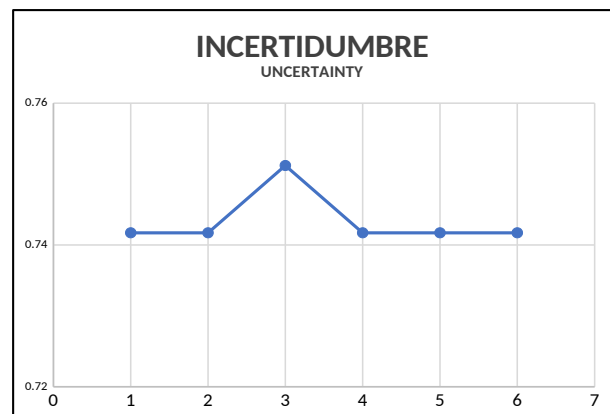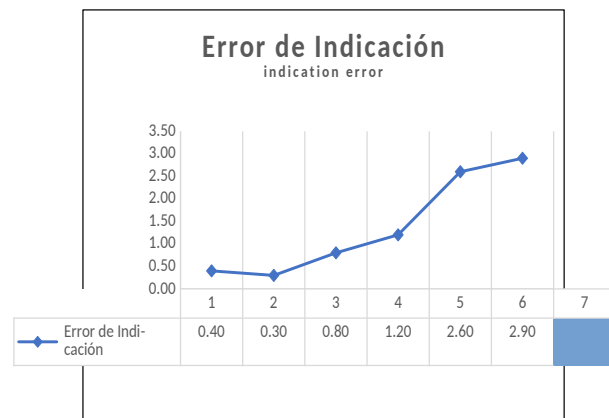

Observaciones / Observations

- El presente certificado ampara sólo los resultados y mediciones reportados en el mismo, únicamente tiene validez en su forma original y se prohíbe la reproducción del mismo sin el consentimiento por parte de este laboratorio.
 - Los resultados de la calibración emitidos son trazables al sistema internacional de unidades (SI)
 - La calibración fue realizada bajo procedimientos internos, elaborados en referencia a normas nacionales e internacionales asegurando su calidad y funcionamiento.
 - La incertidumbre de la medición se reporta como una incertidumbre expandida con un factor de cobertura K=2 (95.45%), calculada en base a la guía NMX-CH-140-INMC-2002.
 - Este informe fue elaborado por Metrología y Servicios MYC S.A. de C.V.
 - Vigencia acordada con el cliente.
-
- This certificate covers only the results and measurements reported in it, it is only valid in its original form and its reproduction is prohibited without their consent.
 - The calibration results issued are traceable to the international system of units (SI)
 - The calibration was carried out under internal procedures, elaborated reference to national and international standards, ensuring its quality and functioning.
 - The uncertainty of the measurement is reported as an expanded uncertainty with a coverage factor of K=2 (95.45 %), calculated based on the guide NMX-CH-140-INMC-2002.
 - This report was prepared by Metrología y Servicios MYC S.A. de C.V.
 - Validity agreed with the client.

Fin del certificado

End of the Certificate



METROLOGIA Y SERVICIOS MYC S.A. DE C.V.
Isla Martinica # 2710, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco
Tel. 01 (33) 5009-2659 monse.cortes@mycmetrology.com.mx

Carta de Trazabilidad
Traceability letter

**Sistema Internacional de Unidades
(SI)**



IBC

Calibrador de procesos
Identificación: IBC-011
Certificado: CMX24-1668
Marca: Fluke
Modelo: 754
Serie: 2063003



Metrologia y Servicios MYC S.A. de C.V.

Medidor de temperatura con sensor tipo RTD
Ma: Jofra, Mo: 650 SE, ID: TEM-03
UE: 0.11 °C
Cer: IBC-C-E-0679-2025



Usuario final