



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Calibration Certificate

Acreditación / Accreditation: 88795

Certificado / Certificate: L25-313

Orden de trabajo: **7004**

Work order

Folio: **MYCA-07-2026-0002**

Certificate No.

Datos del usuario / User data

Atención / Attention: susana horia
Empresa / Company: LEONARDO AGUILAR LERMA
Dirección / Address: ANDADOR CUERVO, 1442, MORELOS, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, 44910, Mexico

Instrumento a calibrar

Instrument under calibration

Instrumento: Instrument	termometro	Marca: ihubub Manufacturer	
Intervalo: Interval	0 -150 °C °C	Div. Mínima: Resolution	0.01 °C
No. de Serie: Serial No.	uhbubu	Modelo: Model	buhbubb
Identificación: ID	ubuhb	Lugar de Calibración: Calibration Location	myc
		Tipo: Type	K

Fecha de recepción:
Reception date

2026-07-28

Fecha de calibración:
Calibration date

2026-07-21

Fecha en emisión:
Date of issue

2026-07-24

Próxima calibración:
Next calibration

2027-07-21

Instrumento de referencia

Reference instrument

Instrumento: Master	<u>Medidor con sensor RTD (TLD)</u>	Marca: Manufacturer	<u>Traceable</u>
Intervalo: interval	<u>-200 a 500 °C</u>	Div. Mínima: Resolution	0.001 °C
No. de Serie: Serial Number	<u>230099163</u>	Modelo: Model	<u>38CZ59</u>
Identificación: ID	<u>TEM-06</u>	Vigencia: Next calibration date	<u>2027-12-05</u>
No. de Certificado: Certificate No.	<u>IBC-C-T-0681-2025</u>	Incertidumbre: Uncertainty	<u>1.5°C</u>
Medio Isotermo: <u>Jofra / 912353 / Cert: IBC-C-E-0679-2025/ ID: TEM-03.</u>			

Condiciones ambientales

Environmental conditions

Humedad relativa: Relative humidity	64.0%	Temperatura Inicio: Initial temperature	20.1 °C	Temperatura final: Final temperature	20.1 °C
--	-------	--	---------	---	---------

Observaciones:
Observations

Equipo en buen estado general
Equipment in good general condition

Procedimiento:
Procedure

PMT-02: Procedimiento de calibración de temperatura lectura directa.
PMT-02: Procedure for calibration of temperature meters

Método:
Method

Comparación directa
Direct comparison

Norma:
Norm

NMX-CH-70-1993-SCFT

Calibró Técnico / Calibrating Technician

Autorizó / Authorized

Miguel Ángel Muñoz Torres

Miguel Felipe Ordaz Higareda



Resultados de la calibración

Calibration Results



Folio: **MYCA-07-2026-0002**

Certificate No.

Unidades: **°C**

Units

Valor Nominal Nominal value	Valores Medidos / Measured values		Sesgo Instrumental	Incertidumbre [°C] ± Uncertainty [°C] ±
	PATRON	IBC		
50	50.000	50.4	0.40	0.74
75	75.000	75.3	0.30	0.74
100	100.000	100.8	0.80	0.75
150	150.000	151.2	1.20	0.74
200	200.000	202.6	2.60	0.74
220	220.000	222.90	2.90	0.74

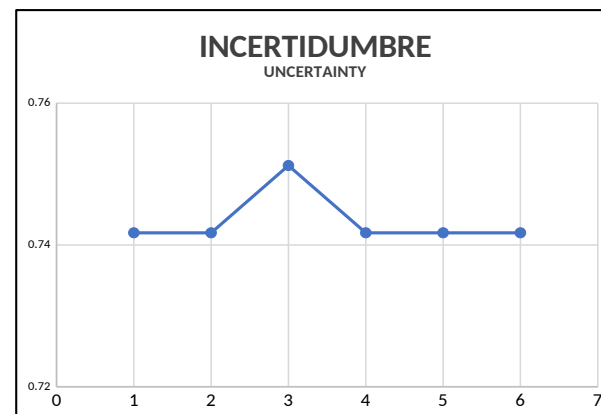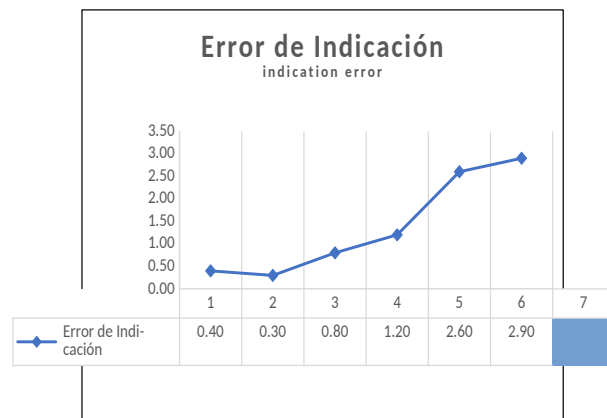

Observaciones / Observations

- El presente certificado ampara sólo los resultados y mediciones reportados en el mismo, únicamente tiene validez en su forma original y se prohíbe la reproducción del mismo sin el consentimiento por parte de este laboratorio.
- Los resultados de la calibración emitidos son trazables al sistema internacional de unidades (SI)
- La calibración fue realizada bajo procedimientos internos, elaborados en referencia a normas nacionales e internacionales asegurando su calidad y funcionamiento.
- La incertidumbre de la medición se reporta como una incertidumbre expandida con un factor de cobertura K=2 (95.45%), calculada en base a la guía NMX-CH-140-INMC-2002.
- Este informe fue elaborado por Metrología y Servicios MYC S.A. de C.V.
- Vigencia acordada con el cliente.
- This certificate covers only the results and measurements reported in it, it is only valid in its original form and its reproduction is prohibited without their consent.
- The calibration results issued are traceable to the international system of units (SI)
- The calibration was carried out under internal procedures, elaborated reference to national and international standards, ensuring its quality and functioning.
- The uncertainty of the measurement is reported as an expanded uncertainty with a coverage factor of K=2 (95.45 %), calculated based on the guide NMX-CH-140-INMC-2002.
- This report was prepared by Metrología y Servicios MYC S.A. de C.V.
- Validity agreed with the client.

Fin del certificado

End of the Certificate






METROLOGIA Y SERVICIOS MYC S.A. DE C.V.

Isla Martinica # 2710, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco

Tel. 01 (33) 5009-2659 monse.cortes@mycmetrology.com.mx

Carta de Trazabilidad
Traceability letter

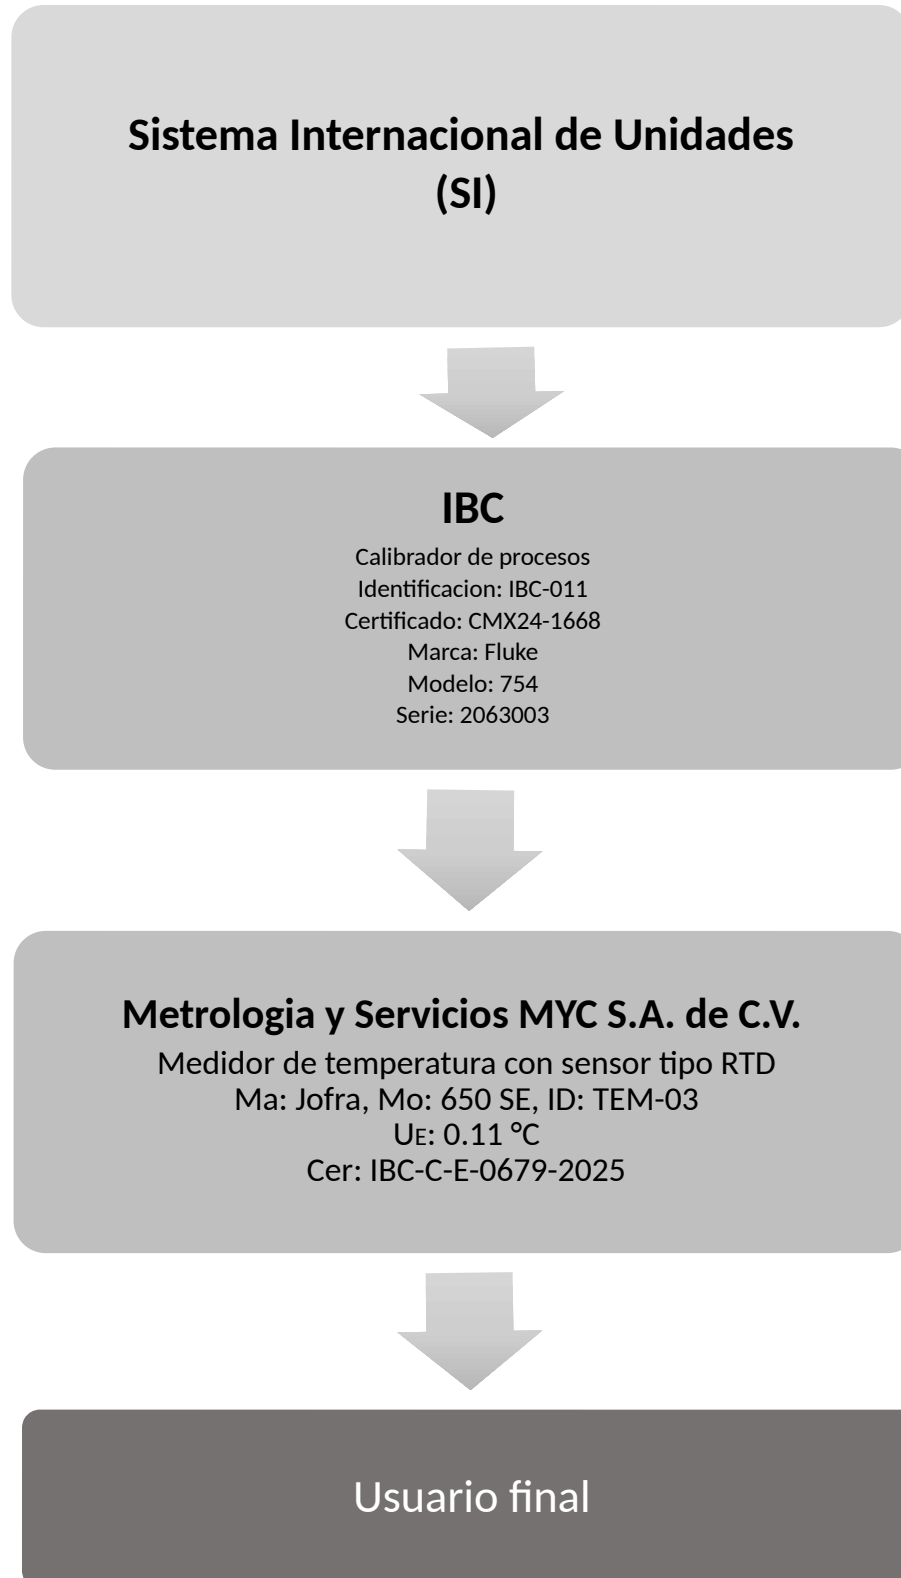

CERTIFICADO AUTENTICADO
MYC SYSTEM



MYC-AUTH-21025-00002