



METROLOGIA Y SERVICIOS MYC S.A. DE C.V.
Isla Martinica # 2710, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco
Tel. 01 (33) 5009-2659 monse.cortes@mycmetrology.com.mx



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Calibration Certificate

Acreditación / Accreditation: 88795
Certificado / Certificate: L25-313

Orden de trabajo: **6100**

Folio: **MYCA-01-26-3281**

Work order

Certificate No.

Datos del usuario / User data

Atención / Attention: Alejandra Soto
Empresa / Company: NBF Foods
Dirección / Address: Av. Jalisco 1924 Bodega 26, Col. San Francisco, C.P.45200, Tesisan, Jalisco

Instrumento a calibrar

Instrument under calibration

Instrumento: Instrument	<u>Termometro de caratula</u>	Marca: Manufacturer	<u>Instrutek</u>
Intervalo: Interval	<u>-20 a 120</u> °C	Div. Mínima: Resolution	<u>2</u> °C
No. de Serie: Serial No.	<u>No disponible</u>	Modelo: Model	<u>No disponible</u>
Identificación: ID	<u>TE-NBF-10</u>	Lugar de Calibración: Calibration Location	<u>Instalaciones del cliente</u>
		Tipo: Type	<u>K</u>

Fecha de recepción: 2026-01-26
Reception date
Fecha en emisión: 2026-01-29
Date of issue

Fecha de calibración: 2026-01-26
Calibration date
Próxima calibración: 2027-01-26
Next calibration

Instrumento de referencia

Reference instrument

Instrumento: Master	<u>Medidor con sensor RTD (TLD)</u>	Marca: Manufacturer	<u>Traceable</u>
Intervalo: interval	<u>-200 a 500 °C</u>	Div. Mínima: Resolution	<u>0.001</u> °C
No. de Serie: Serial Number	<u>230099163</u>	Modelo: Model	<u>38CZ59</u>
Identificación: ID	<u>TEM-06</u>	Vigencia: Next calibration date	<u>2027-12-05</u>
No. de Certificado: Certificate No.	<u>IBC-C-T-0681-2025</u>	Incertidumbre: Uncertainty	<u>1.5°C</u>
Medio Isotermo: <u>Jofra / 912353 / Cert: IBC-C-E-0679-2025/ ID: TEM-03.</u>			

Condiciones ambientales

Environmental conditions

Humedad relativa: Relative humidity	<u>45.9%</u>	Temperatura Inicio: Initial temperature	<u>22.6 °C</u>	Temperatura final: Final temperature	<u>22.6 °C</u>
--	--------------	--	----------------	---	----------------

Observaciones: Equipo en buen estado general/Vidrio de cristal de la caratula está estrellado.
Observations: Equipment in good general condition/The crystal glass of the dial is cracked.

Procedimiento: PMT-02: Procedimiento de calibración de temperatura lectura directa.
Procedure: PMT-02: Procedure for calibration of temperature meters

Método: Comparación directa
Method: Direct comparison

Norma: NMX-CH-70-1993-SCFT
Norm:

Calibró Técnico / Calibrating Technician

Autorizó / Authorized



CERTIFICADO AUTENTICADO

MYC SYSTEM

Código: MYC-AUTH-2026-000001 | Folio: MYCT-06-2026-0001



MYC-AUTH-2026-000001



Resultados de la calibración

Calibration Results



Folio: **MYCA-01-26-3281**

Certificate No.

Unidades: **°C**

Units

Valor Nominal Nominal value	Valores Medidos / Measured values		Sesgo Instrumental	Incertidumbre [°C] ± Uncertainty [°C] ±
	PATRON	IBC		
20	20.000	22.0	2.00	2.4
40	40.000	41.0	1.00	2.4
60	60.000	62.0	2.00	2.4
80	80.000	81.0	1.00	2.4
100	100.000	102.0	2.00	2.4

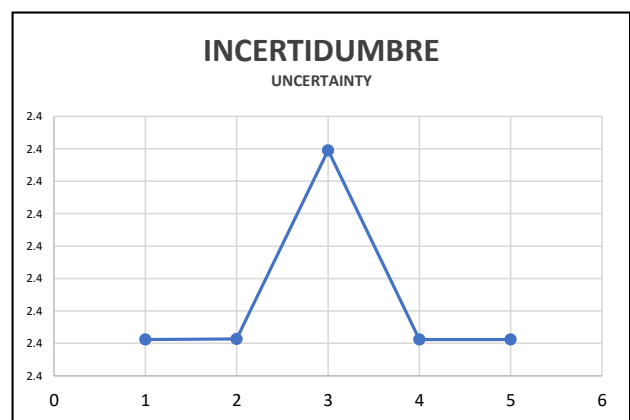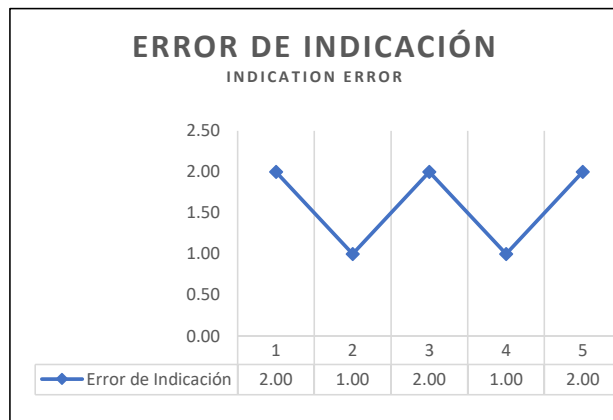

Observaciones / Observations

- El presente certificado ampara sólo los resultados y mediciones reportados en el mismo, únicamente tiene validez en su forma original y se prohíbe la reproducción del mismo sin el consentimiento por parte de este laboratorio.
 - Los resultados de la calibración emitidos son trazables al sistema internacional de unidades (SI)
 - La calibración fue realizada bajo procedimientos internos, elaborados en referencia a normas nacionales e internacionales asegurando su calidad y funcionamiento.
 - La incertidumbre de la medición se reporta como una incertidumbre expandida con un factor de cobertura K=2 (95.45%), calculada en base a la guía NMX-CH-140-INMC-2002.
 - Este informe fue elaborado por Metrología y Servicios MYC S.A. de C.V.
 - Vigencia acordada con el cliente.
-
- This certificate covers only the results and measurements reported in it, it is only valid in its original form and its reproduction is prohibited without their consent.
 - The calibration results issued are traceable to the international system of units (SI)
 - The calibration was carried out under internal procedures, elaborated reference to national and international standards, ensuring its quality and functioning.
 - The uncertainty of the measurement is reported as an expanded uncertainty with a coverage factor of K=2 (95.45 %), calculated based on the guide NMX-CH-140-INMC-2002.
 - This report was prepared by Metrología y Servicios MYC S.A. de C.V.
 - Validity agreed with the client.



CERTIFICADO AUTENTICADO

MYC SYSTEM

Código: MYC-AUTH-2026-000001 | Folio: MYCT-06-2026-0001



MYC-AUTH-2026-000001



METROLOGIA Y SERVICIOS MYC S.A. DE C.V.
Isla Martinica # 2710, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco
Tel. 01 (33) 5009-2659 monse.cortes@mycmetrology.com.mx

Carta de Trazabilidad

Traceability letter

Sistema Internacional de Unidades (SI)



IBC

Calibrador de procesos
Identificación: IBC-011
Certificado: CMX24-1668
Marca: Fluke
Modelo: 754
Serie: 2063003



Metrologia y Servicios MYC S.A. de C.V.

- Medidor de temperatura con sensor tipo RTD
 - Ma: Jofra, Mo: 650 SE, ID: TEM-03
 - UE: 0.11 °C
 - Cer: IBC-C-E-0679-2025



Usuario final



CERTIFICADO AUTENTICADO

MYC SYSTEM

Código: MYC-AUTH-2026-000001 | Folio: MYCT-06-2026-0001



MYC-AUTH-2026-000001