

**METROLOGIA Y SERVICIOS MYC S.A. DE CV.**

Isla Martinica # 2710, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco
Tel. 01 (33) 5009-2659 monse.cortes@mycmetrology.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Calibration Certificate

Orden de trabajo: 6023

Work Order

Folio: MYCT-12-25-1529

Certificate No.

Datos del usuario / User data**Atención/Attention:**Osmar Castro**Empresa / Company:**Casa Tradición**Dirección / Address:**Carretera Ocotlán-Tototlán, C.P.47746, Tototlán, Jalisco**Instrumento a calibrar***Instrument under calibration***Instrumento:**

Instrument

Medidor de cloro**Marca:**

Manufacturer

Hanna**Intervalo:**

Interval

0.00-2.50 ppm**Resolución:**

Resolution

0.01 ppm**No. de Serie:**

Serial No.

07450962211**Modelo:**

Model

H1701**Identificación:**

ID

MCL-CALC-01**Lugar de calibración:**

Calibration Location

MYC**Ubicación:**

Location:

No disponible

Fecha de recepción:

Reception date

2025-12-16**Fecha de calibración:**

Calibration date

2025-12-19**Fecha de emisión:**

Date of issue

2025-12-22**Próxima calibración:**

Next calibration

2026-12-19**Material de referencia****Material de referencia empleado:**

Reference material used

Marca: Brand**No de**

Lote: Lot

number

No de Parte:

Part Number

Vigencia:

Validity

Estandar de calibracion

Hanna

SC0372/25

NH70146

2028-10-03

Condiciones ambientales*Environmental conditions***Humedad relativa: 50.3%**

Relative humidity

Temperatura Inicio: 20.2 °C

Initial temperature

Temperatura final: 20.1 °C

Final temperature

Observaciones:

Observations

Equipo en buen estado general

Equipment in good general condition

Procedimiento:

Procedure

PCC-01: Procedimiento de calibración colorímetros**Método:**

Method

Comparación directa

Direct comparison

Norma:

Norm

ASTM D1544**Calibró Técnico / Calibrating Technician****Autorizó / Authorized**
Miguel Ángel Muñoz Torres
Miguel Felipe Ordaz Higareda





METROLOGIA Y SERVICIOS MYC S.A. DE C.V.
Isla Martinica # 2710, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco
Tel. 01 (33) 5009-2659 monse.cortes@mycmetrology.com.mx

Resultados de la calibración

Calibration Results

Folio: **MYCT-12-25-1529**
Certificate No.
Unidades: ppm
Units

Patrón Standar	Valores Medidos / Measured values IBC			Error de indicación Indication error	Incertidumbre $\pm$ Uncertainty $\pm$
	Primera First	Segunda Second	Tercera Third		
4	4	4	4	0.00	0.1
30	30	30	30	0.00	0.6

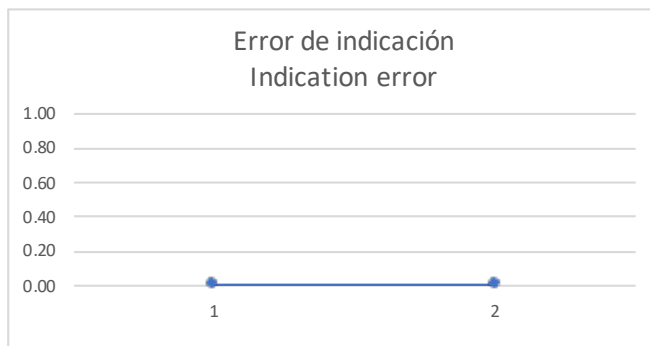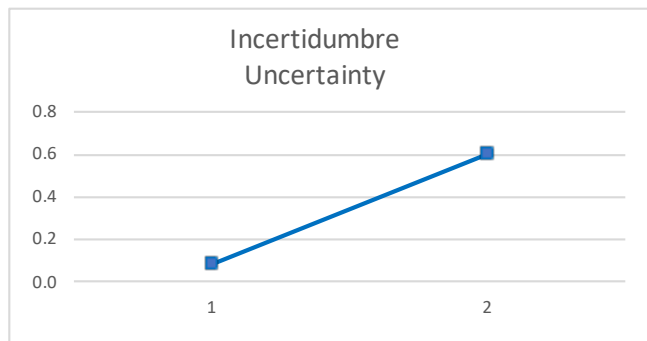

Observaciones / Observations

- El presente certificado ampara sólo los resultados y mediciones reportados en el mismo, únicamente tiene validez en su forma original y se prohíbe la reproducción del mismo sin el consentimiento por parte de este laboratorio.
- Los resultados de la calibración emitidos son trazables al sistema internacional de unidades (SI)
- La calibración fue realizada bajo procedimientos internos, elaborados en referencia a normas nacionales e internacionales asegurando su calidad y funcionamiento.
- La incertidumbre de la medición se reporta como una incertidumbre expandida con un factor de cobertura $K=2$ (95.45%), calculada en base a la guía NMX-CH-140-INMC-2002.
- Este informe fue elaborado por Metrología y Servicios MYC S.A. de C.V.
- Vigencia acordada con el cliente.

This certificate covers only the results and measurements reported in it, it is only valid in its original form and its reproduction is prohibited without their consent.

- The calibration results issued are traceable to the international system of units (SI)
- The calibration was carried out under internal procedures, elaborated reference to national and international standards, ensuring its quality and functioning.
- The uncertainty of the measurement is reported as an expanded uncertainty with a coverage factor of $K=2$ (95.45 %), calculated based on the guide NMX-CH-140-INMC-2002.
- This report was prepared by Metrología y Servicios MYC S.A. de C.V.
- Validity agreed with the client.

Fin del certificado

End of the Certificate