



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Calibration Certificate

Acreditación / Accreditation: 88795
Certificado / Certificate: L25-313

Orden de trabajo: **6115**

Work Order

Folio: **MYCA-01-26-3327**

Certificate No.

Datos del usuario / User data

Atención / Attention: Monica Robles
Empresa / Company: Jaloma
Dirección / Address: C. Aquiles Serdan #438, C.P.44360, Guadalajara, Jalisco

Instrumento a calibrar

Instrument under calibration

Instrumento: <u>Manometro</u>	Marca: <u>Norgren</u>	Ubicación: <u>Calidad (Validación)</u>
Instrument	Manufacturer	Ubication
Intervalo: <u>0-140</u> <u>psi</u>	Div. Mínima: <u>5</u>	Lugar de calibración: <u>In situ</u>
Interval	Resolution	Calibration location
No. de Serie: <u>No disponible</u>	Modelo: <u>No disponible</u>	Unidades: <u>psi</u>
Serial No.	Model	Units
Identificación: <u>MN-LVA-03</u>		
ID		

Fecha de recepción: 2026-02-06
Reception date
Fecha de emisión: 2026-02-07
Date of issue

Fecha de calibración: 2026-02-06
Calibration date
Próxima calibración: 2027-02
Next calibration

Instrumento de referencia

Reference instrument

Instrumento: <u>Calibrador de Manómetros</u>	Marca: <u>Ametek</u>
Master	Manufacturer
Intervalo: <u>0 - 200 psi</u>	Div. Mínima: <u>0.1</u> psi
interval	Resolution
No. de Serie Celda: <u>No disponible</u>	Modelo: <u>No disponible</u>
Serial Number Cell	Model
Identificación: <u>P610769</u>	Vigencia: <u>Beta gauge II</u>
ID	Next calibration date
No. de Certificado: <u>PRESS-06</u>	Incertidumbre: <u>2027-12-05</u>
Certificate No.	Uncertainty
	<u>0.32</u> psi
	<u>0.020</u> psi

Condiciones ambientales

Environmental conditions

Humedad relativa: 31.9% Temperatura Inicio: 21.2 °C Temperatura final: 21.6 °C
Relative humidity Initial temperature Final temperature

Observaciones: Equipo en buen estado general
Observations
Procedimiento: Equipment in good general condition
Procedure
Método: PMP-01-01: Procedimiento para calibrar manómetros y vacuómetros
Method
Método: PMP-01-01: Procedure to calibrate manometers and vacuum gauges
Method
Método: Comparación directa
Method
Método: Direct comparison

Norma: NMX-CH-003-SCFI vigente / NOM-013-SCFI-2004
Norm

Calibró Técnico / Calibrating Technician

Autorizó / Authorized

Miguel Angel Muñoz Torres

Miguel Felipe Ordaz Higareda





Resultados de la calibración

Calibration Results

Folio: **MYCA-01-26-3327**
Certificate No.

Unidades: **psi**
Units

Valores Medidos IBC Measured values of the IBC	Valores Medidos Patrón / Measured values of the Standard			Error de indicación Indication error	Incertidumbre [psi] ± Uncertainty [psi] ±
	Ascendente / Upward	Descendente / Falling	Ascendente / Upward		
10	10.46	10.33	10.28	0.36	5.8
40	40.29	40.31	40.78	0.46	5.8
80	80.12	80.63	80.93	0.56	5.8
110	110.66	110.71	110.91	0.76	5.8
140	140.71	140.52	140.69	0.64	5.8

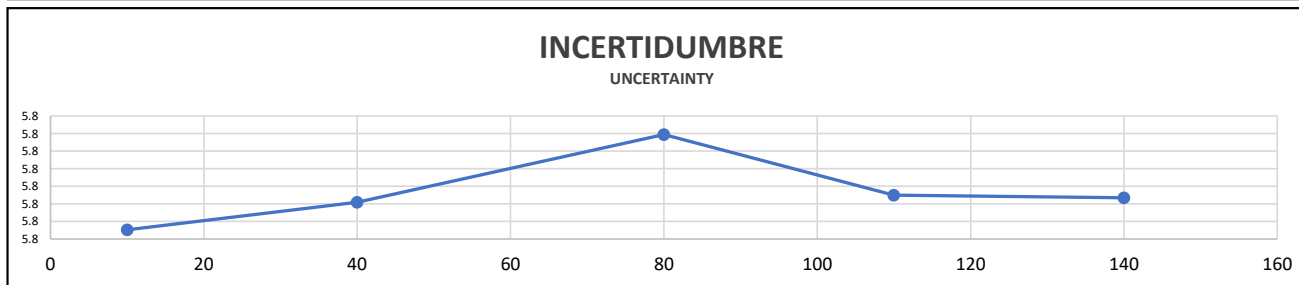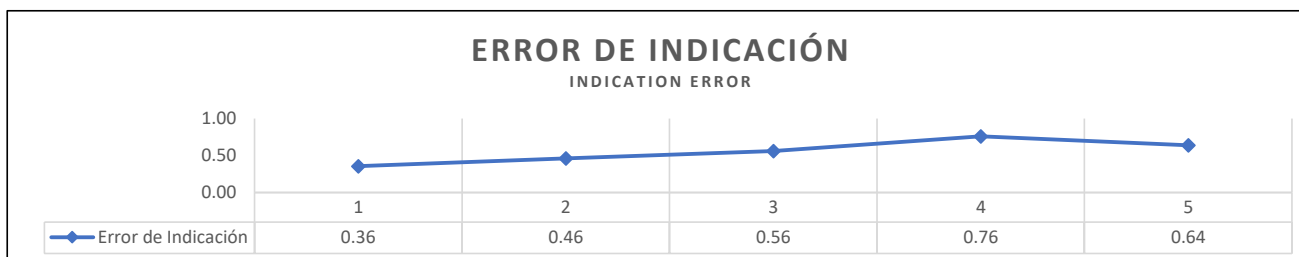

Observaciones / Observations

- El presente certificado ampara sólo los resultados y mediciones reportados en el mismo, únicamente tiene validez en su forma original y se prohíbe la reproducción del mismo sin el consentimiento por parte de este laboratorio.
- Los resultados de la calibración emitidos son trazables al sistema internacional de unidades (SI)
- La calibración fue realizada bajo procedimientos internos, elaborados en referencia a normas nacionales e internacionales asegurando su calidad y funcionamiento.
- La incertidumbre de la medición se reporta como una incertidumbre expandida con un factor de cobertura K=2 (95.45%), calculada en base a la guía NMX-CH-140-INMC-2002.
- Este informe fue elaborado por Metrología y Servicios MYC S.A. de C.V.
- Vigencia acordada con el cliente.
- This certificate covers only the results and measurements reported in it, it is only valid in its original form and its reproduction is prohibited without their consent.
- The calibration results issued are traceable to the international system of units (SI)
- The calibration was carried out under internal procedures, elaborated reference to national and international standards, ensuring its quality and functioning.
- The uncertainty of the measurement is reported as an expanded uncertainty with a coverage factor of K=2 (95.45 %), calculated based on the guide NMX-CH-140-INMC-2002.
- This report was prepared by Metrología y Servicios MYC S.A. de C.V.
- Validity agreed with the client.

Fin del certificado

End of the Certificate





Carta de Trazabilidad

Traceability letter



**Sistema Internacional
de Unidades
(SI)**



CENAM
National Institute of Metrology

- National Pressure master
- CNM-PNM 19



IBC
Modulo de temperatura

- Identificación: IBC-014
 - Marca: fluke
 - Modelo: PV350
 - Serie: 4904070
- Certificado: 1-17017



Metrologia y Servicios MYC S.A. de C.V.
Pressure cell hathaway beta gauge II

- Marca: Hathaway, Ametek
 - Modelo: Betaport-P
 - Serial: P612109
- ID: PRESS-02 y PRESS-06
- Certificado: IBC-C-P-0675-2025, 0676-2025
- Incertidumbre: ± 0.02 psi, y ± 0.32 psi



Usuario Final

