



Resultados de la calibración

Calibration Results

Folio: **MYCA-01-26-3277**

Certificate No.


Unidades: **psi**

Units

Valores Medidos IBC Measured values of the IBC	Valores Medidos Patrón / Measured values of the Standard			Error de indicación Indication error	Incertidumbre [psi] ± Uncertainty [psi] ±
	Ascendente / Upward	Descendente / Falling	Ascendente / Upward		
10	10.21	9.602	10.21	0.01	2.4
20	20.38	19.95	20.49	0.27	2.4
30	30.49	29.35	30.16	0.00	2.5
40	40.6	39.86	40.33	0.27	2.4
50	50.33	49.26	50.27	-0.05	2.5
60	59.81	59.24	60.62	-0.11	2.5
70	60.44	70.53	70.16	-2.96	7.0
80	80.18	80.03	79.56	-0.08	2.4
90	90.85	90.71	89.34	0.30	2.5
100	100.1	99.85	99.59	-0.15	2.4
110	110.7	110.3	110.8	0.60	2.4


ERROR DE INDICACIÓN

INDICATION ERROR

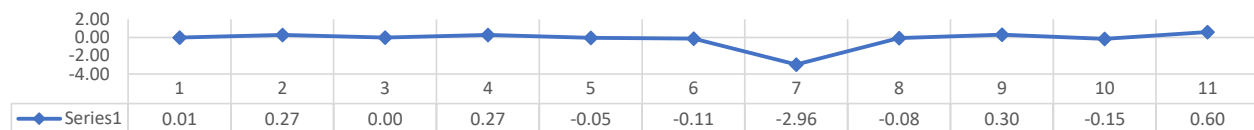

INCERTIDUMBRE

UNCERTAINTY

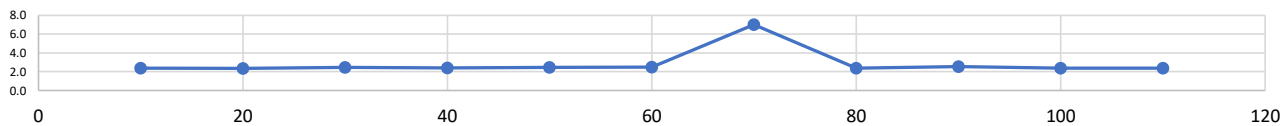

Observaciones / Observations

- El presente certificado ampara sólo los resultados y mediciones reportados en el mismo, únicamente tiene validez en su forma original y se prohíbe la reproducción del mismo sin el consentimiento por parte de este laboratorio.
- Los resultados de la calibración emitidos son trazables al sistema internacional de unidades (SI)
- La calibración fue realizada bajo procedimientos internos, elaborados en referencia a normas nacionales e internacionales asegurando su calidad y funcionamiento.
- La incertidumbre de la medición se reporta como una incertidumbre expandida con un factor de cobertura K=2 (95.45%), calculada en base a la guía NMX-CH-140-INMC-2002.
- Este informe fue elaborado por Metrología y Servicios MYC S.A. de C.V.
- Vigencia acordada con el cliente.
- This certificate covers only the results and measurements reported in it, it is only valid in its original form and its reproduction is prohibited without their consent.
- The calibration results issued are traceable to the international system of units (SI)
- The calibration was carried out under internal procedures, elaborated reference to national and international standards, ensuring its quality and functioning.
- The uncertainty of the measurement is reported as an expanded uncertainty with a coverage factor of K=2 (95.45 %), calculated based on the guide NMX-CH-140-INMC-2002.
- This report was prepared by Metrología y Servicios MYC S.A. de C.V.



CERTIFICADO AUTENTICADO

MYC SYSTEM

Código: MYC-AUTH-2026-000006 | Folio: MYCT-06-2026-0006



MYC-AUTH-2026-000006



METROLOGIA Y SERVICIOS MYC S.A. DE C.V.

Isla Martinica # 2710, Col. Jardines de la Cruz, C.P. 44950 Guadalajara, Jalisco

Tel. 01 (33) 5009-2659 monse.cortes@mycmetrology.com.mx

Carta de Trazabilidad

Traceability letter

**Sistema Internacional
de Unidades
(SI)**

CENAM

National Institute of Metrology

- National Pressure master
- CNM-PNM 19

IBC

Modulo de temperatura

- Identificación: IBC-014
Marca: fluke
Modelo: PV350
Serie: 4904070
- Certificado: 1-17017

Metrologia y Servicios MYC S.A. de C.V.

Pressure cell hathaway beta gauge II

- Marca: Hathaway, Ametek
- Modelo: Betaport-P
- Serial: P612109
- ID: PRESS-02 y PRESS-06
- Certificado: IBC-C-P-0675-2025 Y 0676-2025
- Incertidumbre: ± 0.02 psi, y ± 0.32 psi

Usuario Final



CERTIFICADO AUTENTICADO

MYC SYSTEM

Código: MYC-AUTH-2026-000006 | Folio: MYCT-06-2026-0006



MYC-AUTH-2026-000006