

STO at 0.3 mm: **97.57**

STR at 97.6 (°C): **0.3**

STR Max at 101 (°C): **0.58**

Rate [°C]/Min: **1**

Hyst. at 3 mm: **UP110.26[°C]**


Operator: **Igor 0.**

Huber ID : **305**

Type : **Thermostat**

P/N: **Stamp**

2019-08-05 08-16-45 IGI test wax 911011 batch 1960156 #34 Chart-1

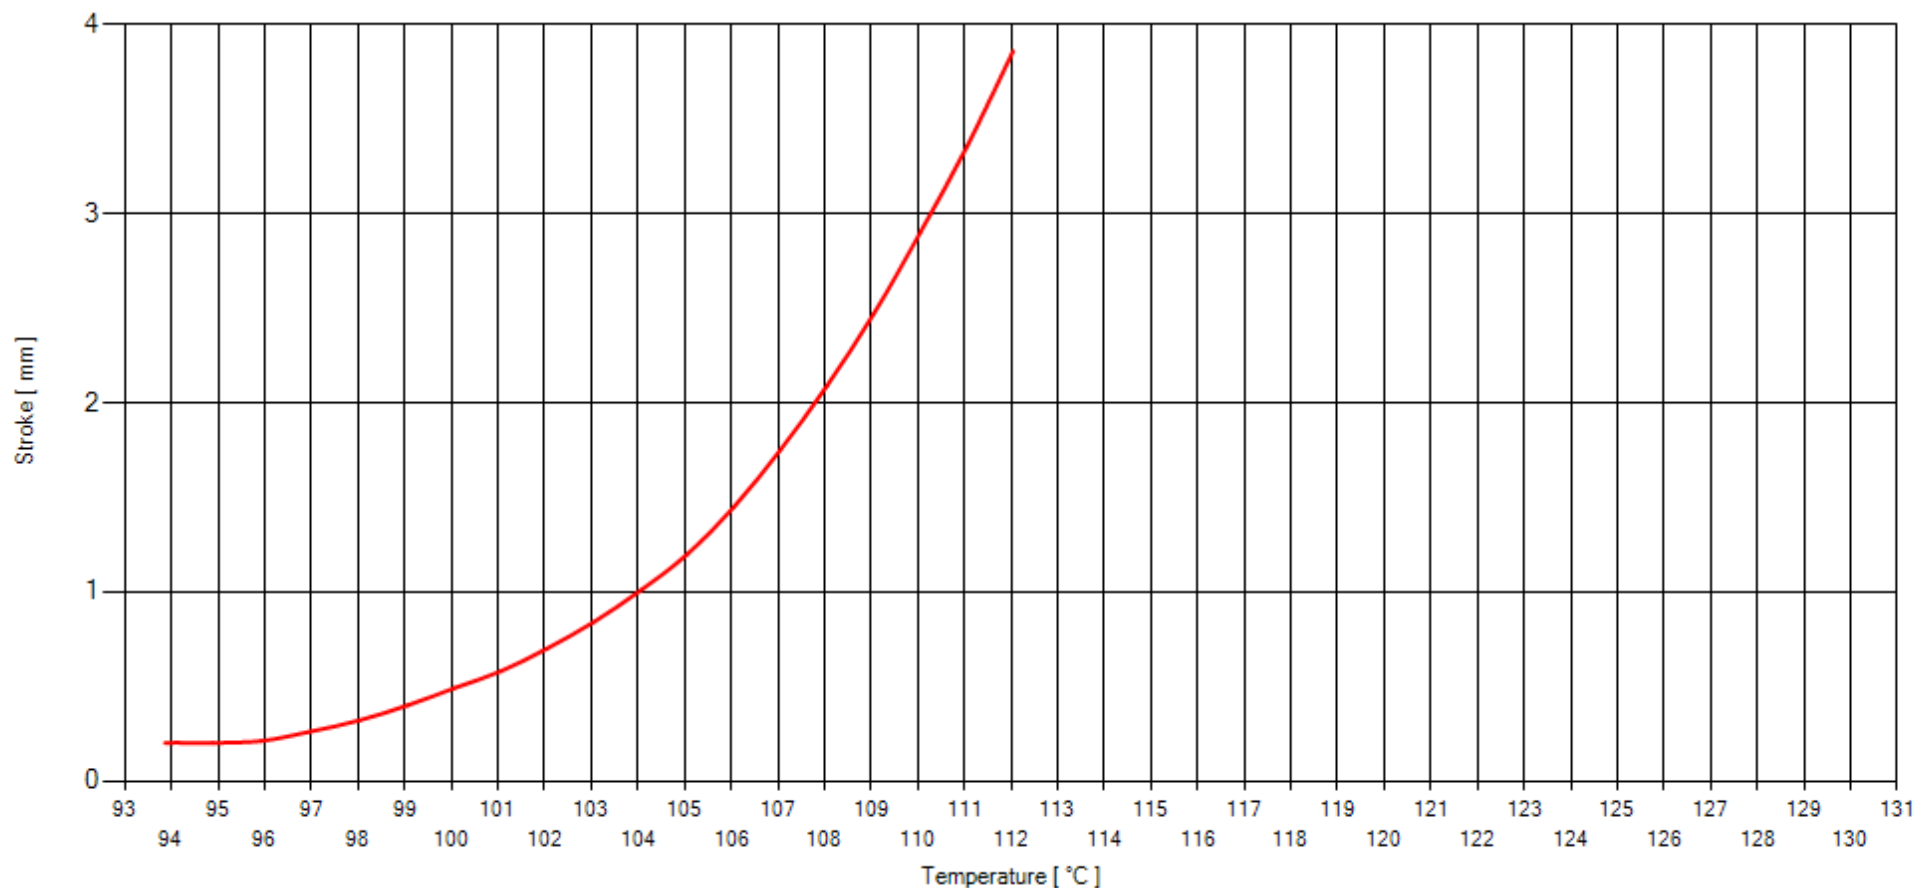

Start Temperature [°C]: **94**

STR 2 at T: **str**

End Temperature [°C]: **131**

Date Time