Sample #2

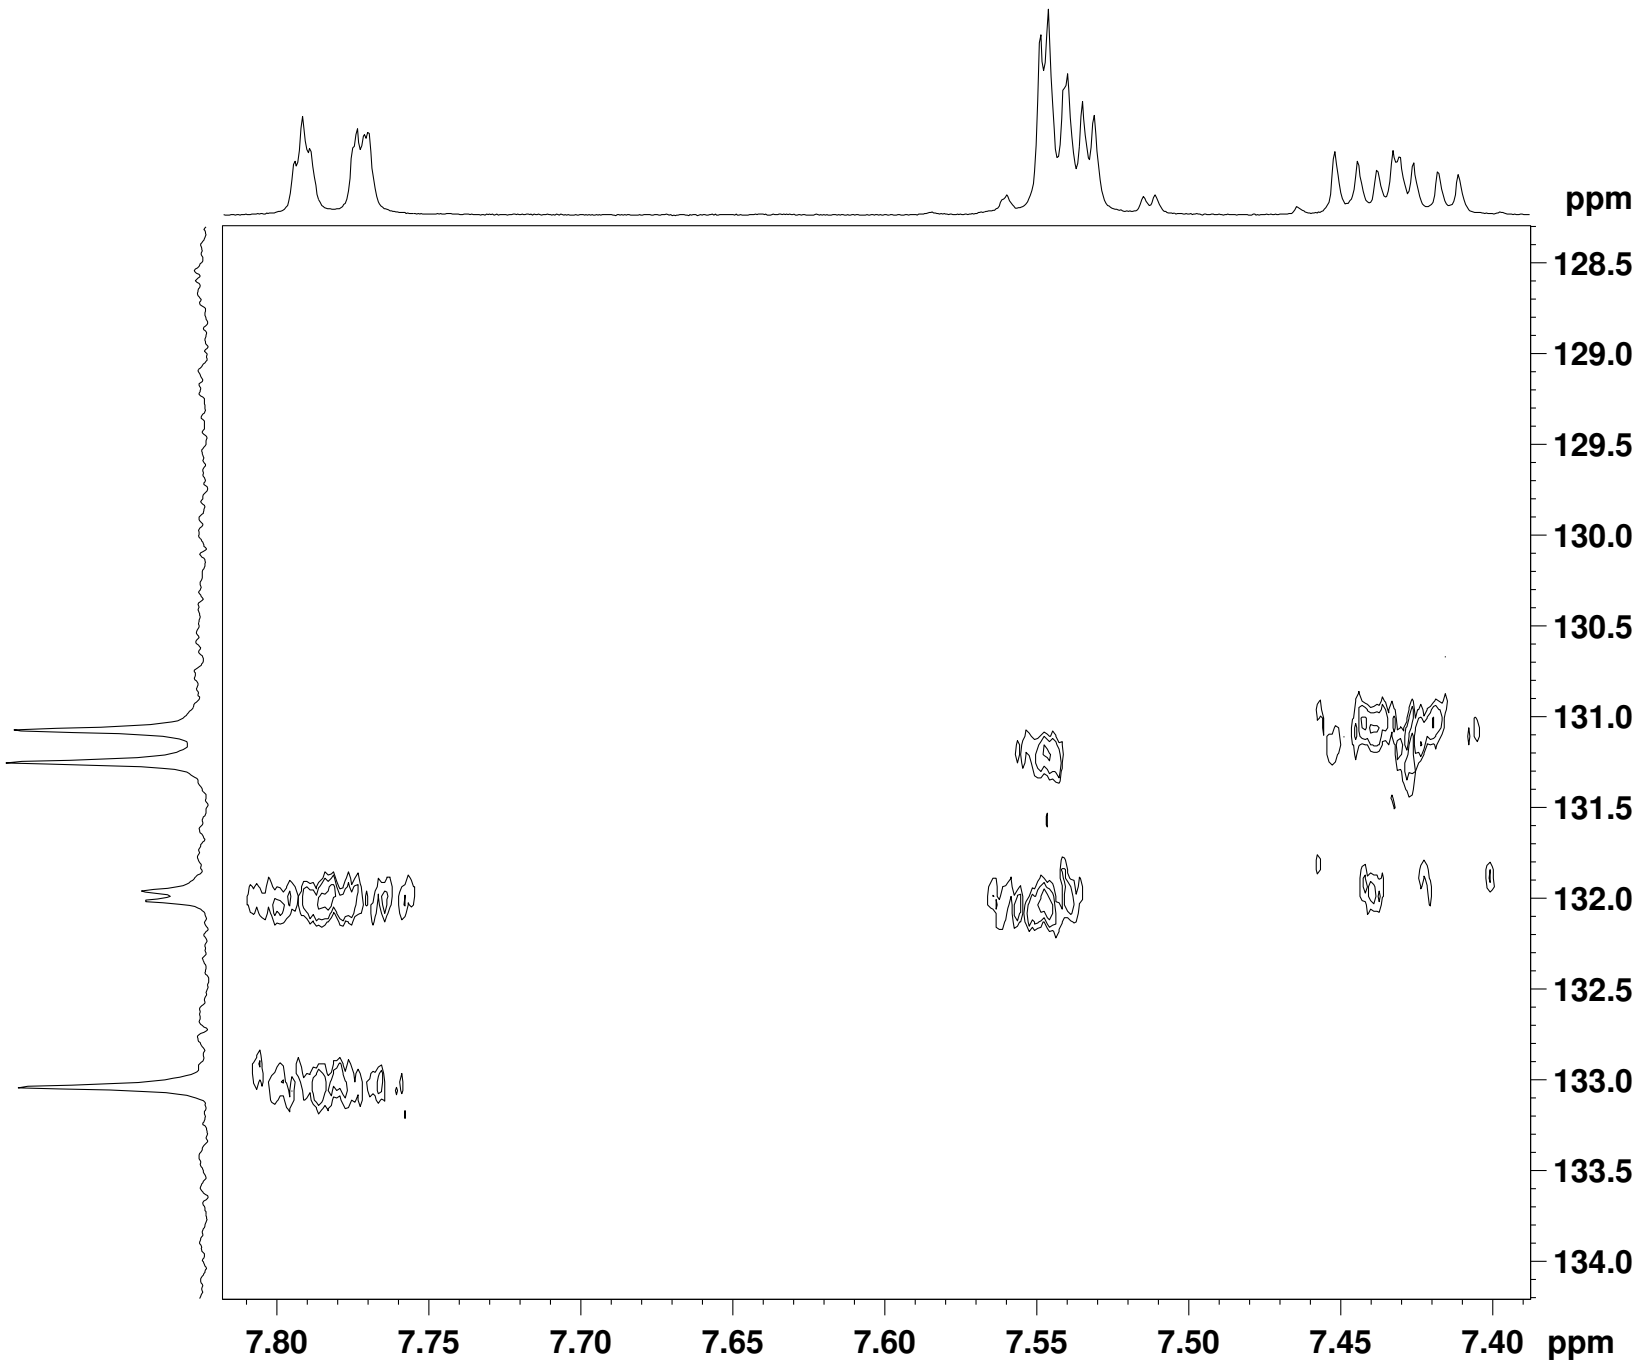

NAME	Un_02
EXPNO	5
PROCNO	1
Date_	20110331
Time	10.58
INSTRUM	DPX400
PROBHD	5 mm BBO BB-1H
PULPROG	hmbcetgpl2nd
TD	2048
SOLVENT	CDCl3
NS	4
DS	16
SWH	801.282 Hz
FIDRES	0.391251 Hz
AQ	1.2780020 sec
RG	16384
DW	624.000 usec
DE	6.00 usec
TE	298.2 K
CNST6	145.0000000
CNST7	160.0000000
CNST13	8.0000000
CNST30	0.5981017
d0	0.00000300 sec
D1	2.00000000 sec
d6	0.06250000 sec
D16	0.00025000 sec
DELTA1	0.00219828 sec
DELTA2	0.00187500 sec
DELTA3	0.06124600 sec
DELTA4	0.00003300 sec
IN0	0.00009935 sec
ST1CNT	0
======== CHANNEL f1 ========	
NUC1	1H
P1	13.50 usec
p2	27.00 usec
PL1	-3.00 dB
SFO1	400.2480018 MHz
======== CHANNEL f2 ========	
NUC2	13C
P3	7.00 usec
P24	2000.00 usec
PL2	-3.00 dB
SFO2	100.6562780 MHz
SP7	12.00 dB
SPNAM7	Crp80comp.4
SPOAL7	0.500
SPOFFS7	0.00 Hz
====== GRADIENT CHANNEL =====	
GPNAM1	SINE.100
GPNAM3	SINE.100
GPNAM4	SINE.100
GPNAM5	SINE.100
GPZ1	80.00 %
GPZ3	15.00 %
GPZ4	-10.00 %
GPZ5	-5.00 %
P16	1000.00 usec
ND0	2
TD	128
SFO1	100.6563 MHz
FIDRES	39.318066 Hz
SW	49.999 ppm
FnMODE	Echo-Antiecho
SI	2048
SF	400.2450000 MHz
WDW	SINE
SSB	2
LB	0.00 Hz
GB	0
PC	1.40
SI	1024
MC2	echo-antiecho
SF	100.6416850 MHz
WDW	SINE
SSB	2
LB	0.00 Hz
GB	0