
Sample #4

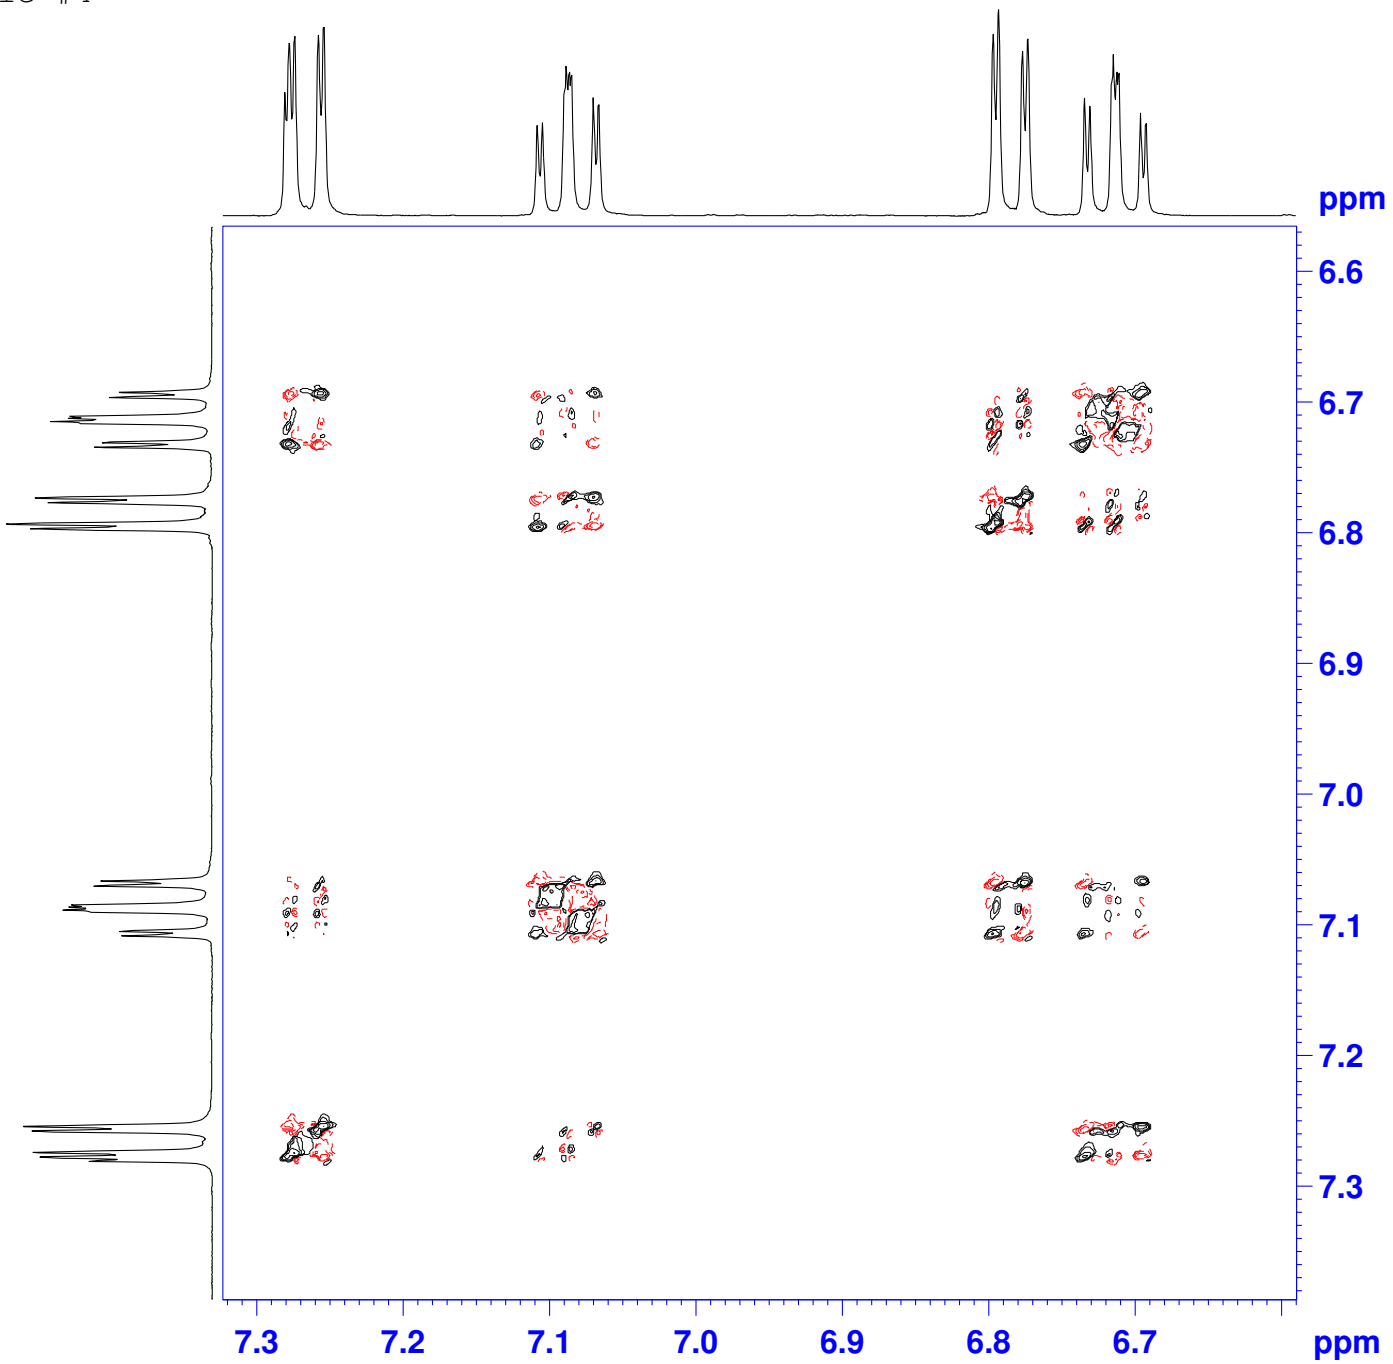

NAME	Un_04
EXPNO	6
PROCNO	1
Date_	20110331
Time	17.12
INSTRUM	DPX400
PROBHD	5 mm BBO BB-1H
PULPROG	cosygpmfph
TD	1024
SOLVENT	CDCl3
NS	2
DS	4
SWH	801.282 Hz
FIDRES	0.782502 Hz
AQ	0.6390260 sec
RG	64
DW	624.000 usec
DE	6.00 usec
TE	298.2 K
d0	0.00060681 sec
D1	2.00000000 sec
d13	0.00000400 sec
D16	0.00025000 sec
d20	0.00125400 sec
IN0	0.00124800 sec
ST1CNT	0
======== CHANNEL f1 ========	
NUC1	1H
P1	13.50 usec
p2	27.00 usec
PL1	-3.00 dB
SFO1	400.2478017 MHz
====== GRADIENT CHANNEL =====	
GPNAM1	SINE.100
GPNAM2	SINE.100
GPZ1	10.00 %
GPZ2	20.00 %
P16	1000.00 usec
ND0	1
TD	256
SFO1	400.2478 MHz
FIDRES	3.130008 Hz
SW	2.002 ppm
FnMODE	States-TPPI
SI	2048
SF	400.2450000 MHz
WDW	QSINE
SSB	2
LB	0.00 Hz
GB	0
PC	1.40
SI	2048
MC2	States-TPPI
SF	400.2450000 MHz
WDW	QSINE
SSB	2
LB	0.00 Hz
GB	0