Sample #37

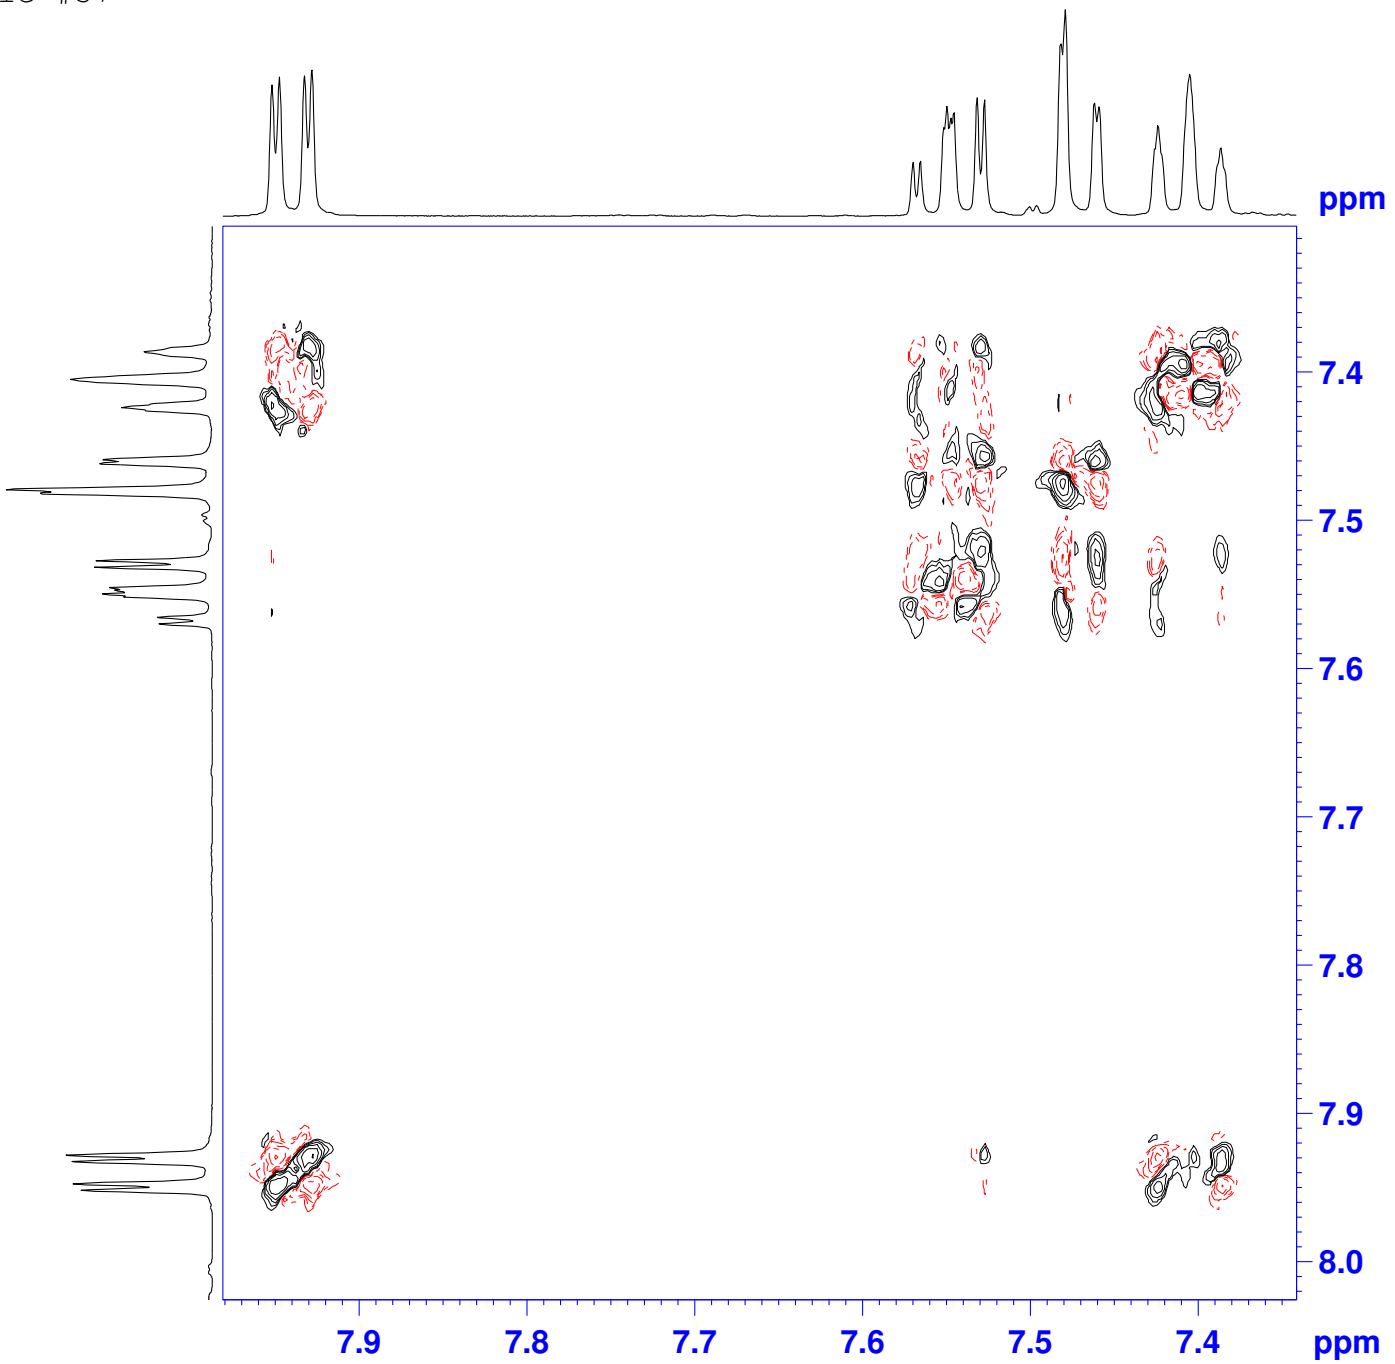

NAME	Un_37	
EXPNO	6	
PROCNO	1	
Date_	20110407	
Time	11.38	
INSTRUM	DPX400	
PROBHD	5 mm BBO BB-1H	
PULPROG	cosygpmfph	
TD	2048	
SOLVENT	CDCl3	
NS	2	
DS	4	
SWH	2003.205	Hz
FIDRES	0.978127	Hz
AQ	0.5112308	sec
RG	64	
DW	249.600	usec
DE	6.00	usec
TE	298.2	K
d0	0.00023241	sec
D1	2.00000000	sec
d13	0.00000400	sec
D16	0.00025000	sec
d20	0.00125400	sec
IN0	0.00049920	sec
ST1CNT	0	
======== CHANNEL f1 ========		
NUC1	1H	
P1	13.50	usec
p2	27.00	usec
PL1	-3.00	dB
SFO1	400.2484021	MHz
====== GRADIENT CHANNEL =====		
GPNAM1	SINE.100	
GPNAM2	SINE.100	
GPZ1	10.00	%
GPZ2	20.00	%
P16	1000.00	usec
ND0	1	
TD	256	
SFO1	400.2484	MHz
FIDRES	7.825020	Hz
SW	5.005	ppm
FnMODE	States-TPPI	
SI	2048	
SF	400.2450000	MHz
WDW	QSINE	
SSB	2	
LB	0.00	Hz
GB	0	
PC	1.40	
SI	2048	
MC2	States-TPPI	
SF	400.2450000	MHz
WDW	QSINE	
SSB	2	
LB	0.00	Hz
GB	0	