
Sample #42 HMBC

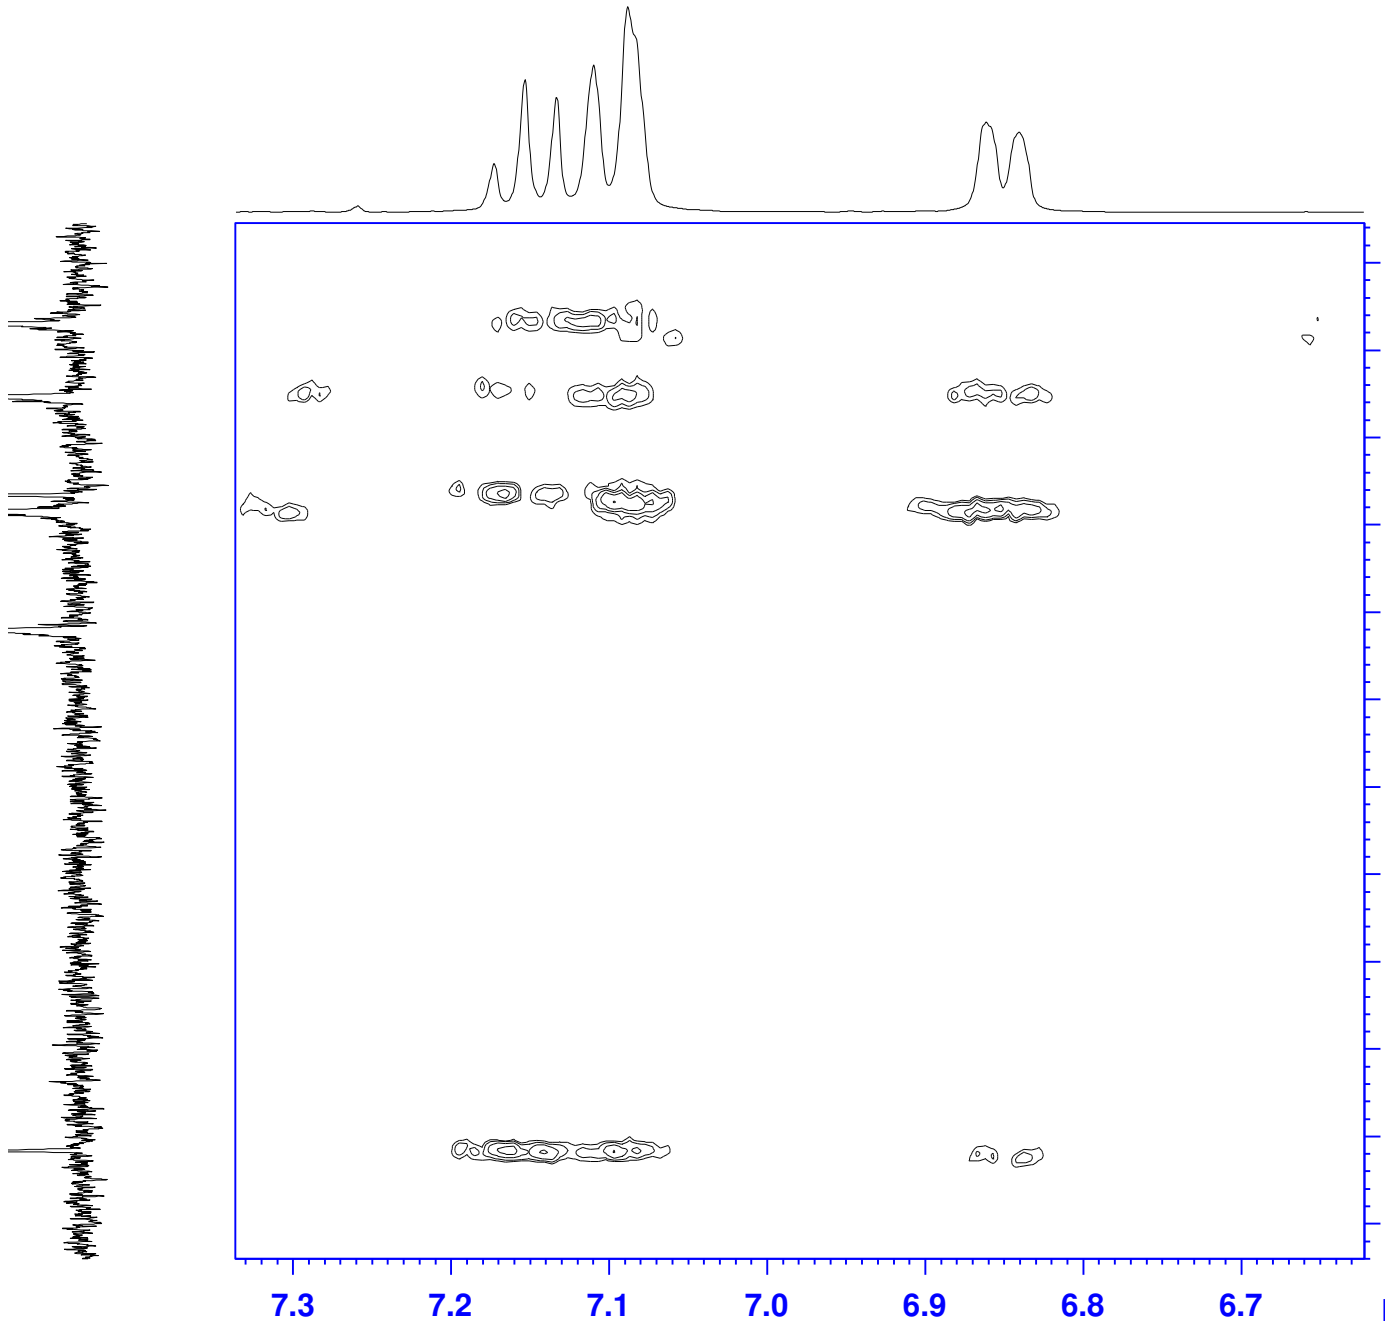


```
Current Data Parameters
NAME            sample42
EXPNO                  7
PROCNO                 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_           20010110
Time               18.30
INSTRUM          dpx400
PROBHD   5 mm BBO Z-Gra
PULPROG    inv4gslplrnd
TD                 2048
SOLVENT            CDC13
NS                     4
DS                     4
SWH            2003.205 Hz
FIDRES        0.978127 Hz
AQ            0.5111808 sec
RG                  6502
DW               249.600 usec
DE                 6.00 usec
TE                300.0 K
D0           0.00000300 sec
D1           1.00000000 sec
D2           0.00345000 sec
D6           0.06300000 sec
D13          0.00000300 sec
D16          0.00030000 sec
IN0          0.00004141 sec

============ CHANNEL f1 =============
NUC1                1H
P1                8.10 usec
P2               20.40 usec
PL1              -3.00 dB
SFO1        400.1322007 MHz

============ CHANNEL f2 =============
NUC2               13C
P3                7.00 usec
PL2              -3.00 dB
SFO2        100.6237964 MHz

============ GRADIENT CHANNEL ========
P16             1000.00 usec

F1 - Acquisition parameters
TD                  128
SFO1           100.6238 MHz
FIDRES       188.650772 Hz
SW             119.988 ppm
FnMODE        undefined

F2 - Processing parameters
SI                 1024
SF          400.1300094 MHz
WDW                SINE
SSB       0
LB        0 Hz
GB        0
PC                 1.40

F1 - Processing parameters
SI                 1024
MC2                  QF
SF          100.6127290 MHz
WDW                SINE
SSB       0
LB        0 Hz
GB        0
```