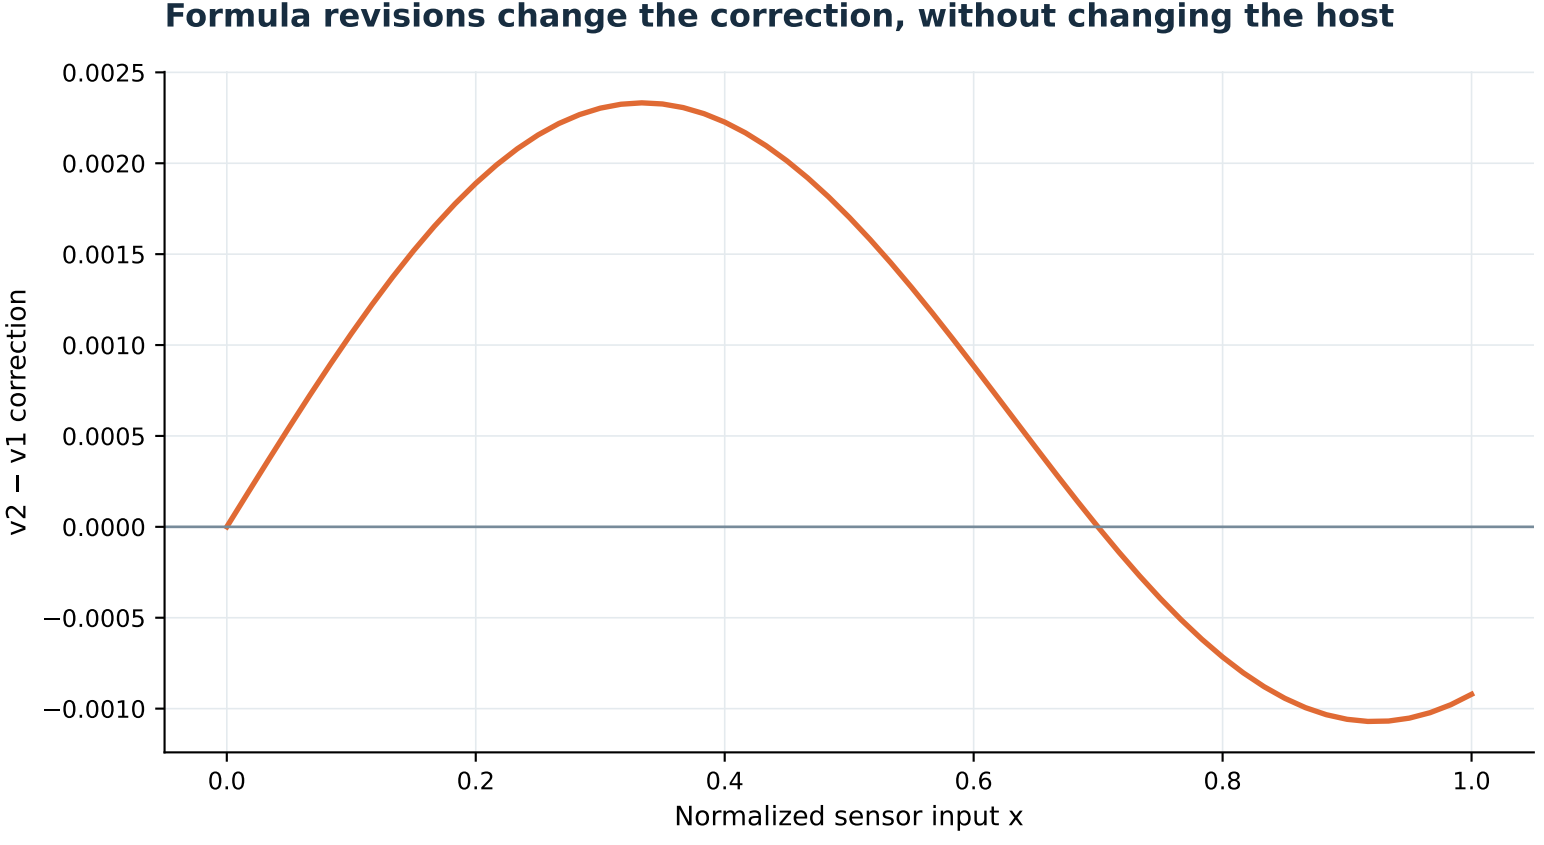
Formula revisions change the correction, without changing the host
0.0025
0.0020
0.0015
0.0010
0.0005
0.0000
−0.0005
−0.0010
v2 − v1 correction
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalized sensor input x