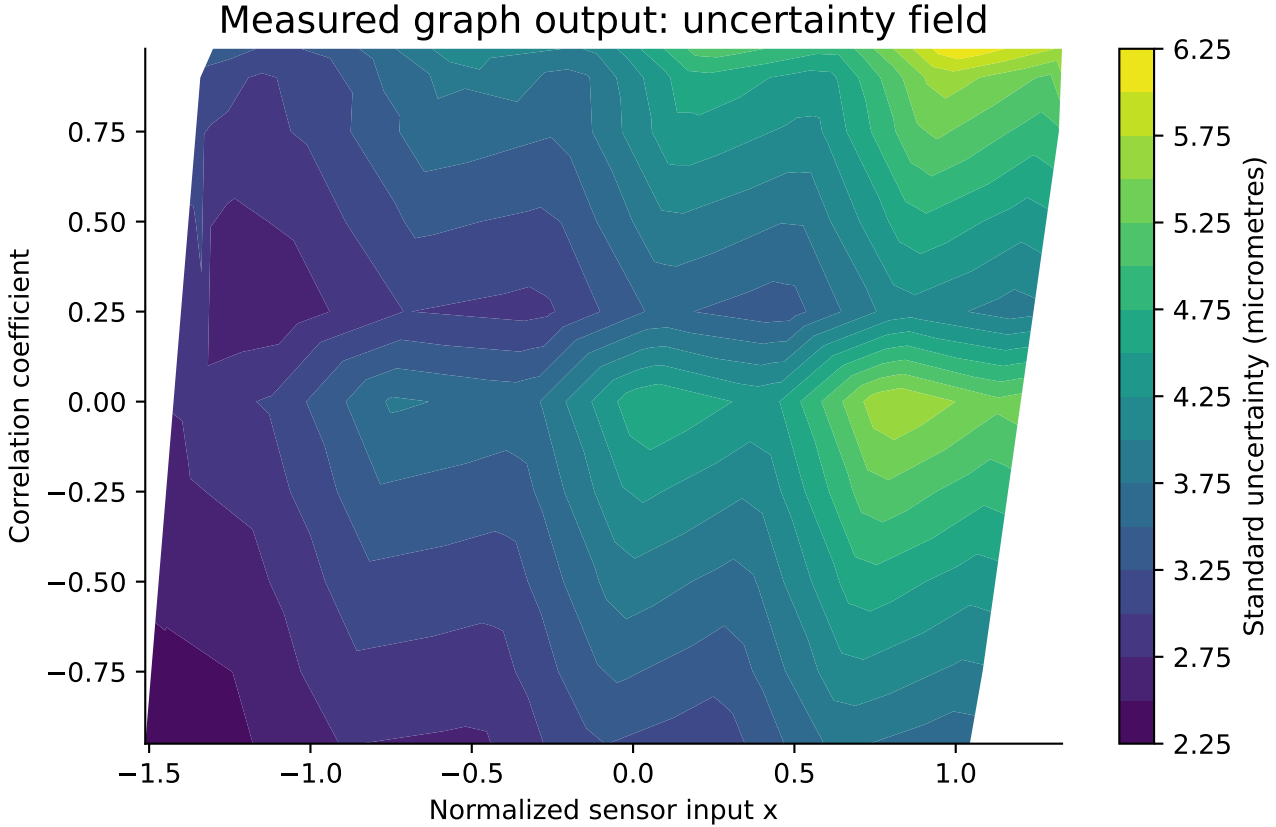
Measured graph output: uncertainty field
Correlation coefficient
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
Normalized sensor input x
Standard uncertainty (micrometres)
6.25
5.75
5.25
4.75
4.25
3.75
3.25
2.75
2.25