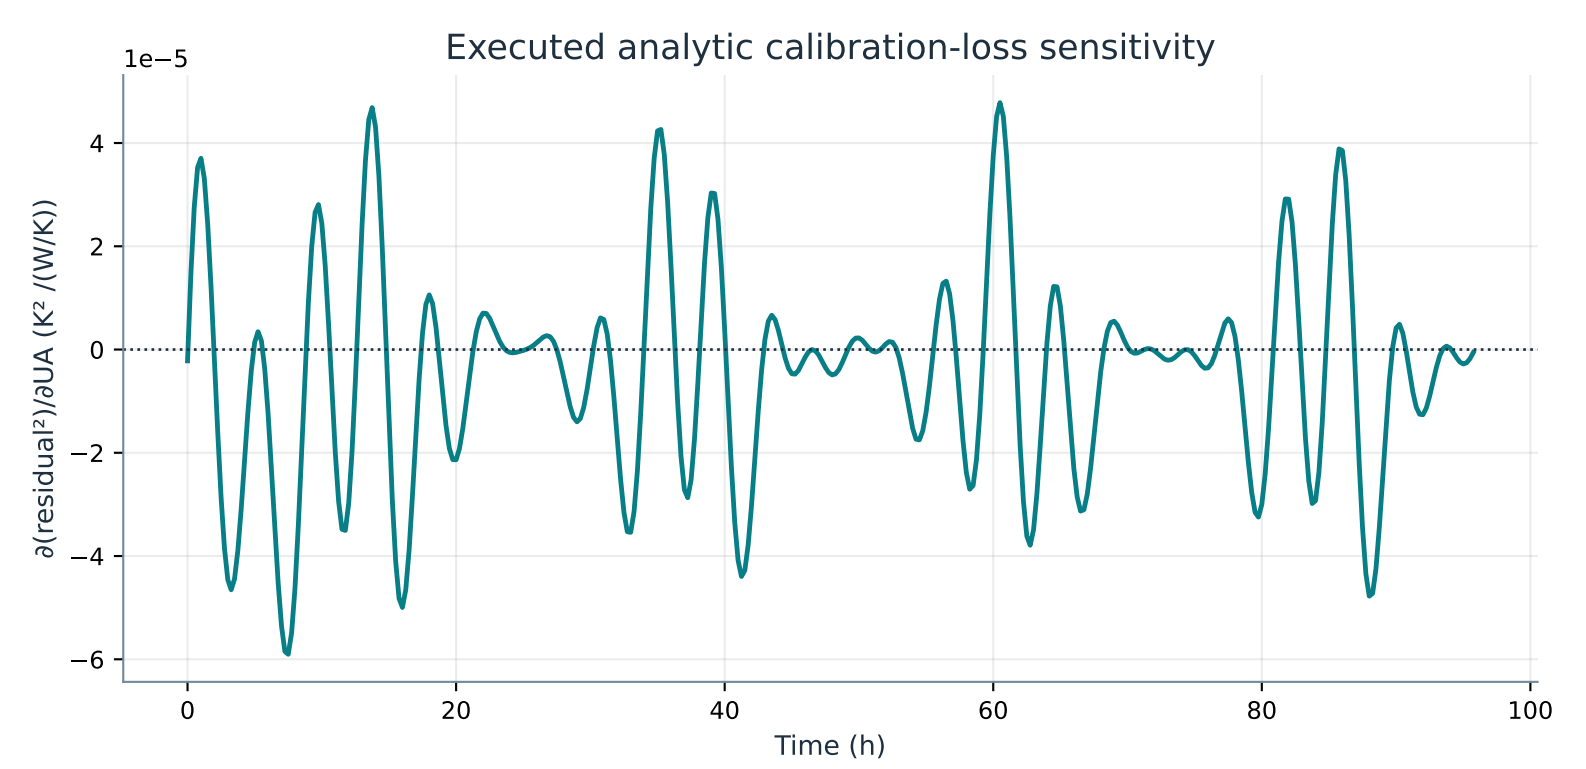
Executed analytic calibration-loss sensitivity
1e−5
4
2
0
−2
−4
−6
∂(residual²)/∂UA (K² /(W/K))
0
20
40
60
80
100
Time (h)