

(Cleaning Program)


สาขา 5506 PTT Rama 2

วันที่ตรวจ 26 พฤศจิกายน 2568

ผู้ตรวจ

พิมพ์วิภา สีทอง

1. ผลการตรวจ ความสะอาดภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (Swab test)

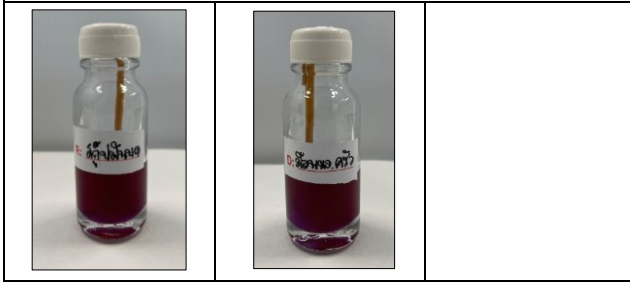


ตัวอย่าง	ผลการตรวจ	
	ระดับ	ผล
- มือพนักงานเชกเกอร์	ผลเป็นลบ (-)	ผ่าน
- สตูปี้นบด	ผลเป็นลบ (-)	ผ่าน
น้ำเช็ดอุปกรณ์ เวลา :		
11.30 - 13.30 น.		

- ผลเป็นลบ (-) สีม่วงใสไม่เปลี่ยนแปลง (ไม่พบเชื้อ)
- ผลเป็นบวก (+) จากสีม่วงเปลี่ยนเป็นสีม่วงปนเหลือง
- ผลเป็นบวก (++) จากสีม่วงเปลี่ยนเป็นสีเหลือง (เชื้อเจริญมาก)

แนวทางแก้ไข :

2. ผลการตรวจ เชื้อโคลิฟอร์มในน้ำ และอาหาร

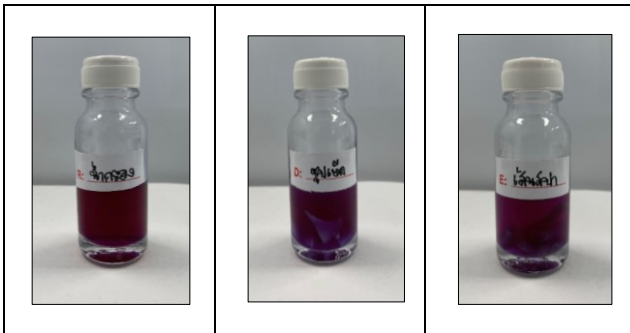


ตัวอย่าง	ผลการตรวจ	
	การเกิดจุด	ผล
- น้ำกรอง	ผลเป็นลบ (-)	ผ่าน
เครื่องกรองน้ำเตนเลส		
- ซุปหัด	ผลเป็นลบ (-)	ผ่าน
จัดเก็บอุณหภูมิตู้เย็น		
- เส้นสปาเกตตี	ผลเป็นลบ (-)	ผ่าน
D = 24/11/68 (15.00)		
E = 27/11/68 (15.00)		

- ผลเป็นลบ (-) สีม่วงใสไม่เปลี่ยนแปลง (ไม่พบเชื้อ)
- ผลเป็นบวก (+) จากสีม่วงเปลี่ยนเป็นสีม่วงปนเหลือง
- ผลเป็นบวก (++) จากสีม่วงเปลี่ยนเป็นสีเหลือง (เชื้อเจริญมาก)

แนวทางแก้ไข :

3. ผลการตรวจ สารโพลาไรในน้ำมันทอดซ้ำ

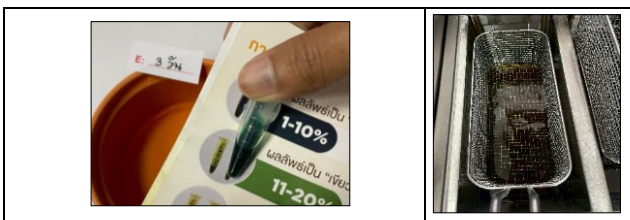

ตัวอย่าง	ผลการตรวจ	
	สารโพลาไรอยู่ในช่วง	ผล
น้ำมันเตาทอด	ช่วง 1-10%	ผ่าน
จำนวนวันที่ใช้งาน 3 วัน		

- สีน้ำเงิน น้ำมันยังไม่เสื่อมสภาพ สารโพลาไรอยู่ในช่วง 1-10%
- สีเขียว น้ำมันยังไม่เสื่อมสภาพ สารโพลาไรอยู่ในช่วง 11-20%
- สีเขียวอมน้ำตาล น้ำมันยังใช้ได้แต่ไม่ควรเติมน้ำมันใหม่ลงไป
- สารโพลาไรอยู่ในช่วง 21-24 %
- สีส้ม สารโพลาไรมาก 25 % เป็นน้ำมันที่เสื่อมสภาพแล้วไม่ควรใช้

แนวทางแก้ไข :

4. ผลการตรวจ ความเข้มข้นในน้ำยาฆ่าเชื้ออุปกรณ์



ตัวอย่าง	ผลการตรวจ	
	ระดับ	ผล
น้ำยา Suma J-512 ผสม	100 PPM	ไม่ผ่าน
สำหรับเช็ดอุปกรณ์		

- ความเข้มข้น 0 ppm ไม่พบการใช้ยาฆ่าเชื้อ
- ความเข้มข้น 100 ppm ความเข้มข้นน้อยกว่ามาตรฐาน
- ความเข้มข้น 200 ppm ความเข้มข้นตามมาตรฐานกำหนด
- ความเข้มข้น 300 ppm ความเข้มข้นสูงเกินมาตรฐาน
- ความเข้มข้น 400 ppm ความเข้มข้นสูงเกินมาตรฐาน

แนวทางแก้ไข :

ควรทดสอบการกดยาจากหัวบีบ 1 บีบให้ได้ปริมาณ 1 ml หรือใช้ syringe ในการวัดคงปริมาณ ผสมน้ำยา Suma J-512 ให้ถูกต้องได้มาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ