



Torino, 17 maggio 2004

Squadre Torino
Dipendenti Croce Verde Torino

Prot. int. n. 10/04

OGGETTO: adozione check-list per ambulanze

Vi comunico che, a partire dalla data odierna – 17 maggio 2004 – entrerà in vigore per le squadre della sede di Torino l'allegata check list per il controllo del materiale in dotazione alle ambulanze.

La check list dovrà essere compilata obbligatoriamente per tutte le ambulanze delle postazioni di urgenza e in convenzione mentre, per tutte le altre ambulanze di sede, vi preghiamo di utilizzarla per comunicarci eventuali disfunzioni o anomalie riscontrate.

La check list, firmata e debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere consegnata ai responsabili dell'autoparco imbucandola nell'apposita buca.

Vi preghiamo di volerci segnalare eventuali miglioramenti o modifiche da apportare alla check list, il cui fine è quello di salvaguardare il patrimonio dell'ente ed evitare di trovarsi in servizio senza il materiale necessario.

RingraziandoVi sentitamente Vi porgo distinti saluti

DIREZIONE DEI SERVIZI

Vincenzo Favale

CROCE VERDE TORINO
Associata A.N.P.A.S.
Sede di Torino
Via Tommaso Dorè, 4
10121 TORINO
www.croceverde.org

Tel. Servizi: 011 549000
Tel. Ammin.: 011 5621606
Fax: 011 5621806

C.F. 05248350018






Sede di Torino

Sezione di Alpignano, Sezione di Borgaro - Caselle, Sezione di Cirié, Sezione di San Mauro, Sezione di Ver

AUTO N:	DATA / /		SQUADRA:		POSTAZ:	
CHECK LIST AMBULANZA			SI	NO		
					SI	NO
MATERIALE STRUMENTALE VANO SANITARIO				ATTREZZATURA E MATERIALE VARIO		
DEFIBRILLATORE *						
CAVO a 12 DERIV COMPLETO				SPINALE SPENCER ROCK		
CAVO a 3 o 4 DERIV				RAGNO		
CAVO PROLUNGA SATURIMETRO (no LP10)				FERMACAPO CONTOUR		
SENSORE SATURIMETRO (no LP10)				SEDIA PORTANTINA		
MODULO SATURIMETRO				BARELLA SCOOP		
CAVO PER PIASTRE MONOUSO				CINTURE BARELLA SCOOP		
ELETTRODI PER PIASTRE MONOUSO				SET STECCOBENDE TRE PEZZI		
ELETTRODI PER ECG				ESTRICATORE		
GEL				BORSA SOCCORSO		
CARTA ECG				ZAINO SOCCORSO		
ALIMENTATORE A 12 V CON CAVO				RIDUTTORE DI PRESS.BOMB.PORT		
BATTERIE				BOMBOLA PORTATILE 2 LT 3 LT		
PIASTRE PEDIATRICHE				BOMBOLE GRANDI LT 7		
POMPA INFUSIONALE				MATERIALE INERENTE AL MEZZO		
CAVO A12 V				COPERTA ANTIFIAMMA		
CAVO a 220V				SET DA SCASSO		
ASPIRATORE LAERDAL				TRIANGOLO		
CAVO a 220V				TELEPASS		
CAVO A12 V				ESTINTORE POSTERIORE		
VENTILATORE POLMONARE				ESTINTORE ANTERIORE		
CAVO a 220V				FARO DI RICERCA		
CAVO A12 V				BORSA CON STRADARIO		
DIVERSE				DOCUMENTI DEL MEZZO		
PULIZIA MEZZO INTERNO				CARTA CIRCOLAZIONE		
PULIZIA MEZZO ESTERNO				MULTICARD AGIP PER BENZINA		
CONTROLLO OLIO				TAGLIANDO ASSICURAZIONE		
CONTROLLO PARAFLU'				MATRICE TAGLIANDO ASSIC.		
				CARTA VERDE		
				AUTORIZZAZIONE ASL AL TRASP.		

* Di norma sulla MSA il defibrillatore è il tipo LP12, mentre sui mezzi in convenzione è Defigard.
In casi eccezionali alcuni mezzi possono essere dotati con il LP10

NOTE: _____

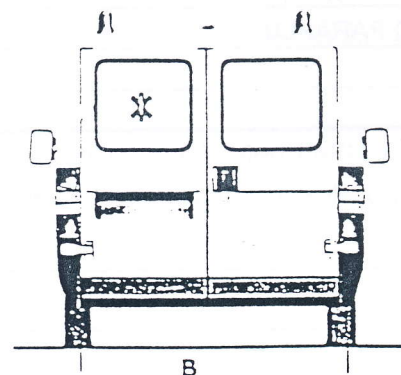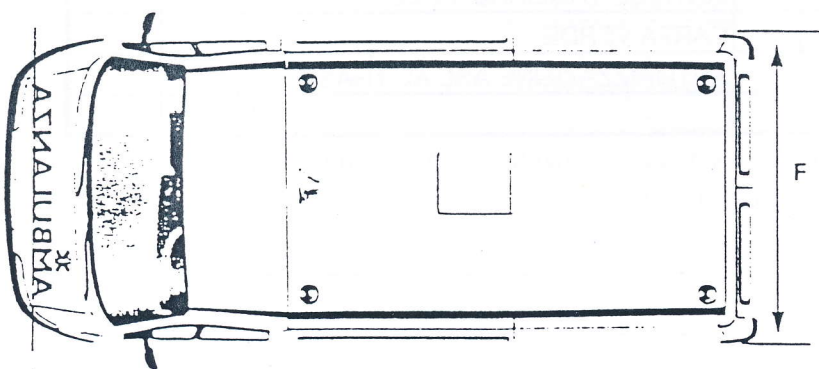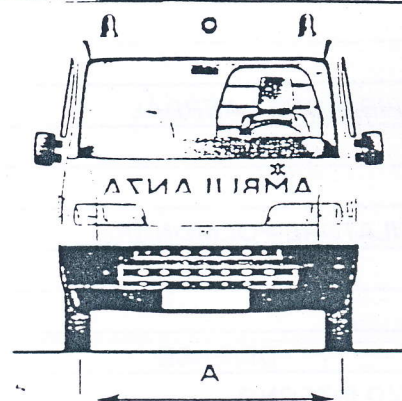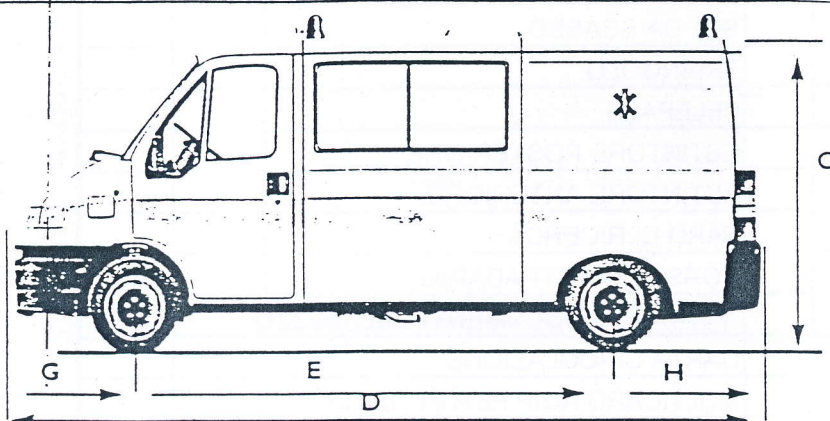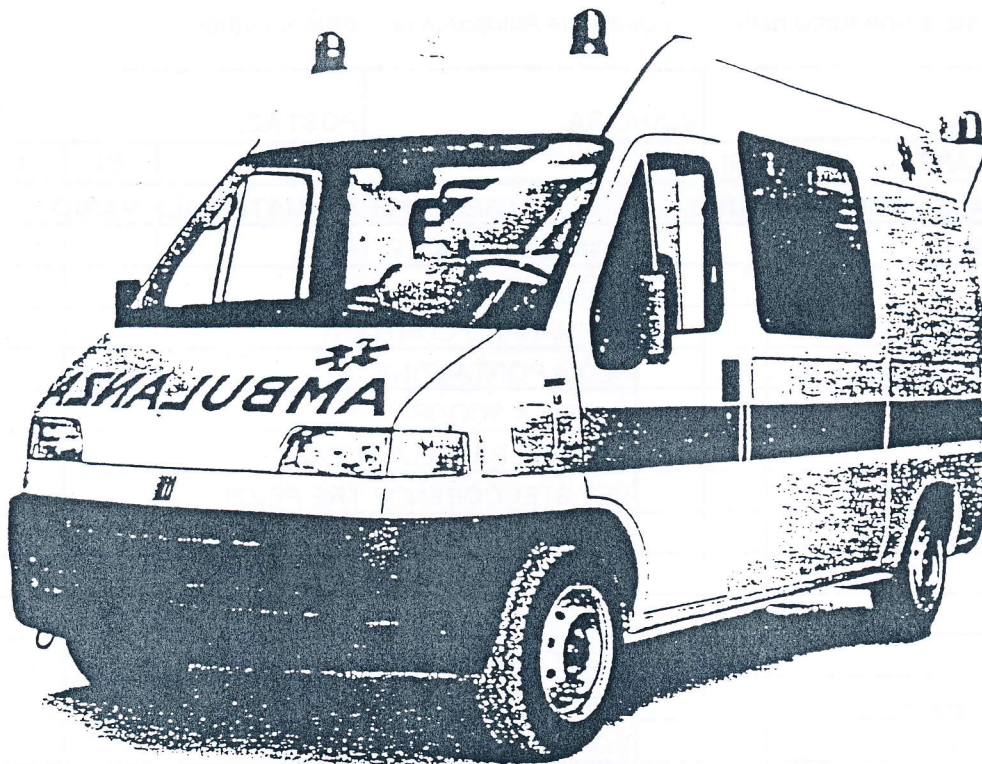

INDICARE CON UNA FRECCIA I DANNI DI CRROZZERIA RISCOINTRATI

NOTE : ALTRE ANOMALIE DEL MEZZO