Nome: Marta Cristina Uchoa Teles
Data de nascimento: 02/06/1996

Hidrocefalia: Hipertensão Intracraniana Idiopática.

Hospital São Camilo Santana

Dr. Fábio Takeo Yamada

Änderung der Druckstufe I Change of the pressure configuration
Changement du niveau de pression

Datum I Date I Date	Druckstufe I Pressure setting I Niveau de pression
22-03-26	P=17
24-03-26	P=20

Bei Fragen bitte wenden an I If you have questions, please contact
Si vous avez des questions, contactez

Ulanenweg 2 | 14469 Potsdam | Germany
Phone: +49 331 62083-0
Fax: +49 331 62083-40
E-Mail: info@miethke.com | Web: www.miethke.com

PP_81_08_0121

Implantation 18/03/26
Op.-Datum I Op.-Date I Date de l'opération

产品名称：一次性使用可调压无菌腹积水分流管及附件
型号规格 FX434T
批号 20085246
序列号 N180079C176204
生产日期 2025-09-10
失效日期 2030-09-09

MIETHKE

Einstellung Öffnungsdruck bei OP I Adjusted opening pressure at operation I L'ajustement de niveaux de pression après OP

☐ verstellbare Differenzdruckeinheit I adjustable DP-unit I unité de pression différentielle 15

Implantationsort I Implantation site I lieu de l'implantation

☐ adj. DP-unit: .....
☐ thorax ☐ retroauricular
☐ other .....

Ableitungsart I Type of Derivation I Type de dérivation

Besonderheiten des Shuntsystems I Special Parts of the Shuntsystem
Parti- cularité de Système implanté

Reservoir ☐ ja I yes I oui ☐ nein I no I non

Wo? I Where? I Où? .....

Miethke-Reservoire sind punktierbar I Punction of Miethke-Reservoirs is

Unité de pression différentielle réglable

Dreieckspitze zeigt den Ventilöffnungsdruck in cmH_2O
triangular tip shows opening pressure in cmH_2O
pointe triangulaire indique la pression d'ouverture en cmH_2O

Example: 14 cmH_2O



Example: 14 cmH_2O

Die Ventile sind 3 Tesla bedingt MR sicher, eine unbeabsichtige Verstellung im MRT bei 3 Tesla oder weniger ist ausgeschlossen, Druckstufe ist im Röntgenbild erkennbar

Valves are 3 tesla MR Conditional (ASTM F2503-20), the valves will not inadvertently reprogram in an MRI field of 3 Tesla or less, pressure configuration is visible under X-ray

Valve compatible avec la résonance magnétique sous conditions, jusqu'à 3 Tesla: la valve ne sera pas involontairement déréglée dans un champ d'IRM de 3 Tesla ou moins

ahl der Kodierringe definiert den Ventilöffnungsdruck
nber of coding rings defines the opening pressure
ombre d'anneaux de codage définit la pression d'ouverture

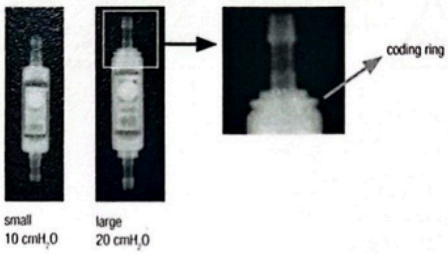

Ventilöffnungsdruck Valve opening pressure Pression d'ouverture de la valve	Kodierung Codes Codage
10 cmH_2O (*paediSHUNTASSISTANT*)	
15 cmH_2O (*SHUNTASSISTANT*)	
20 cmH_2O (*SHUNTASSISTANT*)	
25 cmH_2O (*SHUNTASSISTANT*)	
30 cmH_2O (*SHUNTASSISTANT*)	
35 cmH_2O (*SHUNTASSISTANT*)	