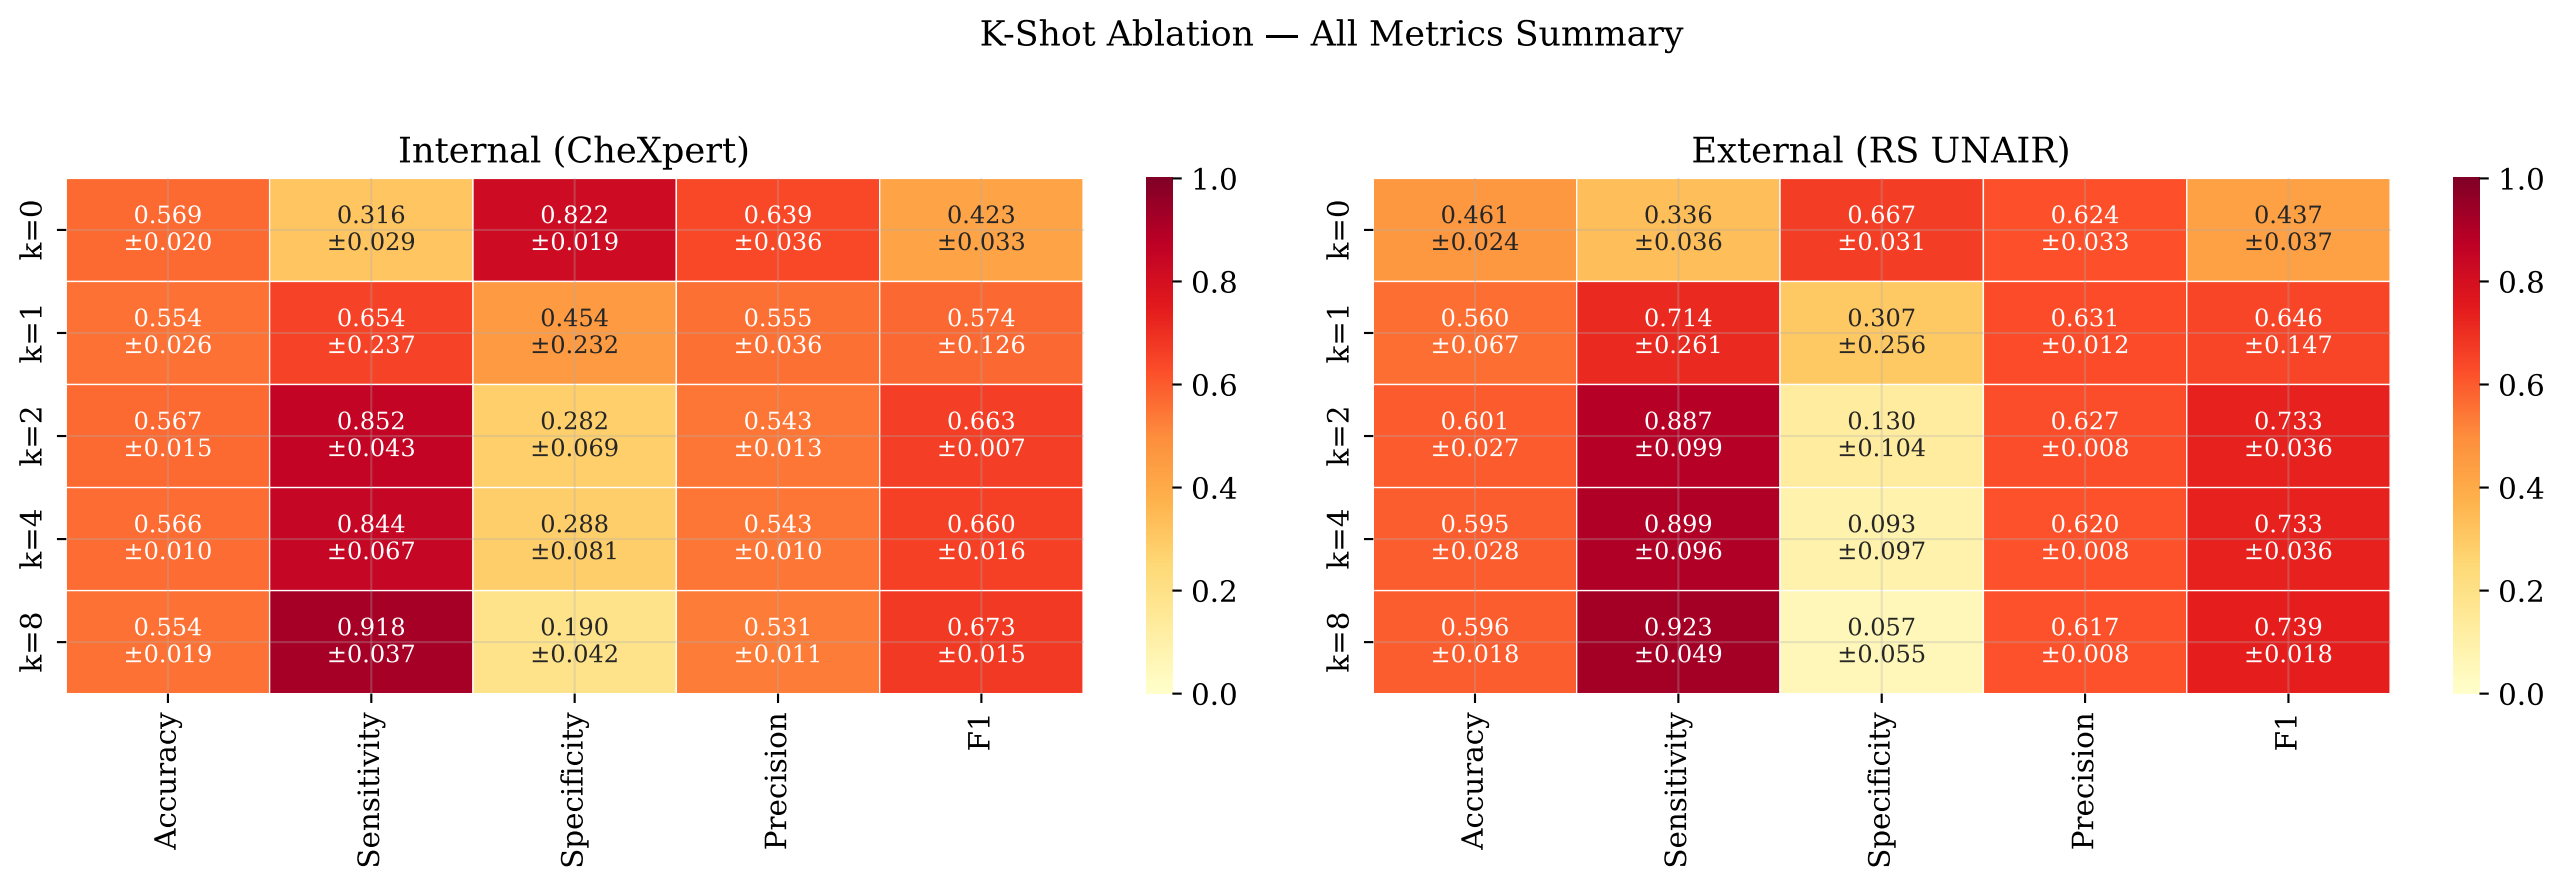
K-Shot Ablation — All Metrics Summary
Internal (CheXpert)
External (RS UNAIR)
k=0
k=1
k=2
k=4
k=8
Accuracy
Sensitivity
Specificity
Precision
F1
0.569 ±0.020
0.316 ±0.029
0.822 ±0.019
0.639 ±0.036
0.423 ±0.033
0.554 ±0.026
0.654 ±0.237
0.454 ±0.232
0.555 ±0.036
0.574 ±0.126
0.567 ±0.015
0.852 ±0.043
0.282 ±0.069
0.543 ±0.013
0.663 ±0.007
0.566 ±0.010
0.844 ±0.067
0.288 ±0.081
0.543 ±0.010
0.660 ±0.016
0.554 ±0.019
0.918 ±0.037
0.190 ±0.042
0.531 ±0.011
0.673 ±0.015
0.461 ±0.024
0.336 ±0.036
0.667 ±0.031
0.624 ±0.033
0.437 ±0.037
0.560 ±0.067
0.714 ±0.261
0.307 ±0.256
0.631 ±0.012
0.646 ±0.147
0.601 ±0.027
0.887 ±0.099
0.130 ±0.104
0.627 ±0.008
0.733 ±0.036
0.595 ±0.028
0.899 ±0.096
0.093 ±0.097
0.620 ±0.008
0.733 ±0.036
0.596 ±0.018
0.923 ±0.049
0.057 ±0.055
0.617 ±0.008
0.739 ±0.018
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0