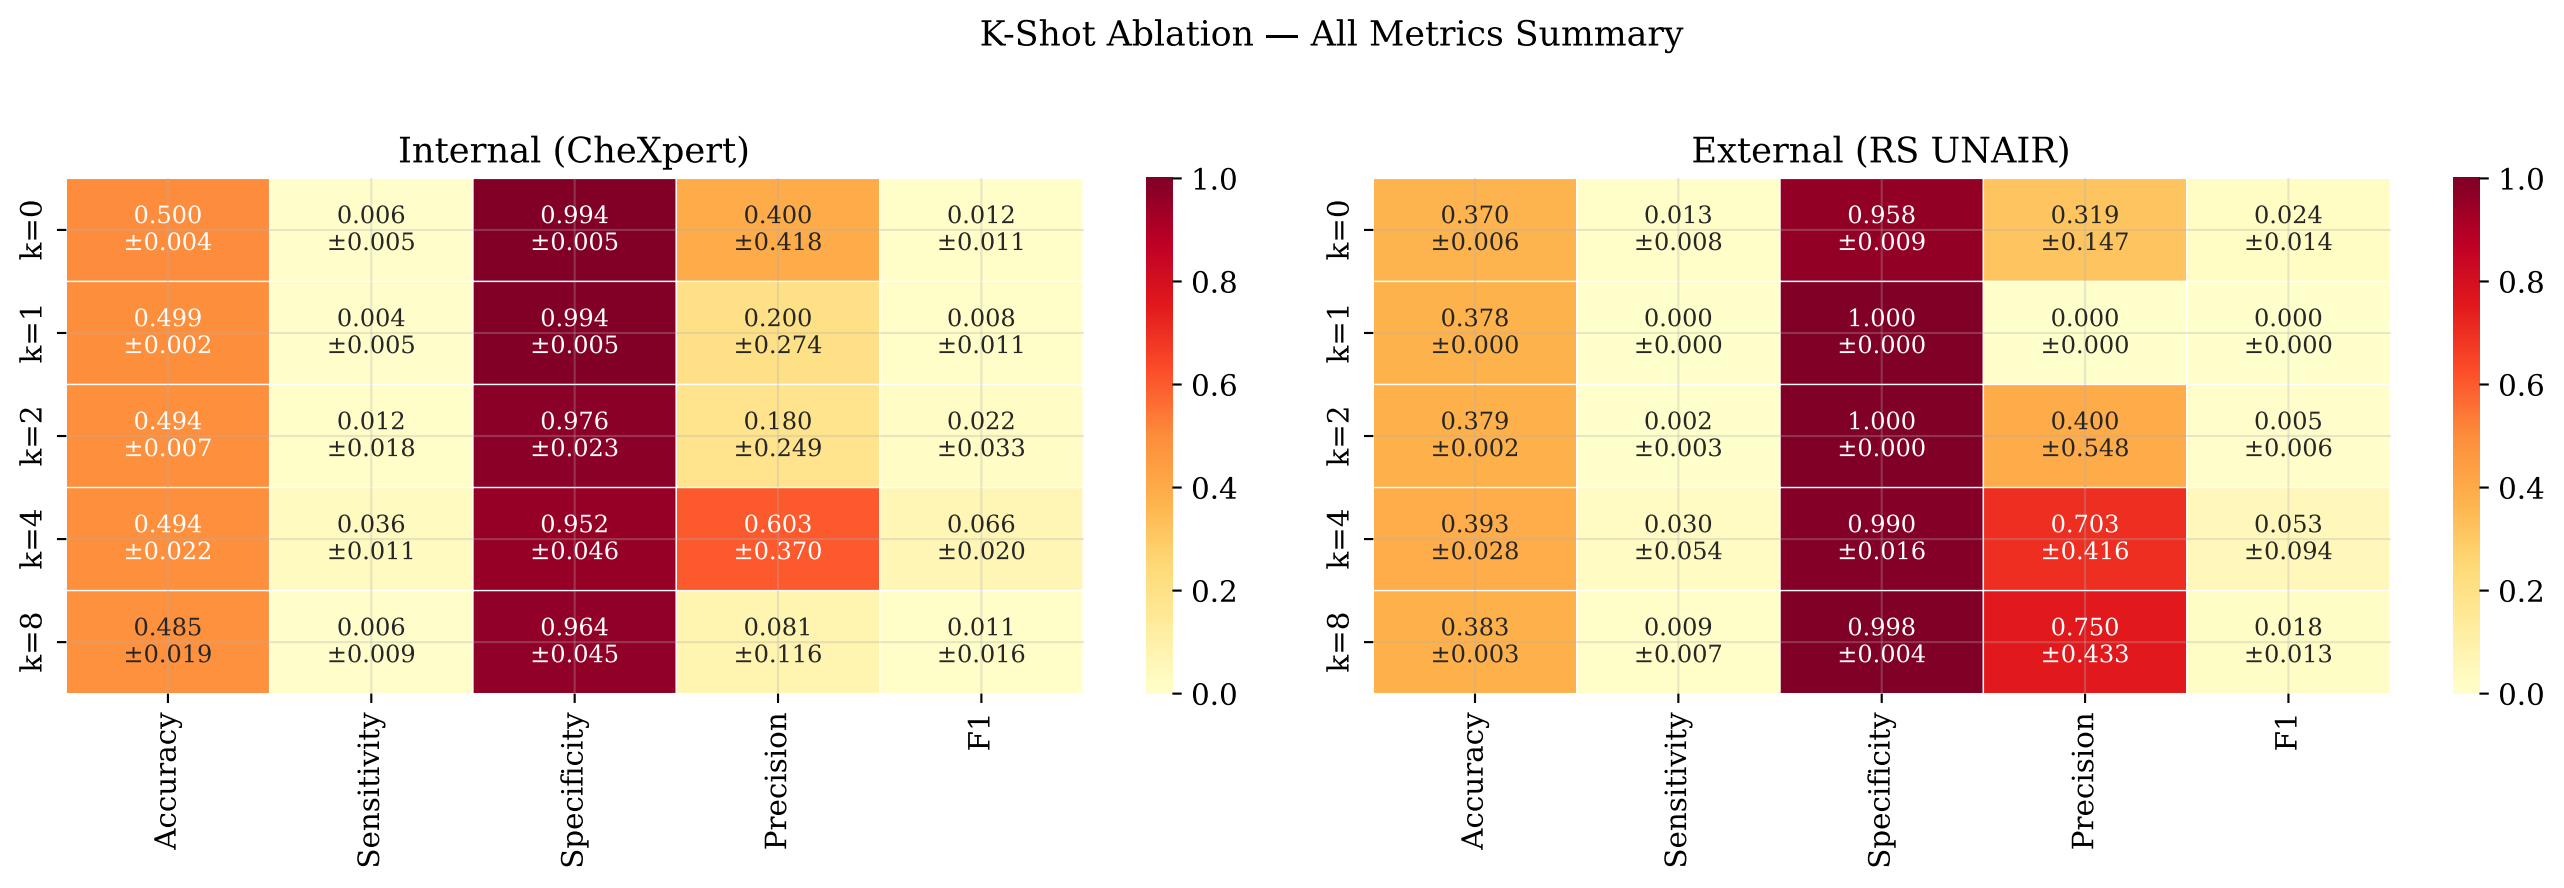
K-Shot Ablation — All Metrics Summary
Internal (CheXpert)
k=0
k=1
k=2
k=4
k=8
0.500 ±0.004
0.006 ±0.005
0.994 ±0.005
0.400 ±0.418
0.012 ±0.011
0.499 ±0.002
0.004 ±0.005
0.994 ±0.005
0.200 ±0.274
0.008 ±0.011
0.494 ±0.007
0.012 ±0.018
0.976 ±0.023
0.180 ±0.249
0.022 ±0.033
0.494 ±0.022
0.036 ±0.011
0.952 ±0.046
0.603 ±0.370
0.066 ±0.020
0.485 ±0.019
0.006 ±0.009
0.964 ±0.045
0.081 ±0.116
0.011 ±0.016
Accuracy
Sensitivity
Specificity
Precision
F1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
External (RS UNAIR)
k=0
k=1
k=2
k=4
k=8
0.370 ±0.006
0.013 ±0.008
0.958 ±0.009
0.319 ±0.147
0.024 ±0.014
0.378 ±0.000
0.000 ±0.000
1.000 ±0.000
0.000 ±0.000
0.000 ±0.000
0.379 ±0.002
0.002 ±0.003
1.000 ±0.000
0.400 ±0.548
0.005 ±0.006
0.393 ±0.028
0.030 ±0.054
0.990 ±0.016
0.703 ±0.416
0.053 ±0.094
0.383 ±0.003
0.009 ±0.007
0.998 ±0.004
0.750 ±0.433
0.018 ±0.013
Accuracy
Sensitivity
Specificity
Precision
F1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0