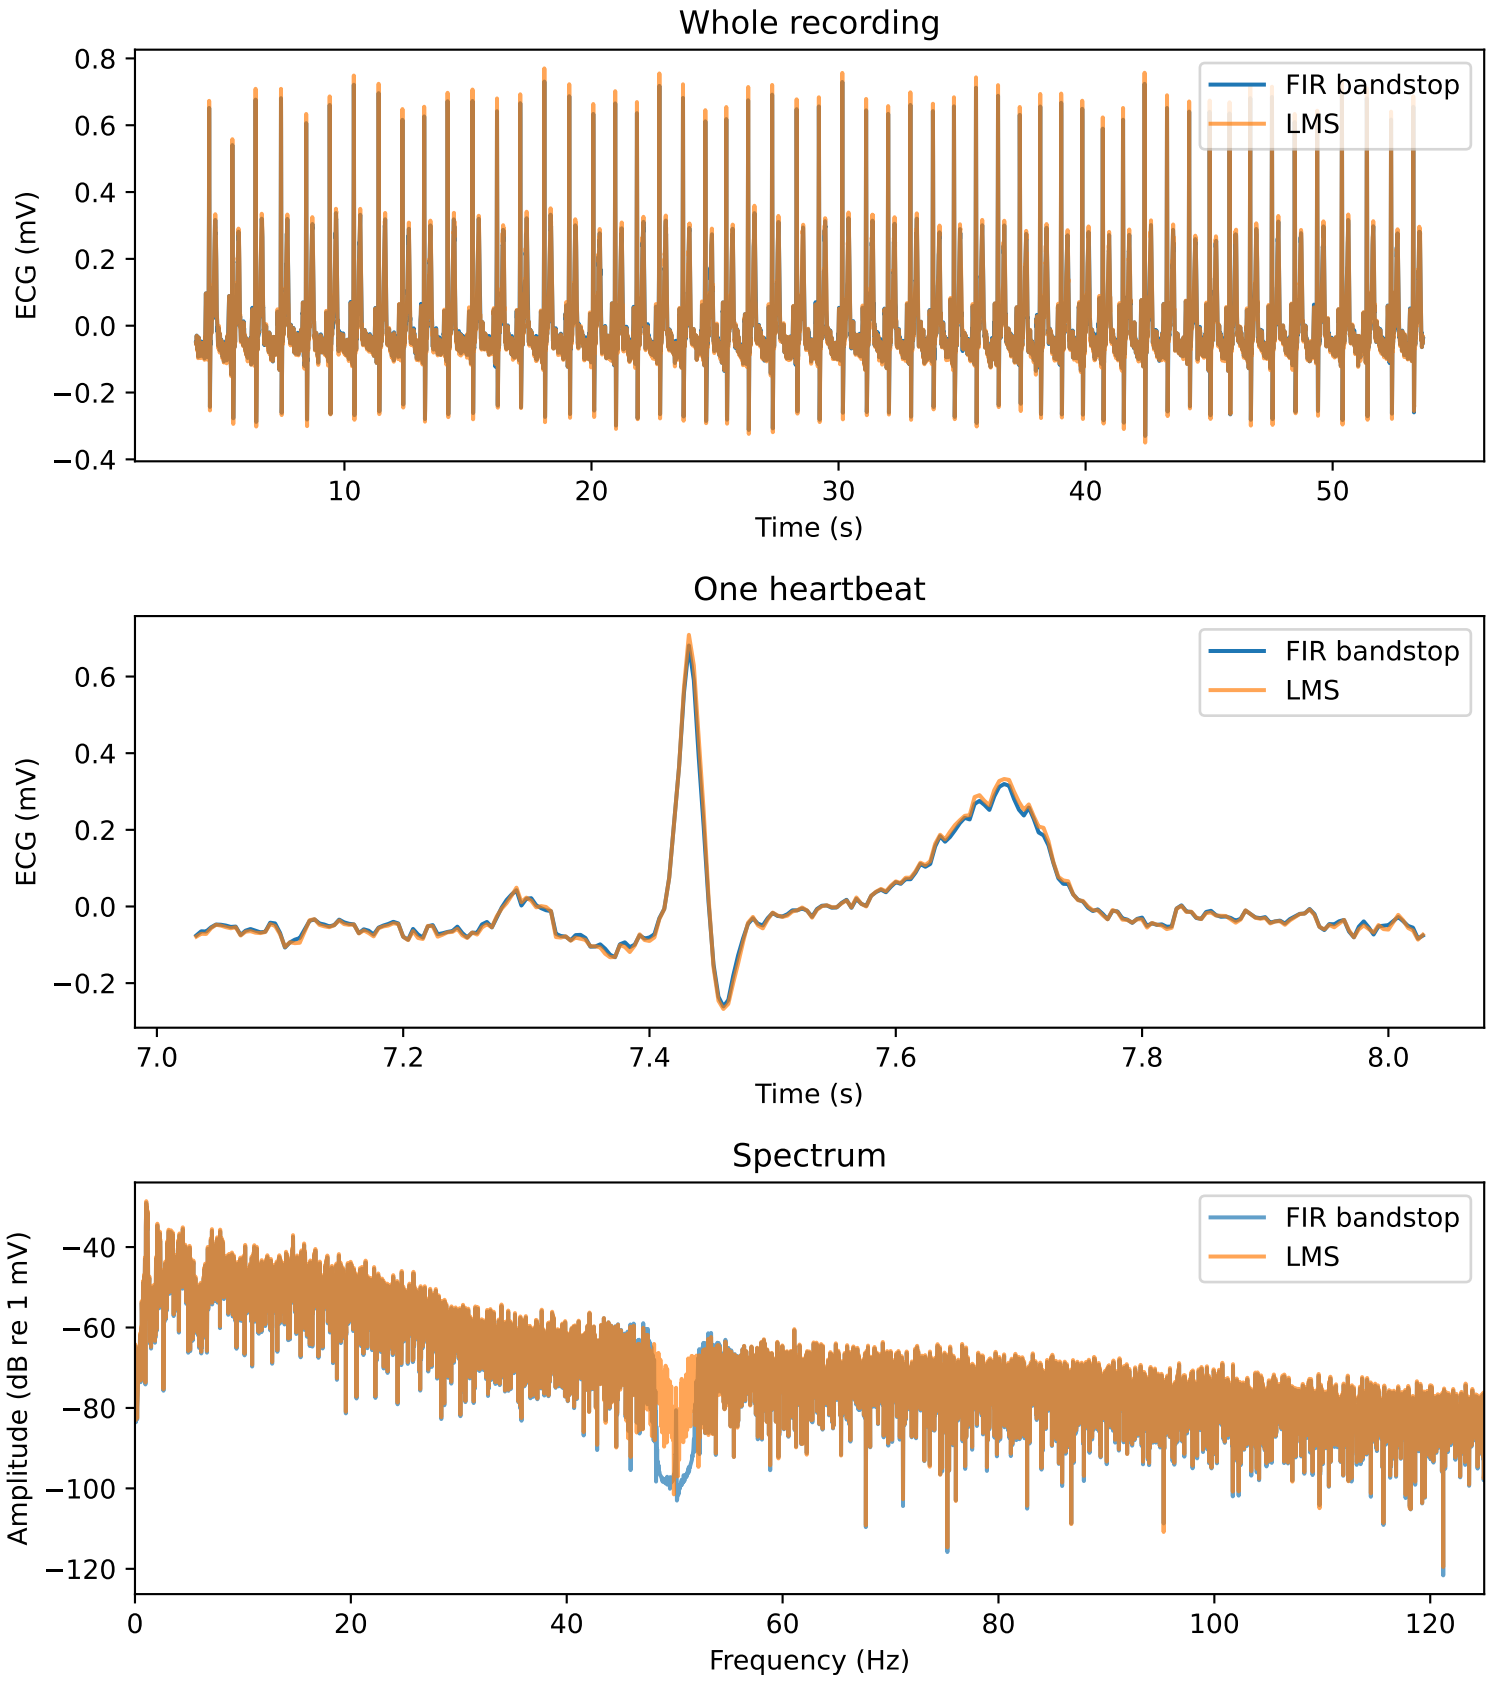

Whole recording
FIR bandstop
LMS
ECG (mV)
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
10
20
30
40
50
Time (s)
One heartbeat
FIR bandstop
LMS
ECG (mV)
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
Time (s)
Spectrum
FIR bandstop
LMS
Amplitude (dB re 1 mV)
−40
−60
−80
−100
−120
0
20
40
60
80
100
120
Frequency (Hz)