

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración Acreditado en la Magnitud TEMPERATURA

Fecha de Emisión : 27-mar-26 **N° de Certificado** : 26-FR-CA-02188 **Página 1 de 2**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Cliente : EQUANS SERVICIOS DE MANTENCION SPA
Dirección : LOS HORTENSIA 501 - CERRILLOS
Descripción del ítem : TERMO-ANEMOMETRO
Fabricante : TESTO
Número de Parte / Modelo : 410i
Número de Serie : 49018922
Identificación de Cliente : ANE-PA-03

DATOS DE LA CALIBRACIÓN

Fecha de Calibración : 26-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 26-mar-28
Lugar de Calibración : LABORATORIO DE PRUEBAS AMBIENTALES, DTS SpA.
Condiciones Ambientales : **Temperatura** : (22,5 ± 7,5)°C **Humedad Relativa** : ≤ 90%
Procedimiento : 6752PRO059-01 Rev 11.00 **Método de Calibración** : Comparación directa
Documento de Referencia : 33 K5-4-84-1 TH-007
Propiedades Físicas Relevantes : NINGUNA
Desviación a los procedimientos : NINGUNA
Rangos de mediciones : **Temperatura** : (-20 a 50) °C
Resolución : **Temperatura** : 0,1 °C

ANTECEDENTES DEL O LOS PATRONES UTILIZADOS

Descripción	Fabricante	N° de Parte	N° de Serie	N° de Certificado	Vence	Laboratorio Emisor	Trazabilidad Inmediata
PORTABLE DE HUMEDAD, TEMPERATURA Y PUNTO DE ROCIO	ROTRONIC	HP23-A/HC2A	72094036/20567026	H00863	15-may-26	LCPN-HR ENAER	LCPN-HR ENAER
CAMARA CLIMATICA	MEMMERT	HPP110	W416.0116	26-FR-CA-00556	22-ene-27	DTS	DTS

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

El laboratorio de Calibración posee la competencia técnica y cumple con las exigencias de la Norma Nch-ISO 17025 "Requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración".

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

La Incertidumbre expandida ha sido estimada multiplicando la incertidumbre estándar por un factor de cobertura aproximadamente k=2.

El valor del mensurando se encuentra dentro del intervalo indicado de valores con una probabilidad del 95%.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin la firma digital no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración Acreditado en la Magnitud TEMPERATURA


Fecha de Emisión : 27-mar-26

N° de Certificado : 26-FR-CA-02188

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

PATRON	LECTURA PROMEDIO INSTRUMENTO CALIBRADO	ERROR	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA ($\pm$) (k=2)	HUMEDAD DE LA CÁMARA	OBSERVACIONES
TEMPERATURA					
°C	°C	°C	°C	% hr	---
10,0	10,3	0,3	0,80	50,9	---
20,0	19,9	-0,1	0,80	51,2	---
30,0	29,9	-0,1	1,5	51,7	---

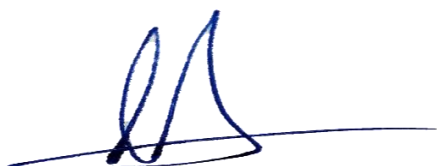

FRANCISCO REYES GAJARDO.
TÉCNICO METRÓLOGO

RESPONSABLE TÉCNICO
LABORATORIO DE CALIBRACIONES

Fin del certificado de calibración