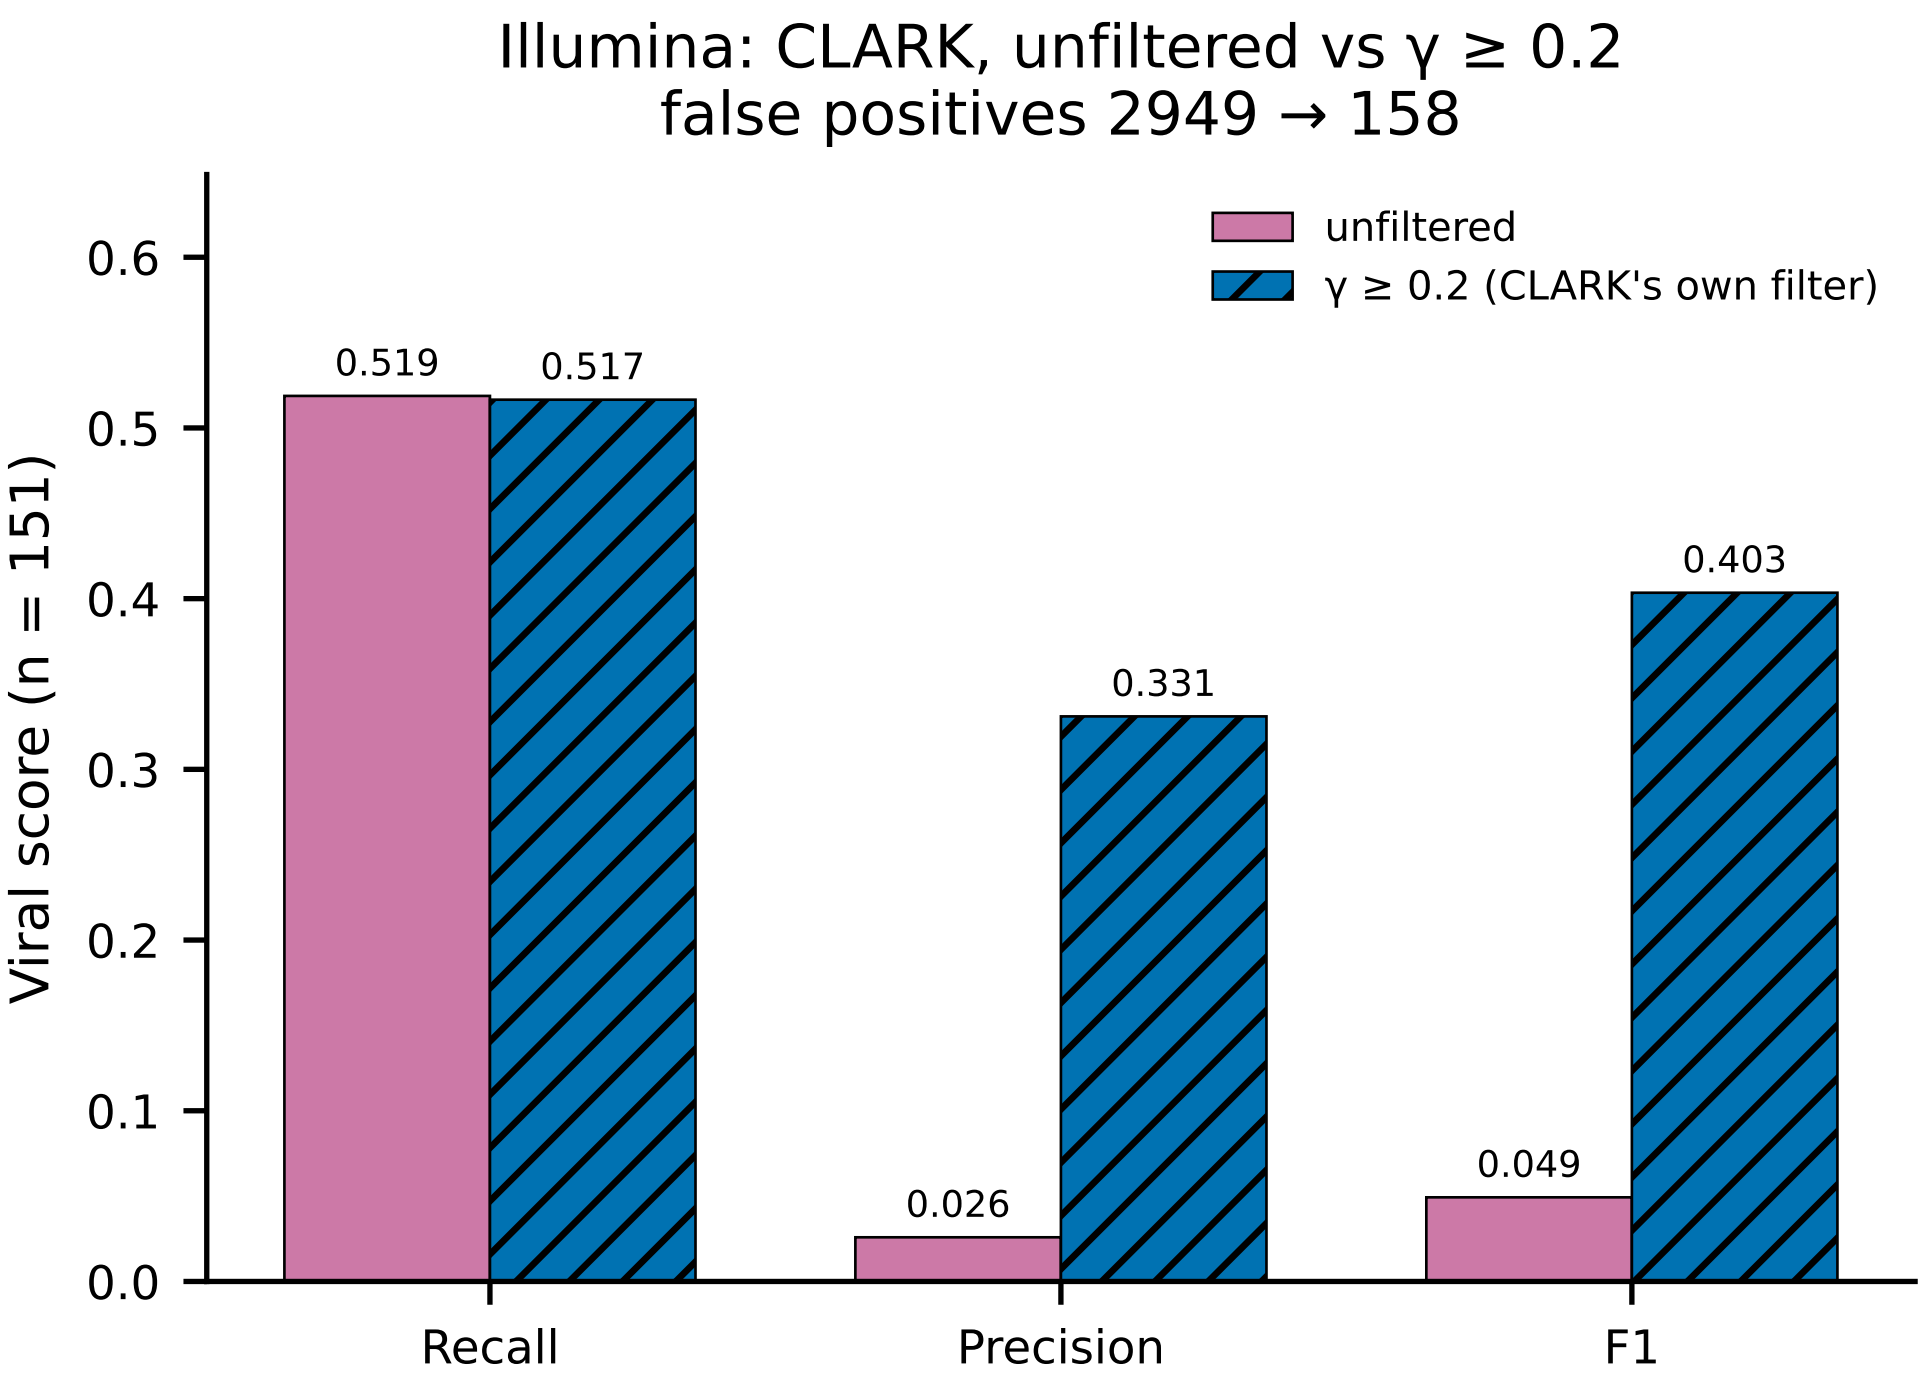
Illumina: CLARK, unfiltered vs γ ≥ 0.2
false positives 2949 → 158
unfiltered
γ ≥ 0.2 (CLARK's own filter)
Viral score (n = 151)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.519
0.517
0.026
0.331
0.049
0.403
Recall
Precision
F1