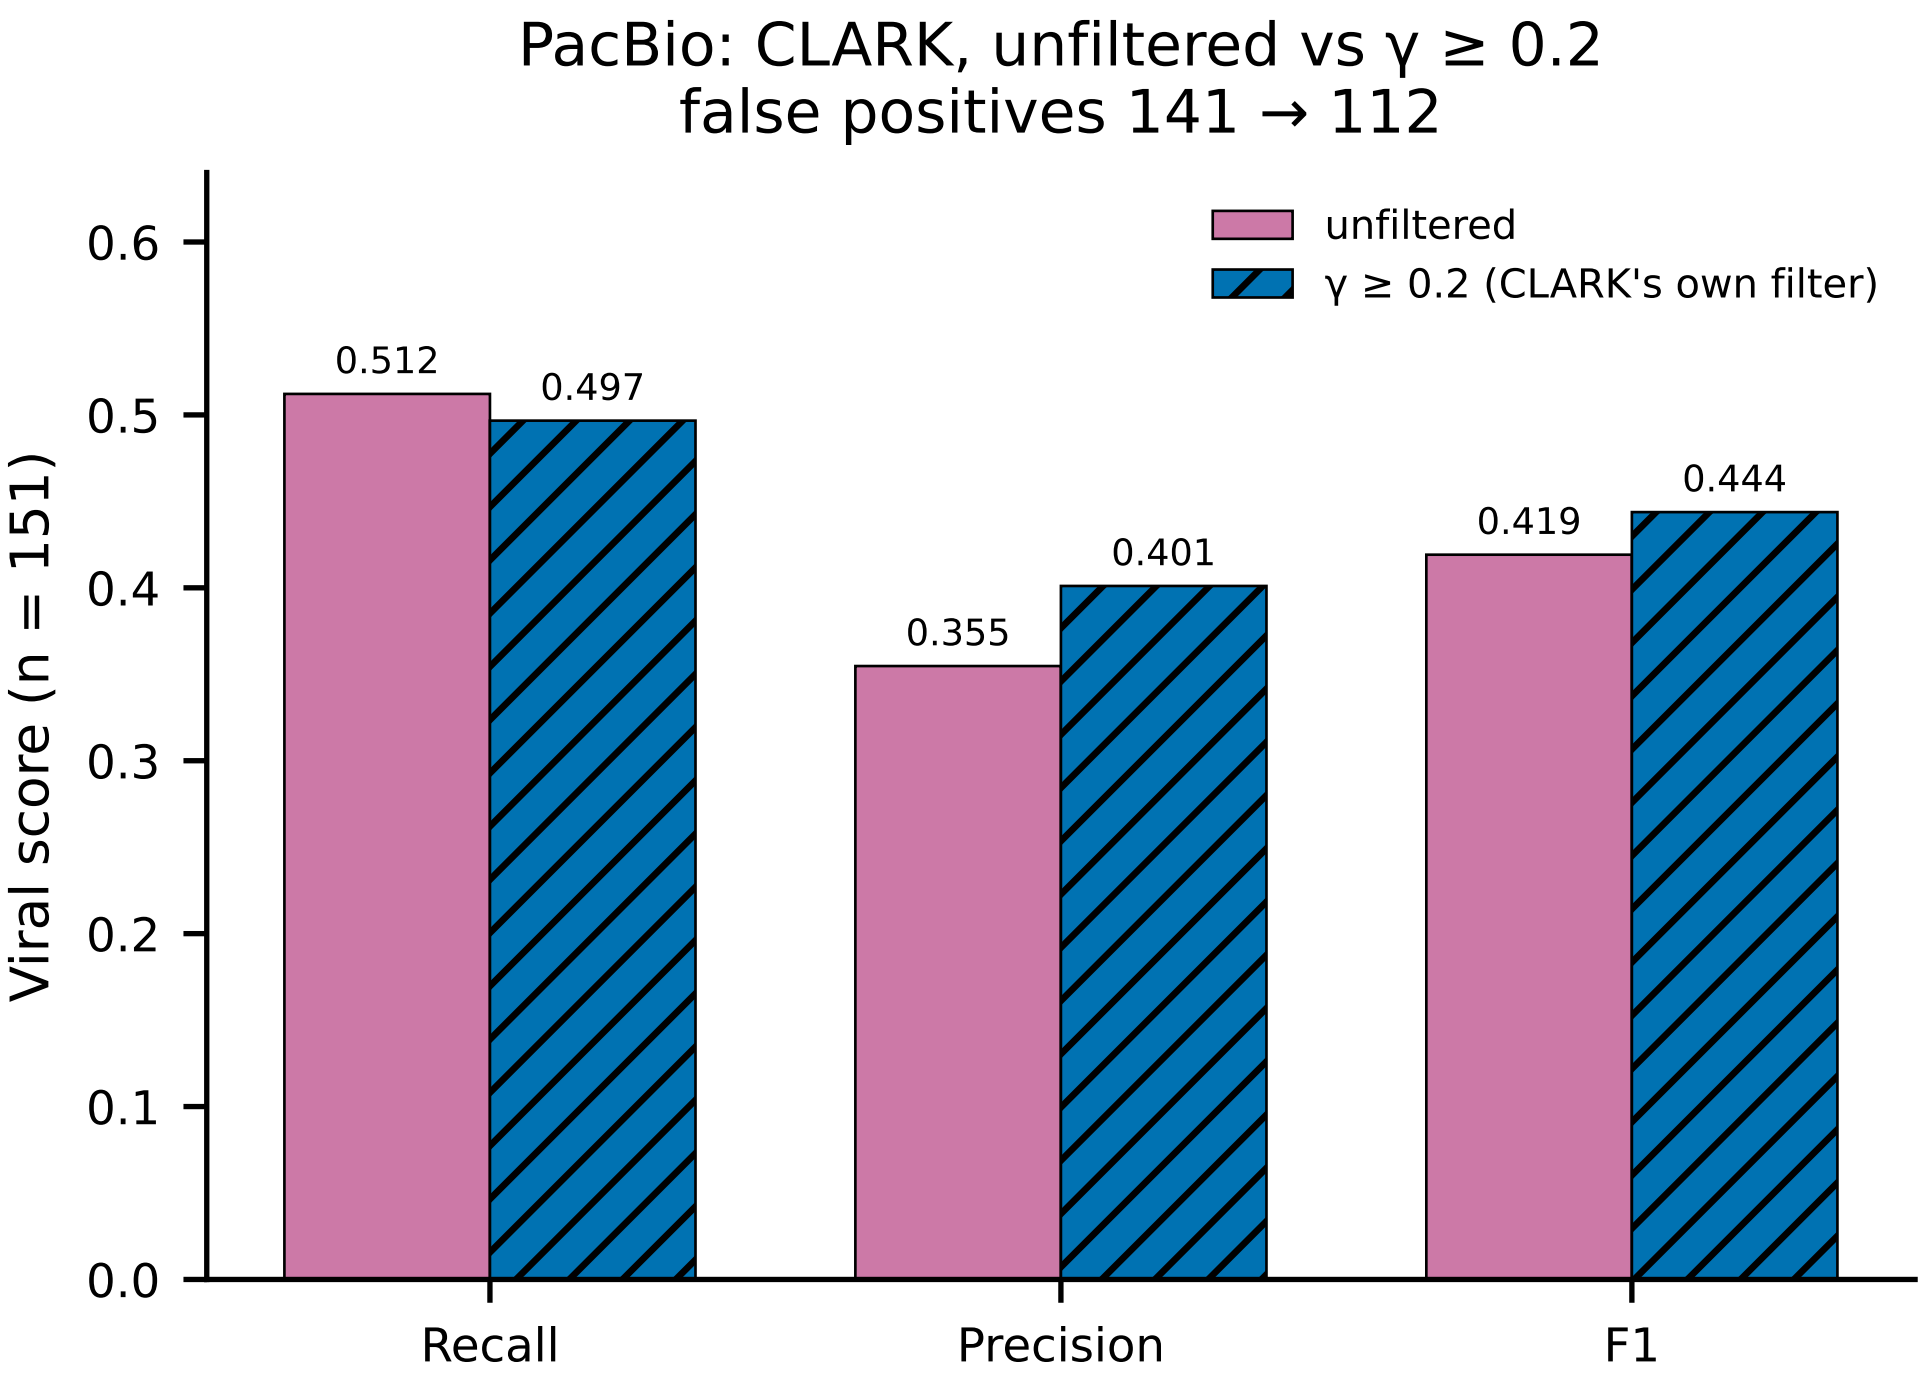
PacBio: CLARK, unfiltered vs γ ≥ 0.2
false positives 141 → 112
unfiltered
γ ≥ 0.2 (CLARK's own filter)
Viral score (n = 151)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.512
0.497
0.355
0.401
0.419
0.444
Recall
Precision
F1