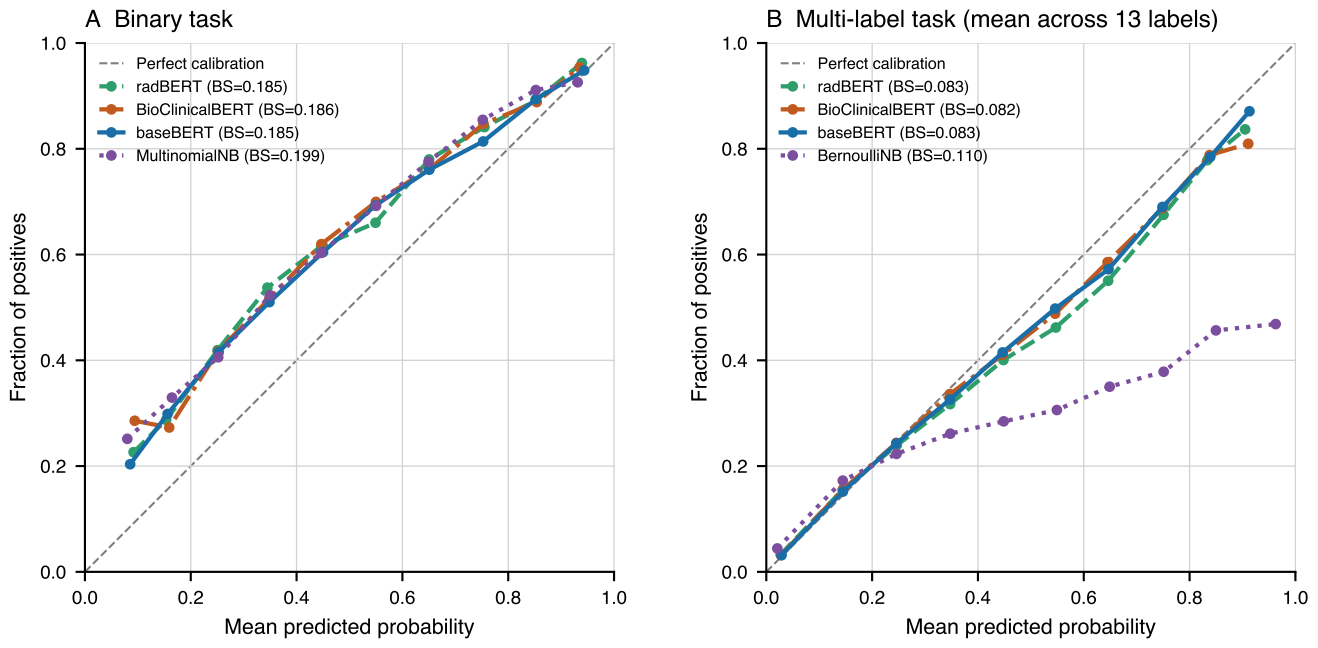
A Binary task
Perfect calibration
radBERT (BS=0.185)
BioClinicalBERT (BS=0.186)
baseBERT (BS=0.185)
MultinomialNB (BS=0.199)
Fraction of positives
Mean predicted probability
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
B Multi-label task (mean across 13 labels)
Perfect calibration
radBERT (BS=0.083)
BioClinicalBERT (BS=0.082)
baseBERT (BS=0.083)
BernoulliNB (BS=0.110)
Fraction of positives
Mean predicted probability