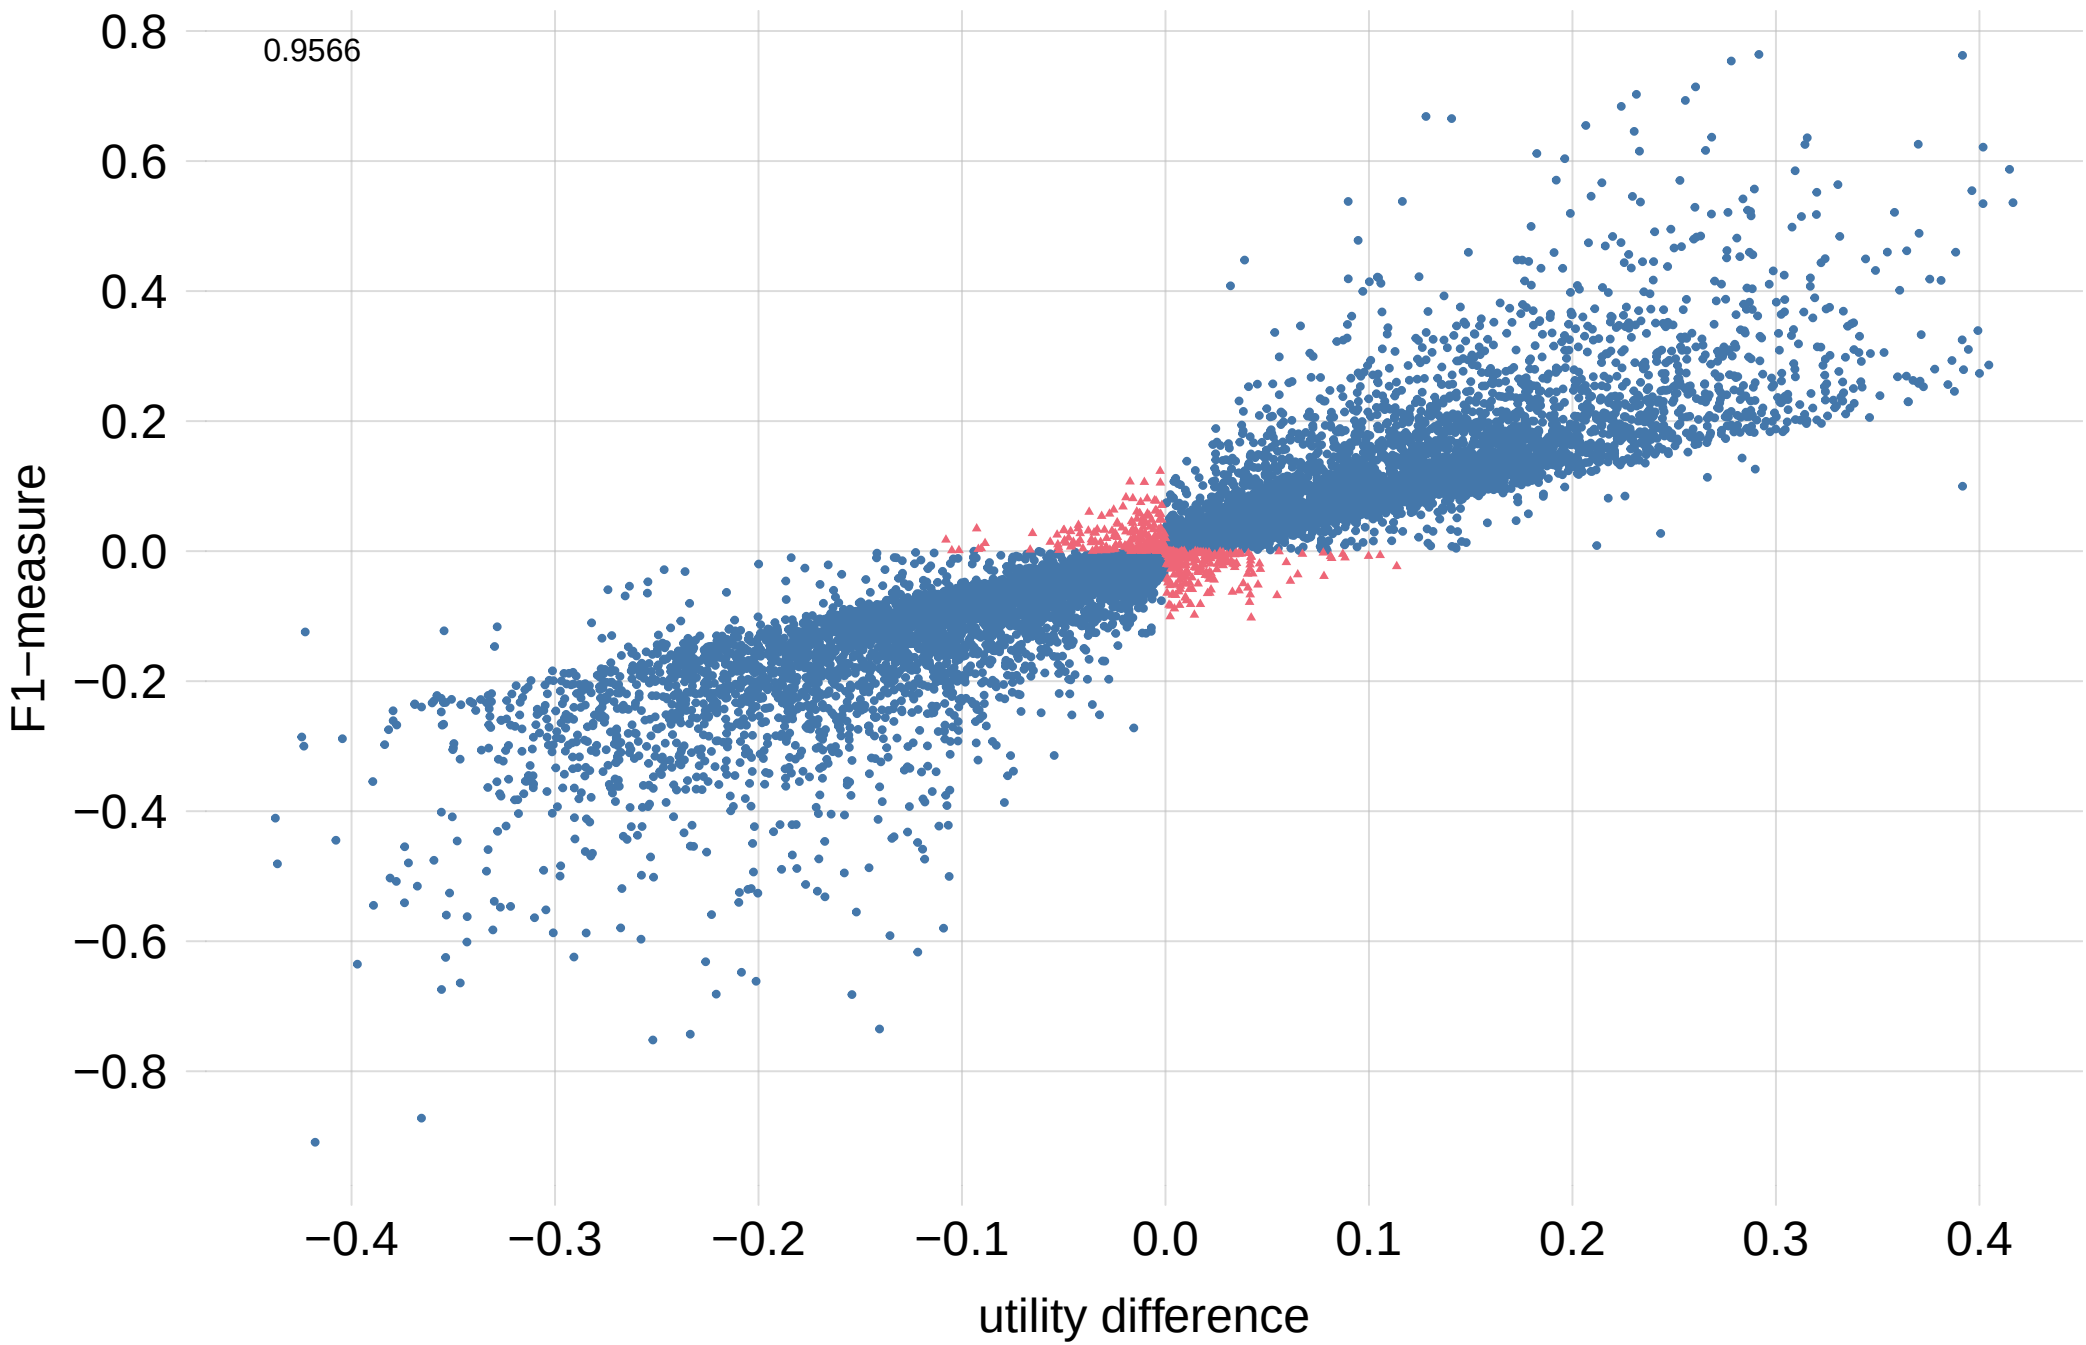
0.9566
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
F1−measure
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
utility difference

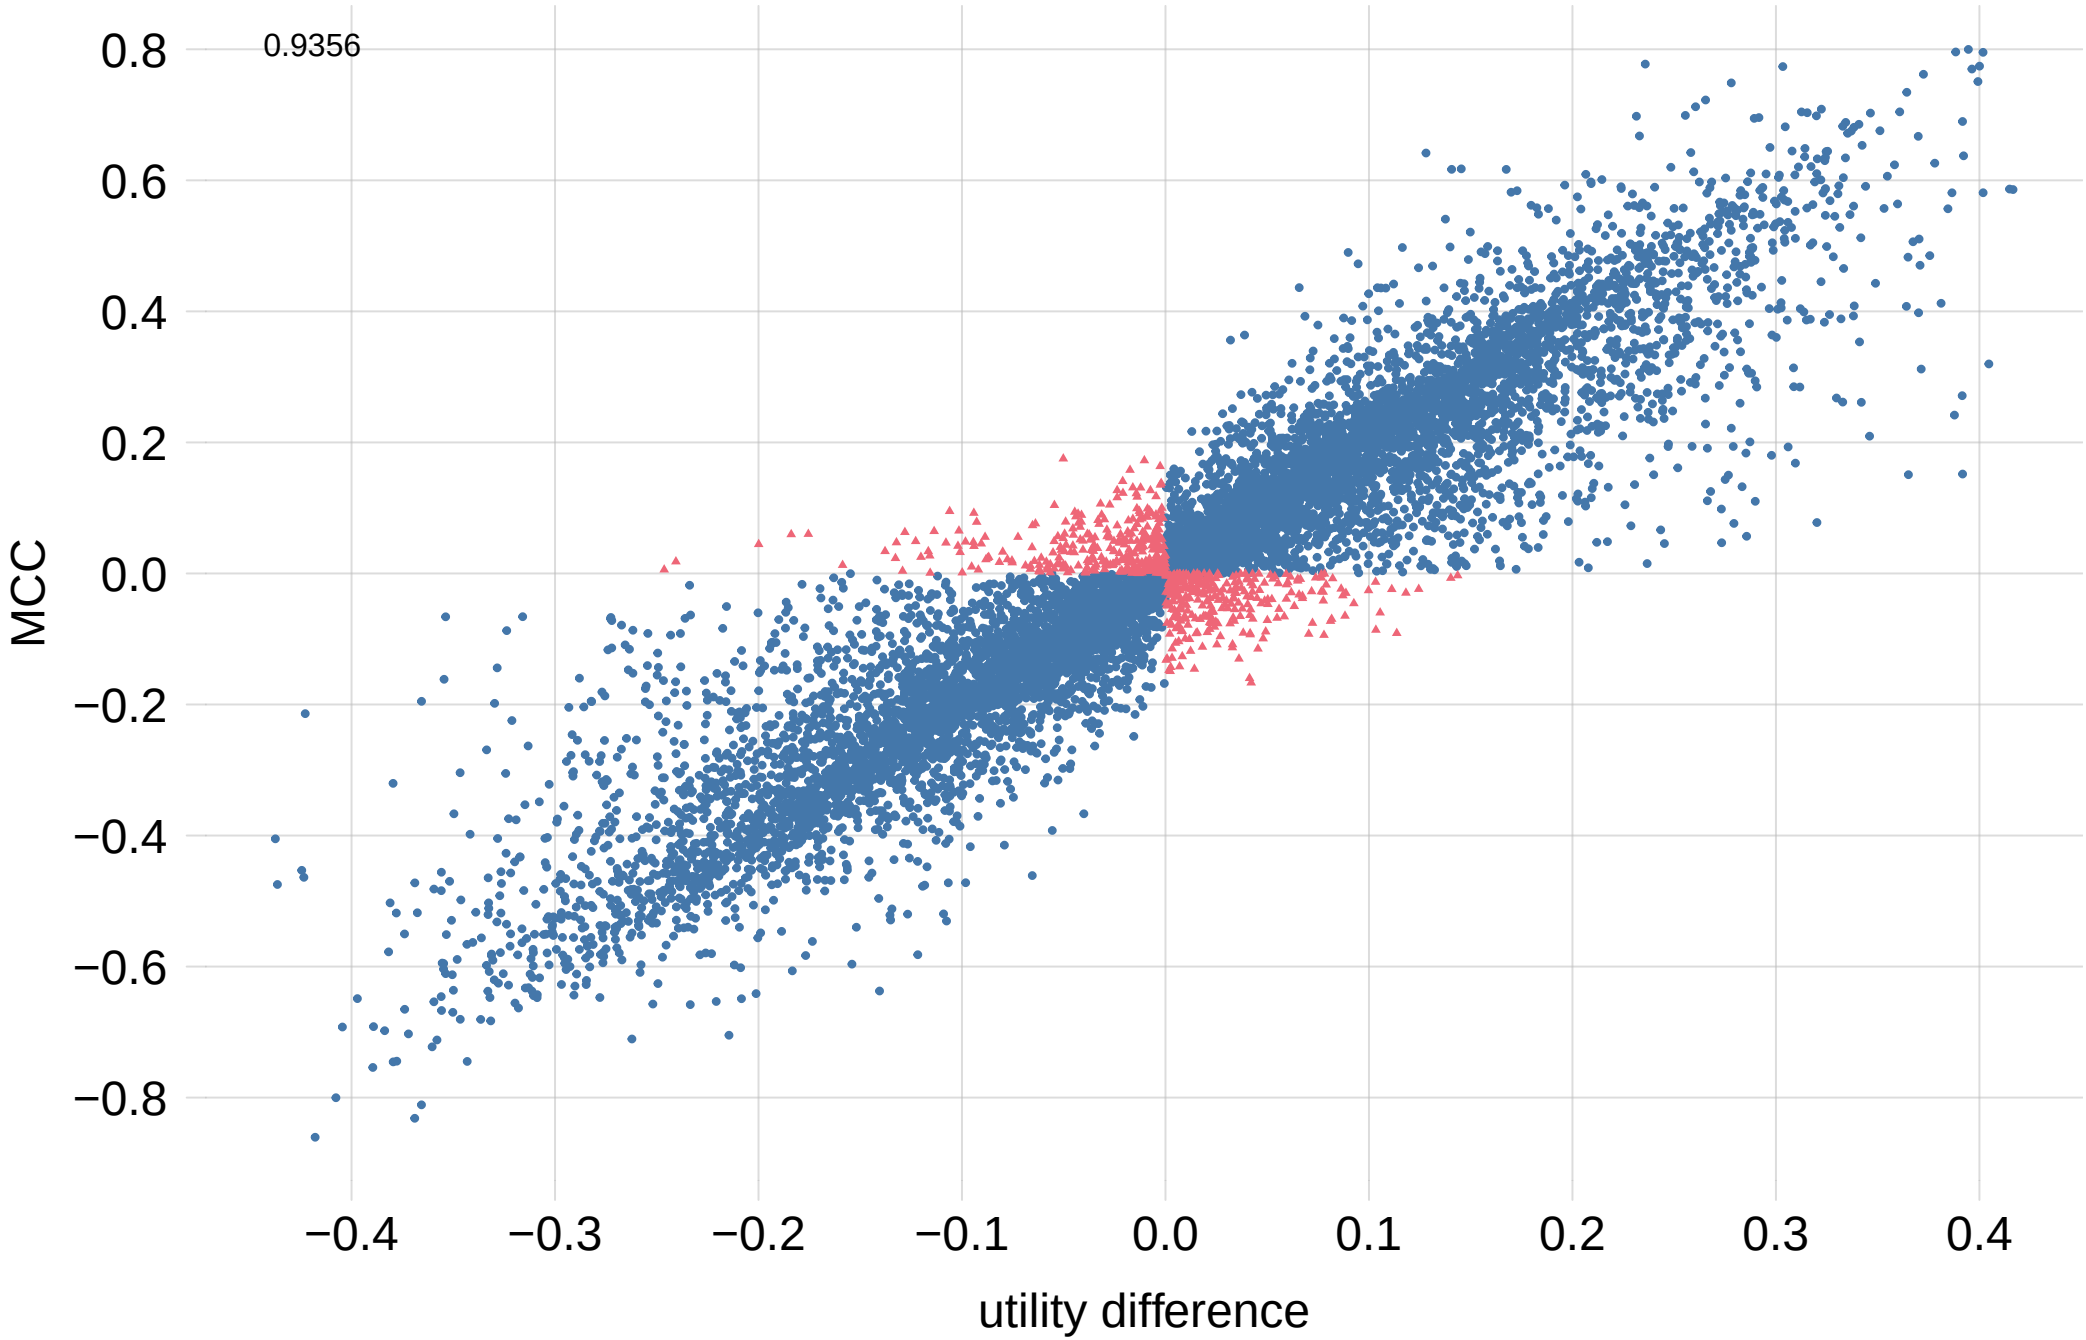
0.9356
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
MCC
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
utility difference

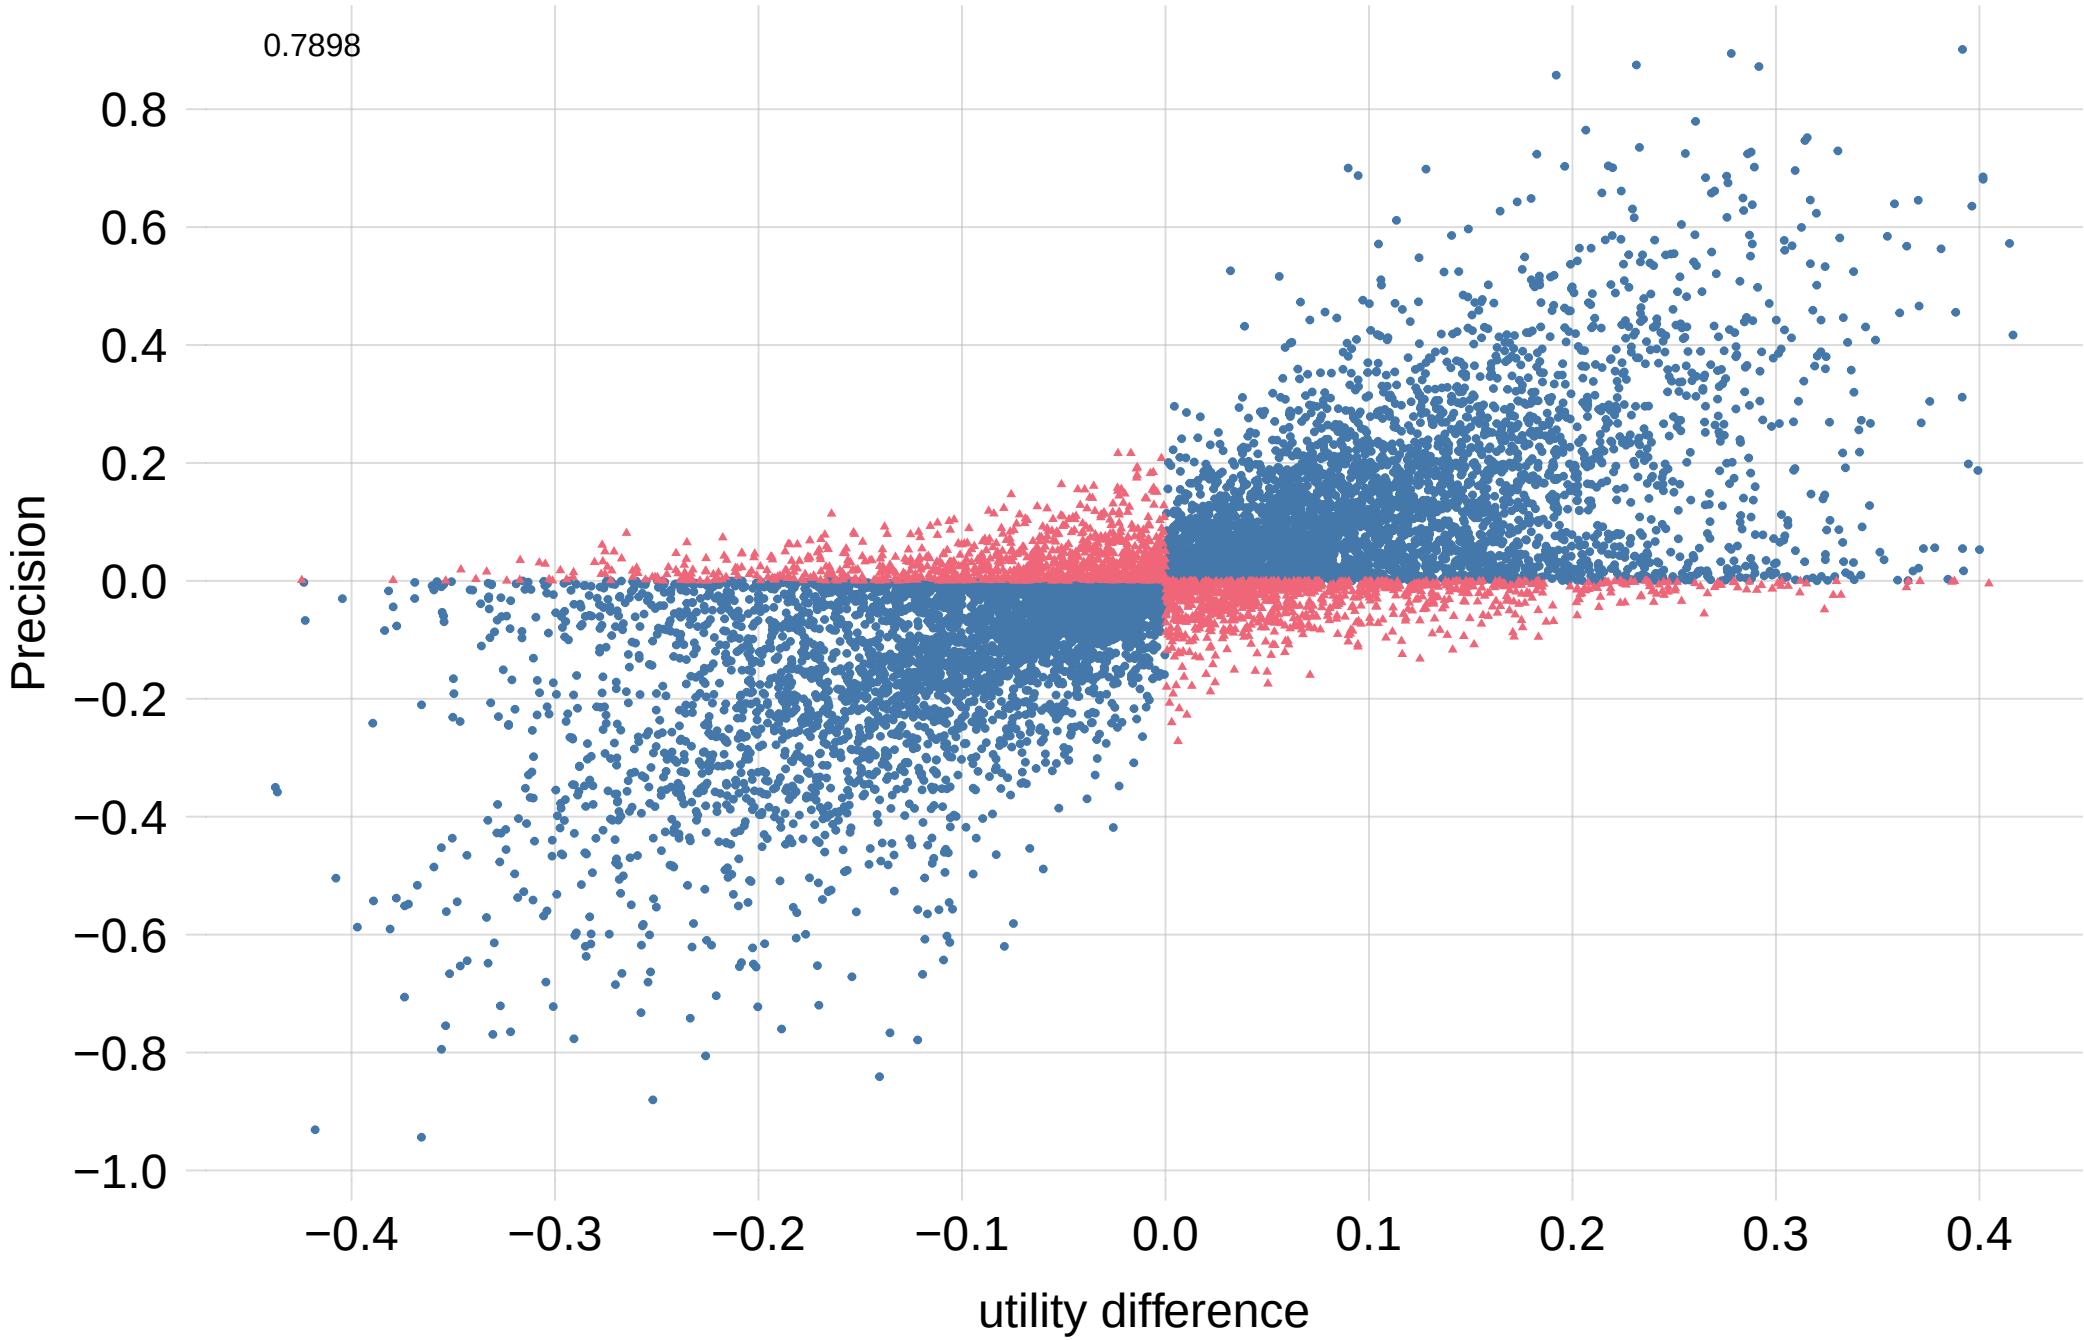
0.7898
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
Precision
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
utility difference

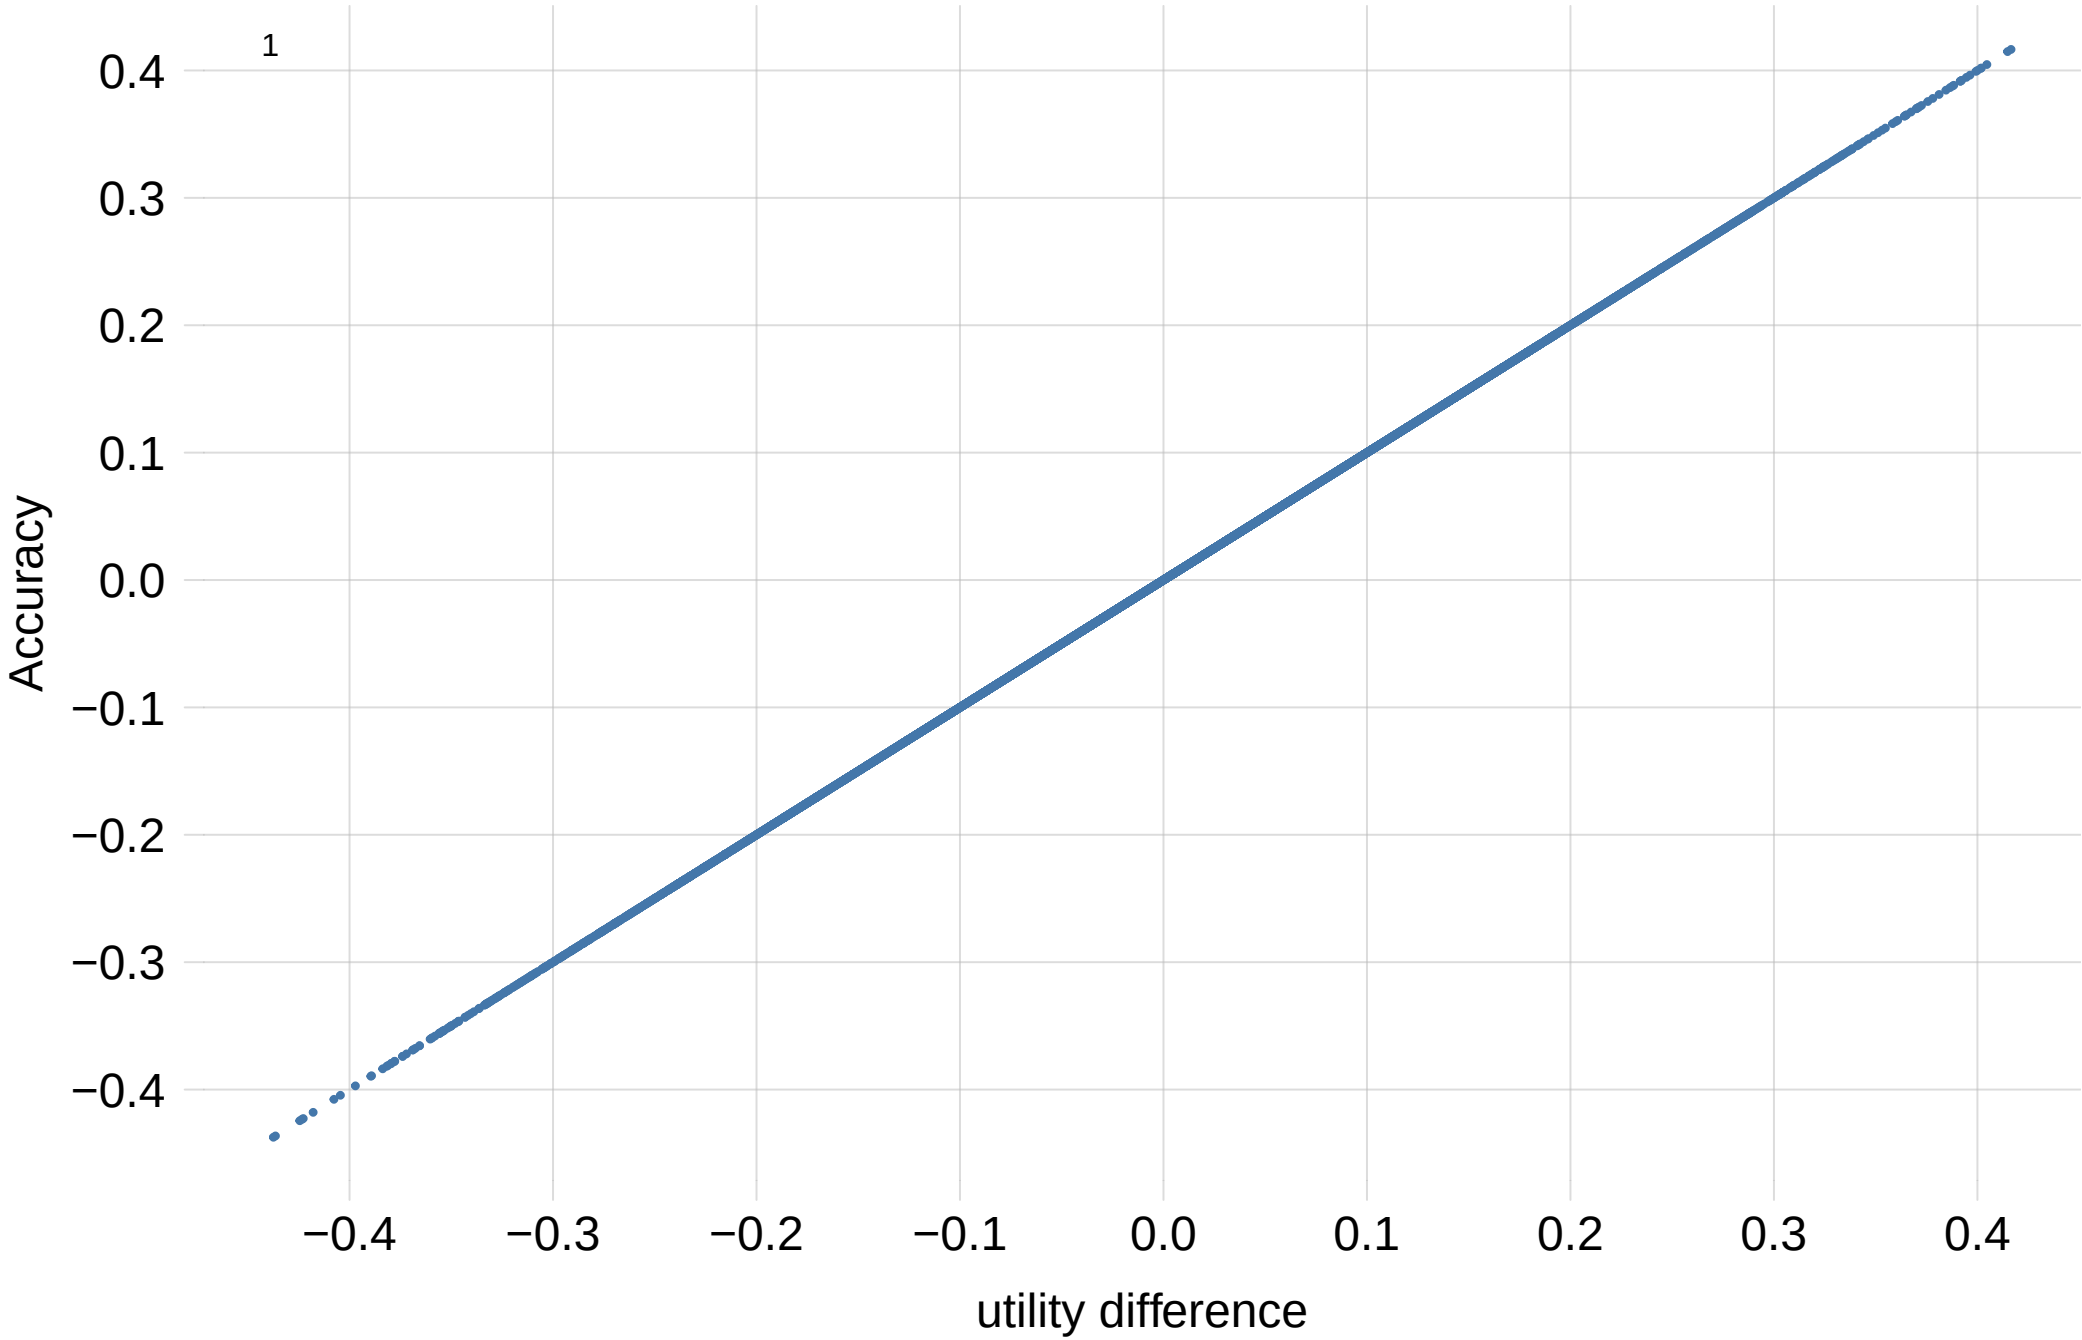
1
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
Accuracy
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
utility difference

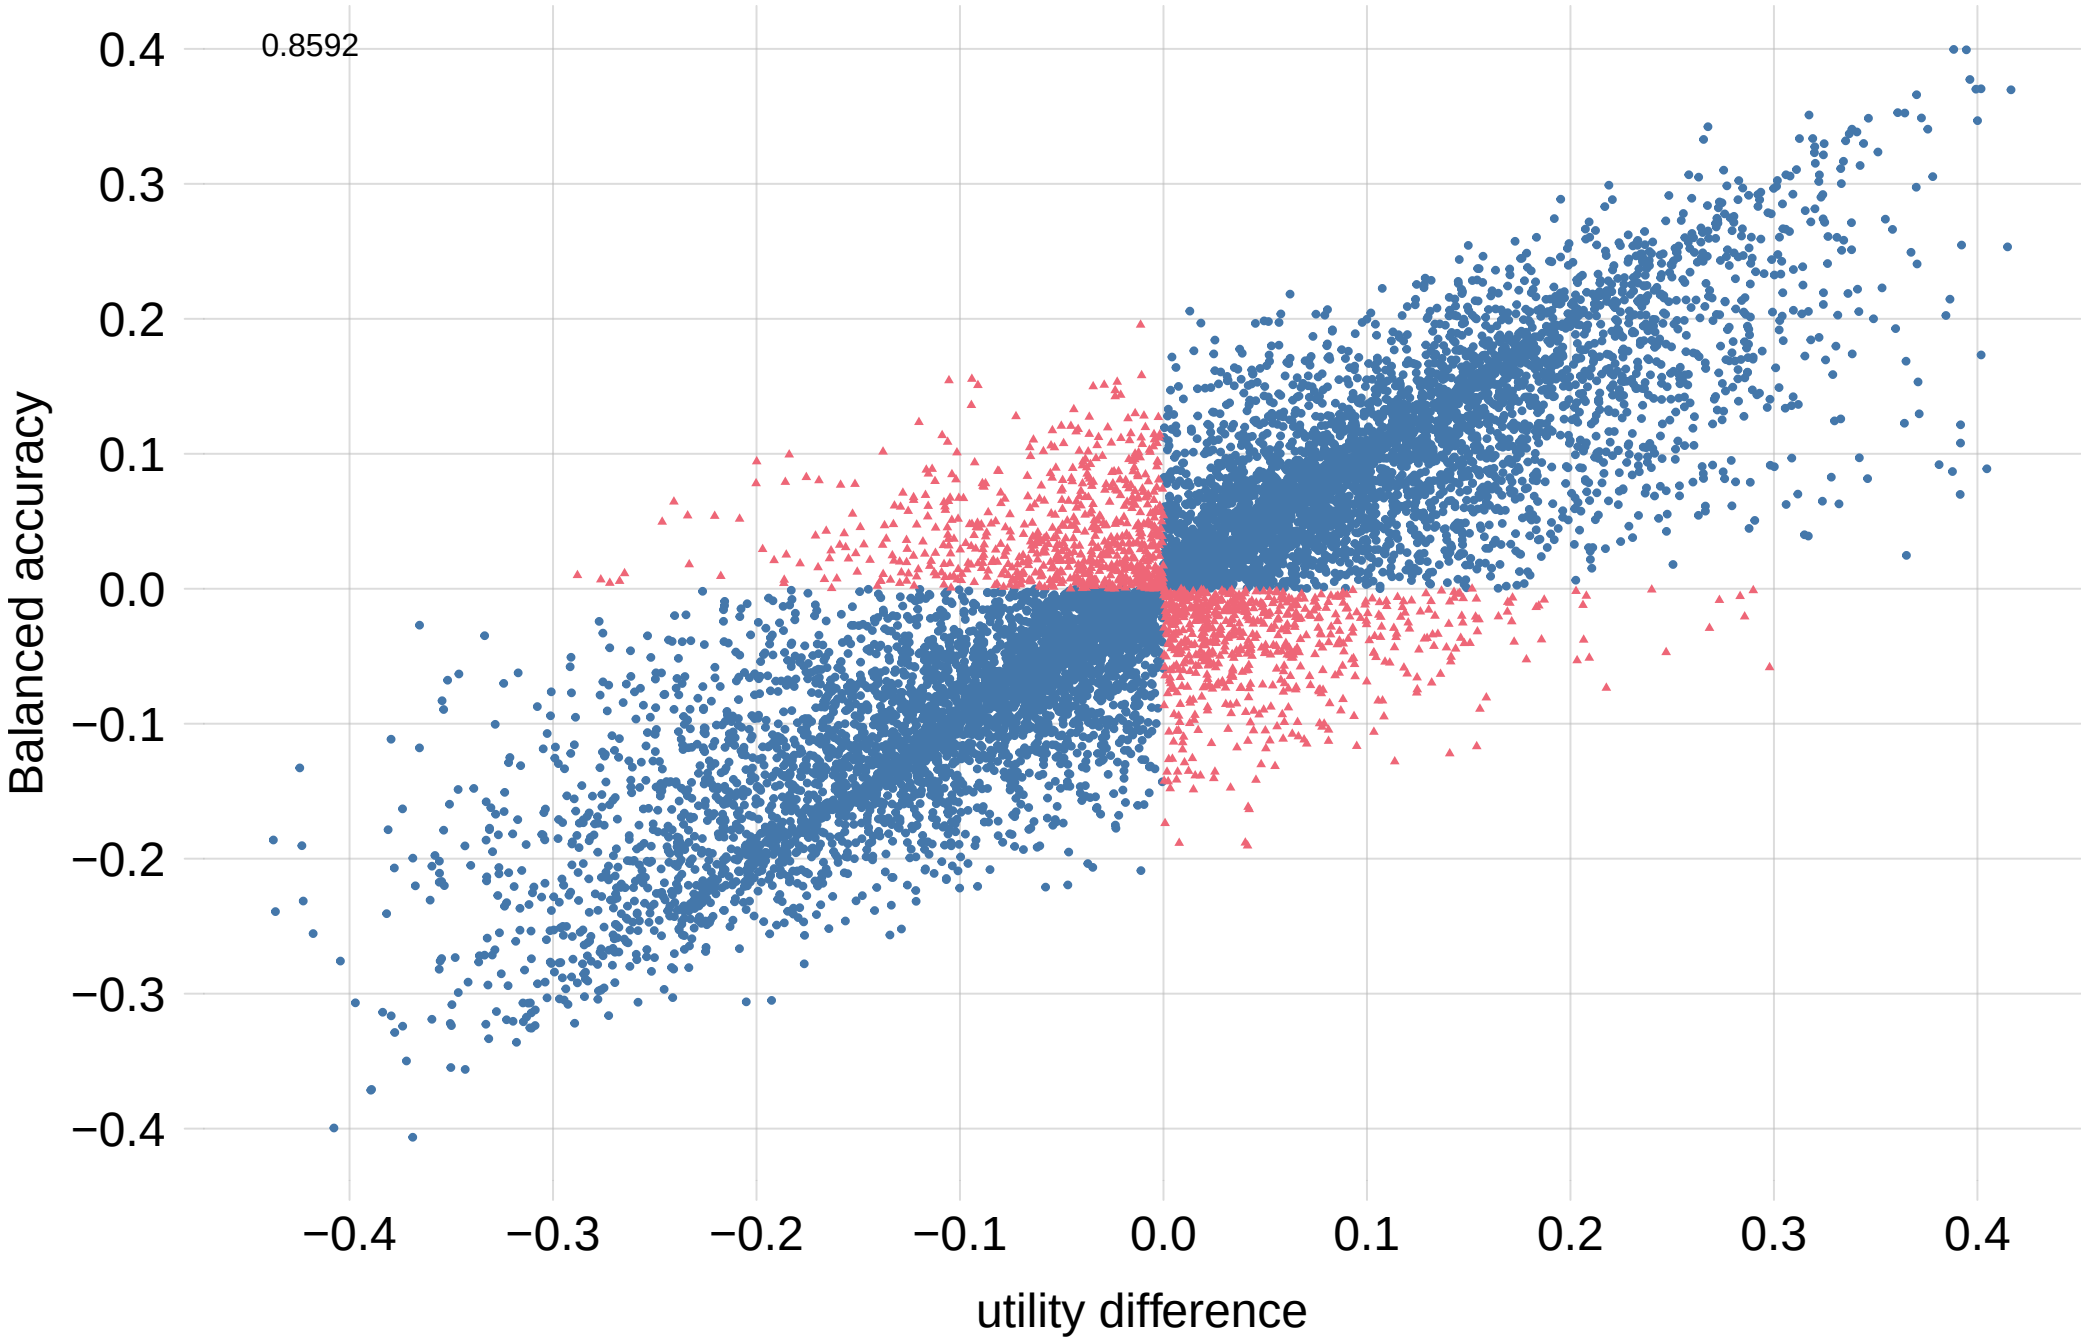
0.8592
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
Balanced accuracy
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
utility difference

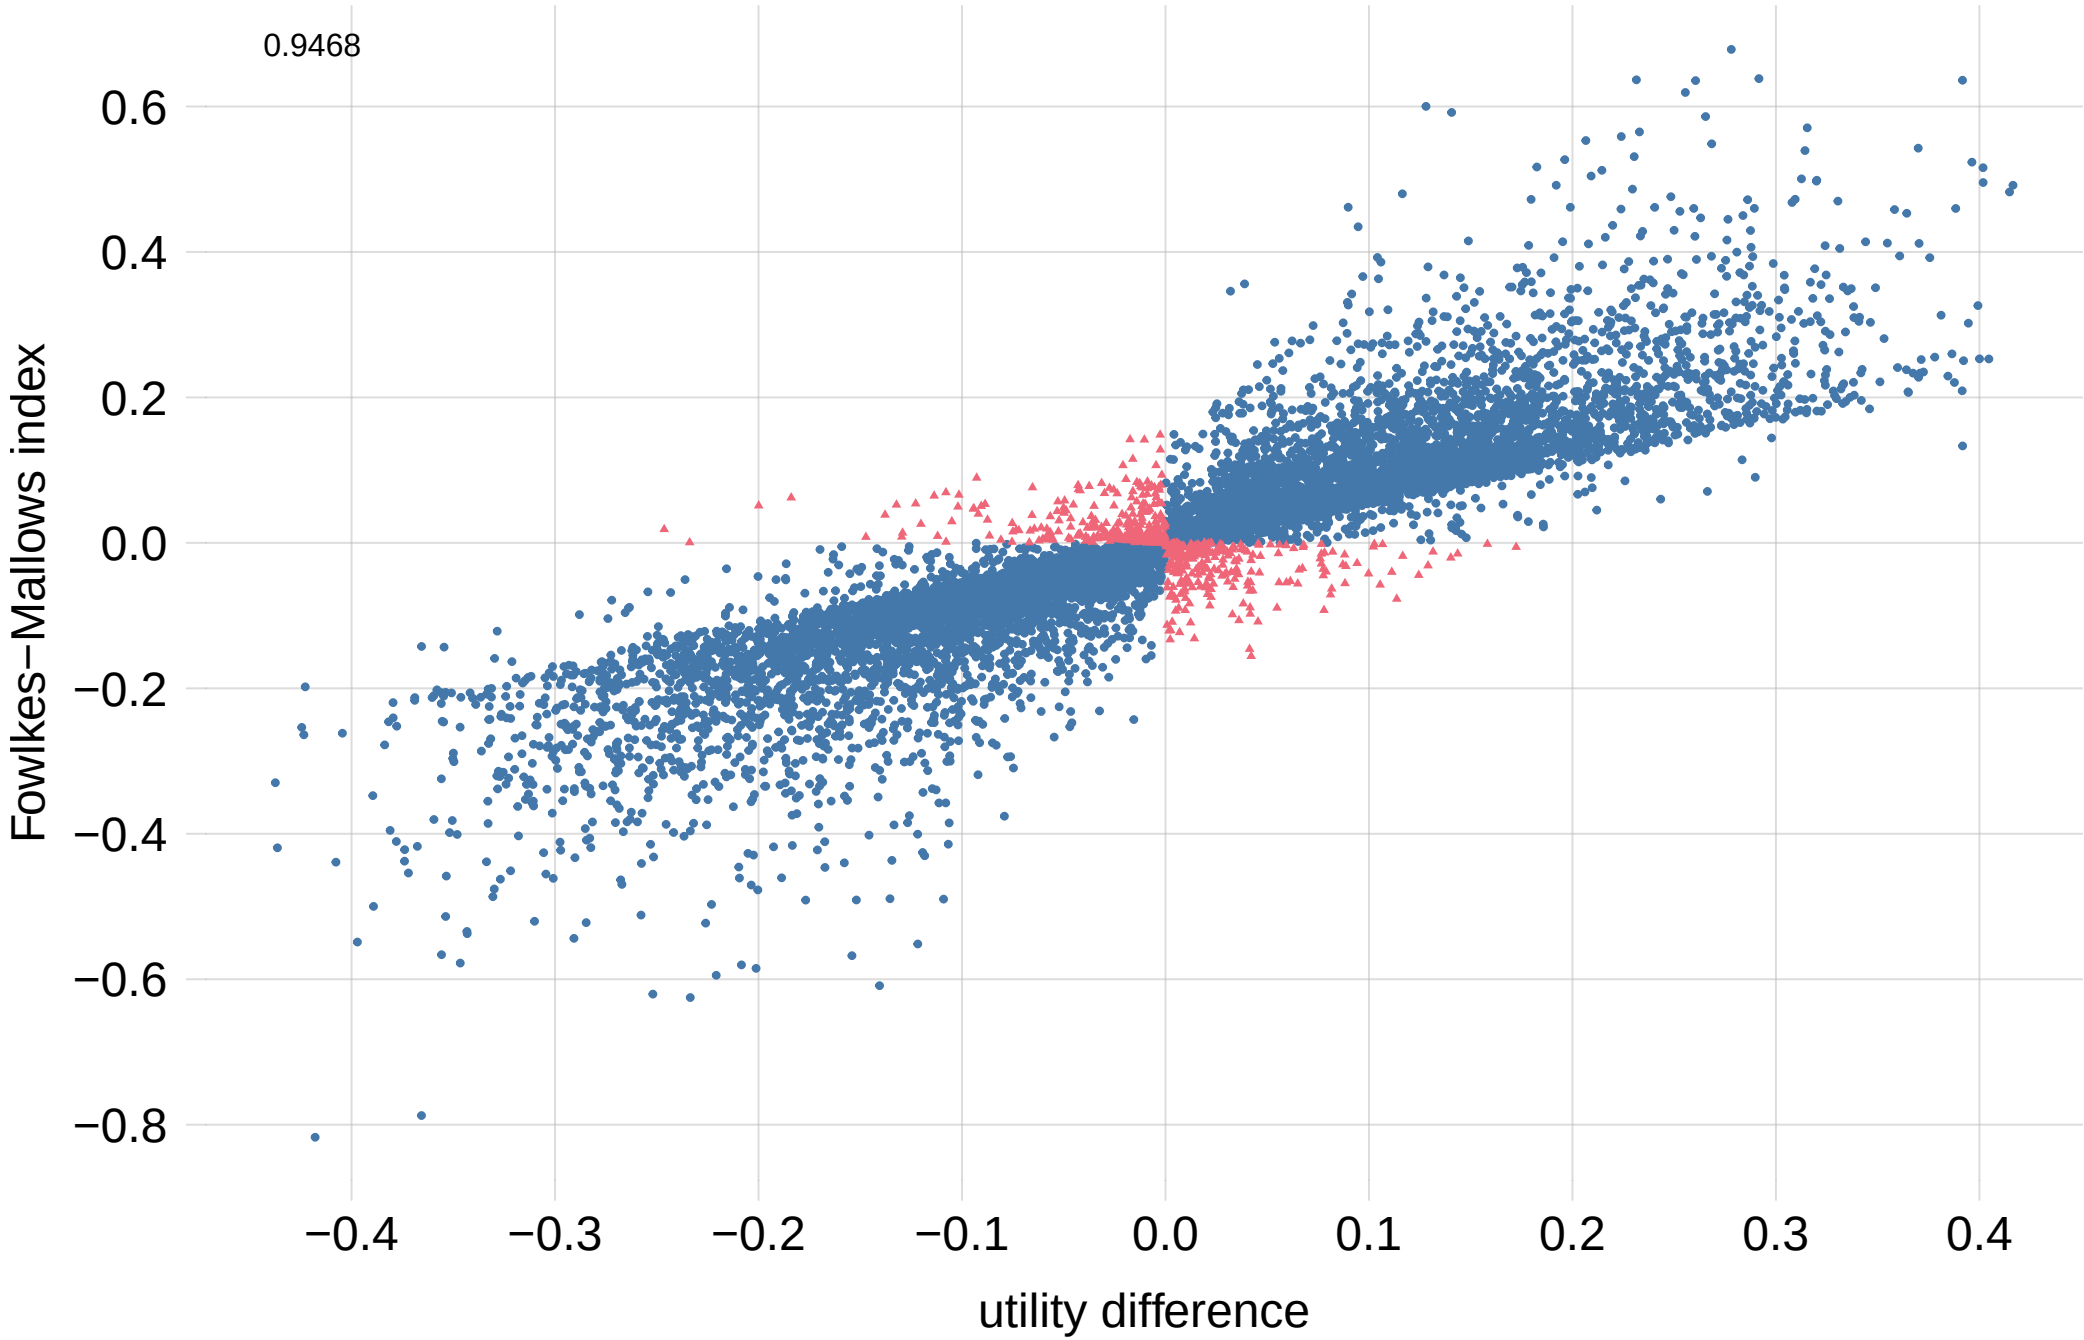
0.9468
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
Fowlkes−Mallows index
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
utility difference

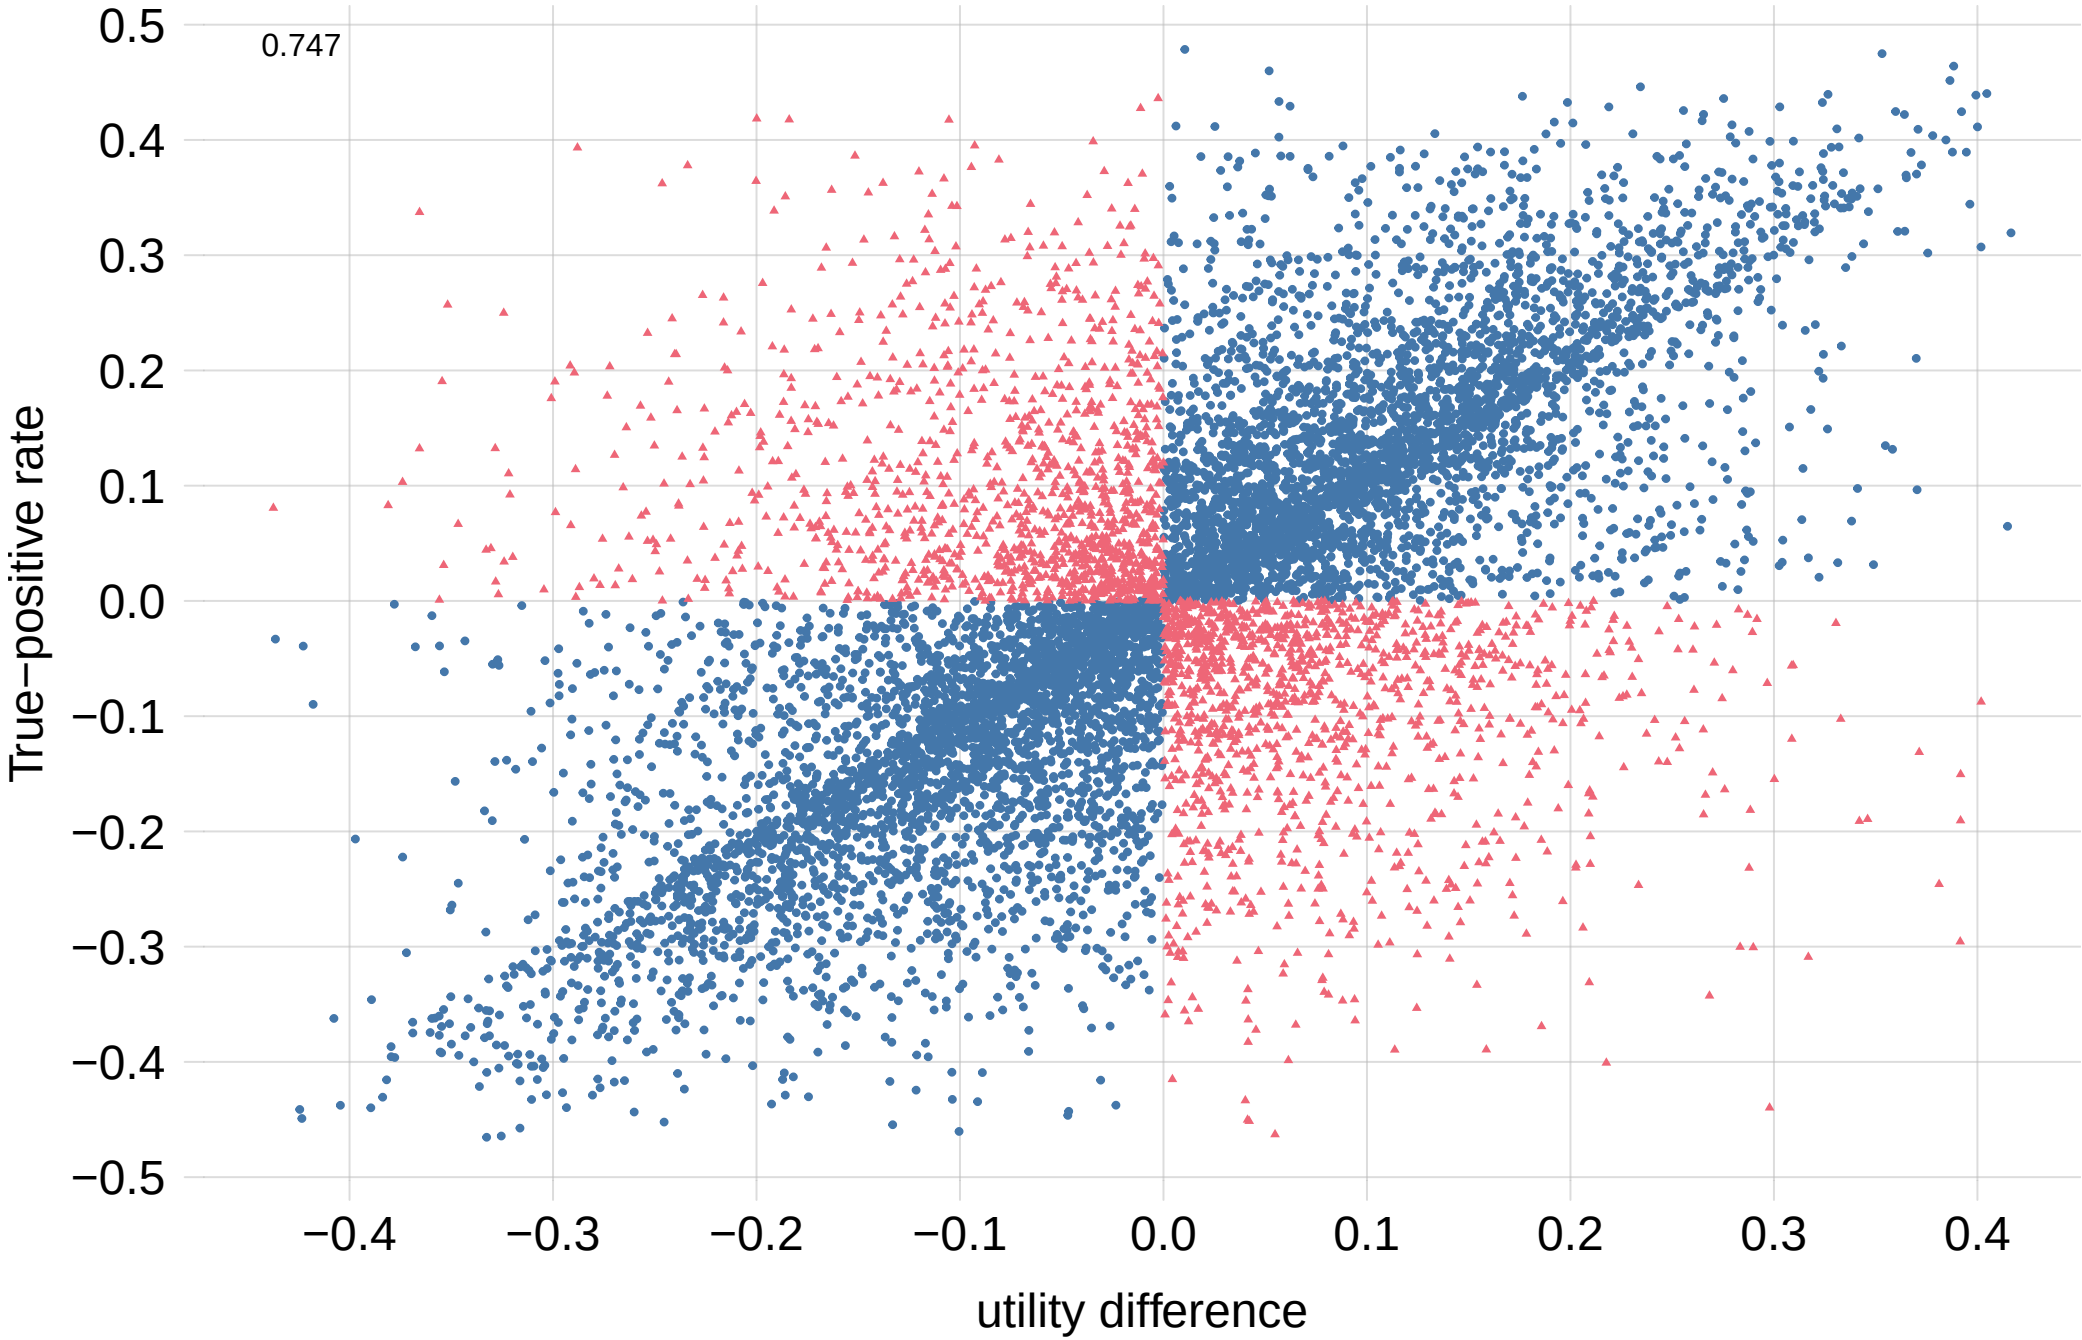
0.747
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
True−positive rate
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
utility difference

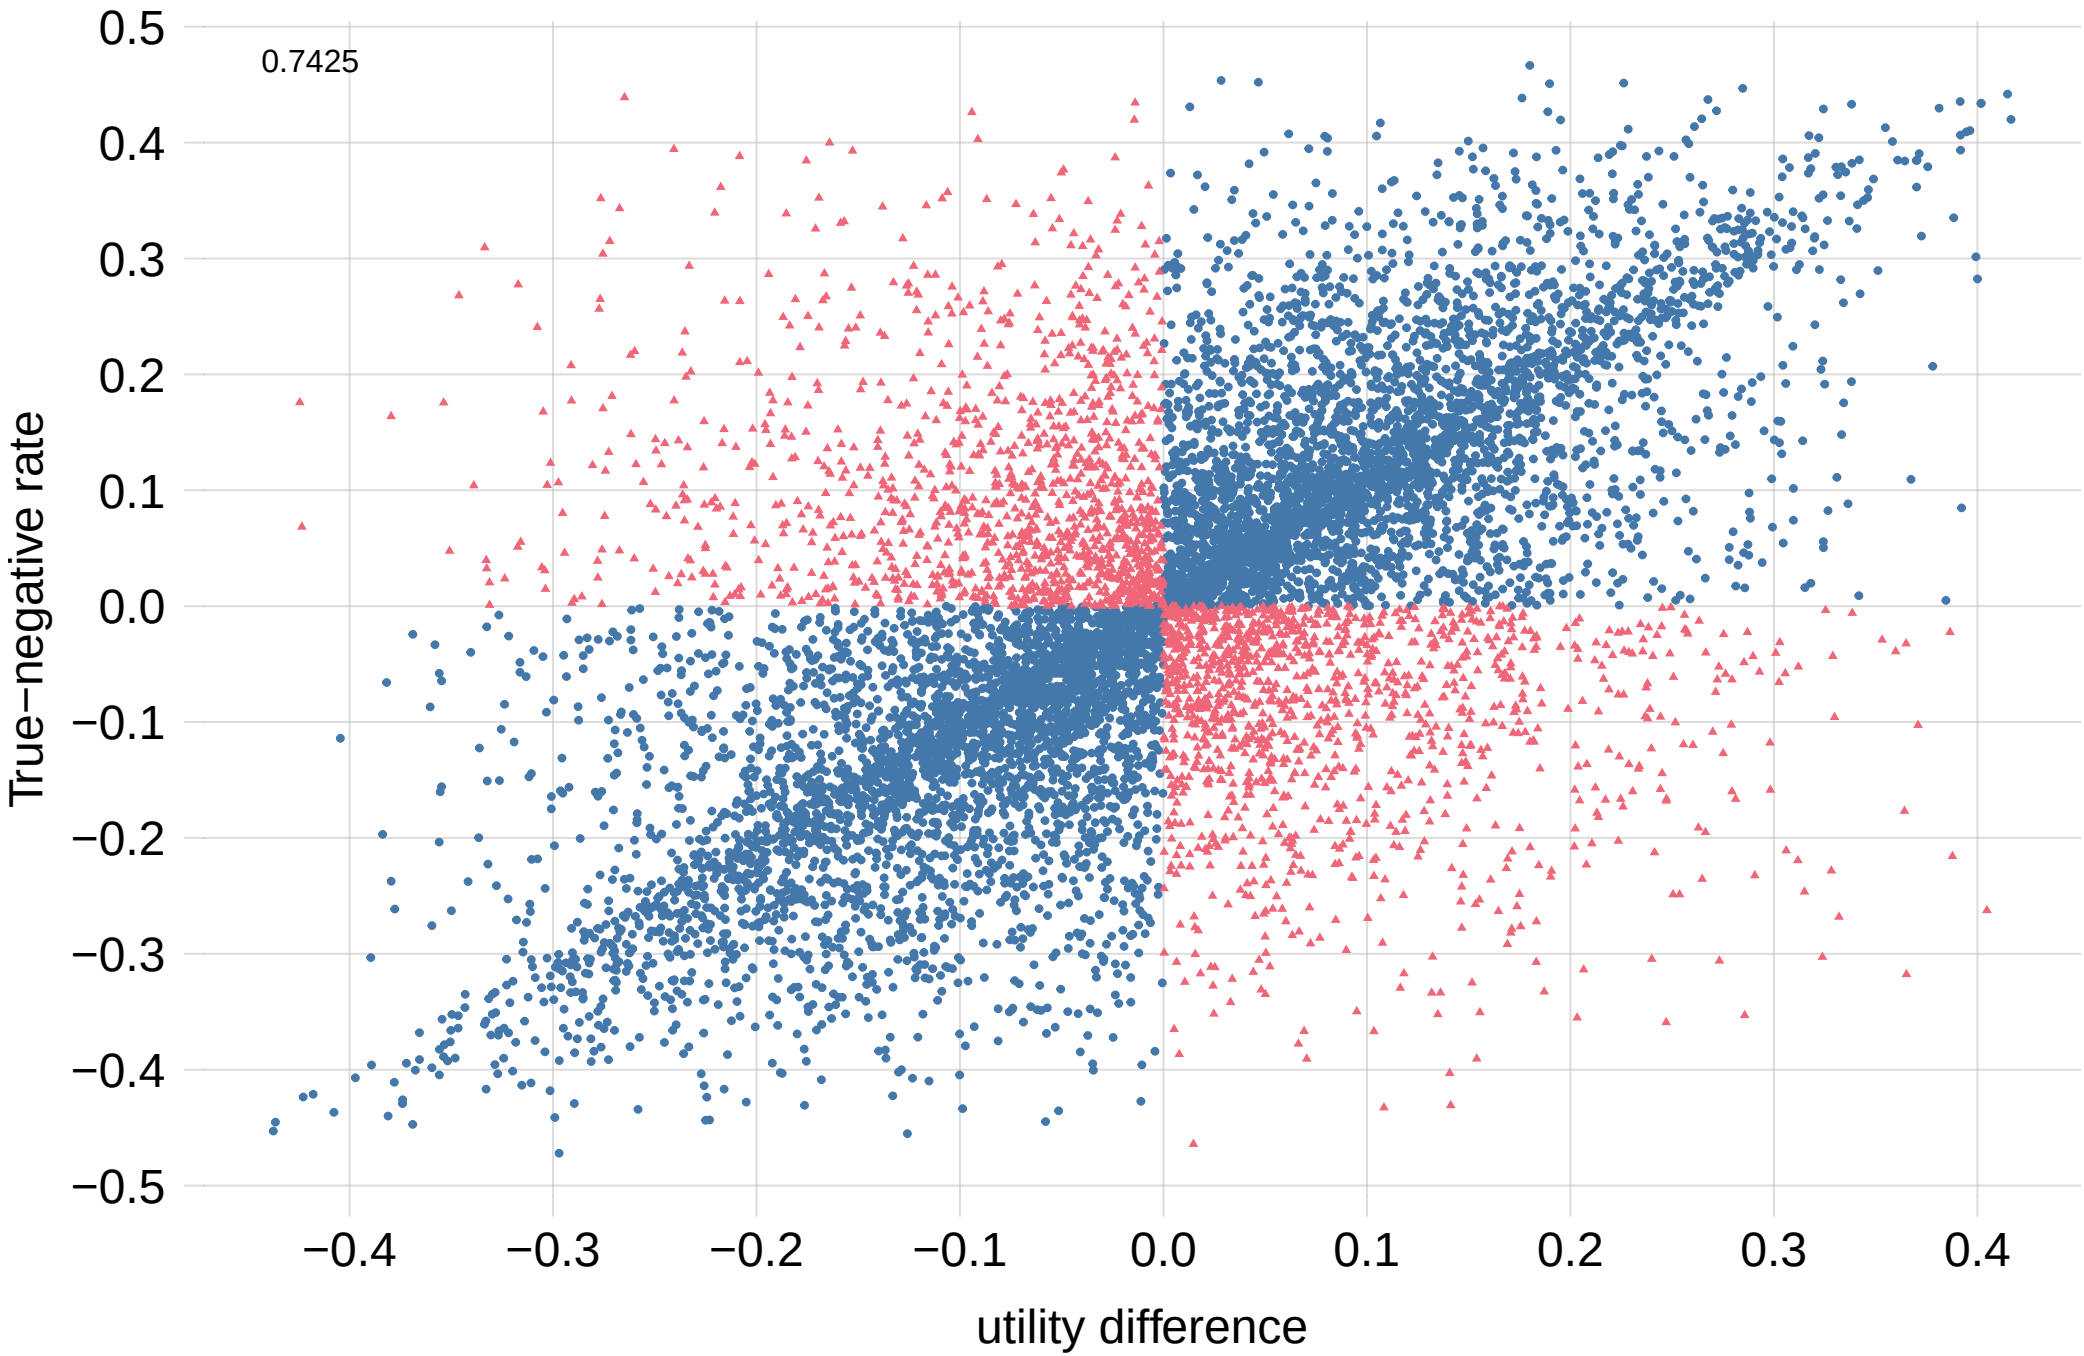
0.7425
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
True−negative rate
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
utility difference

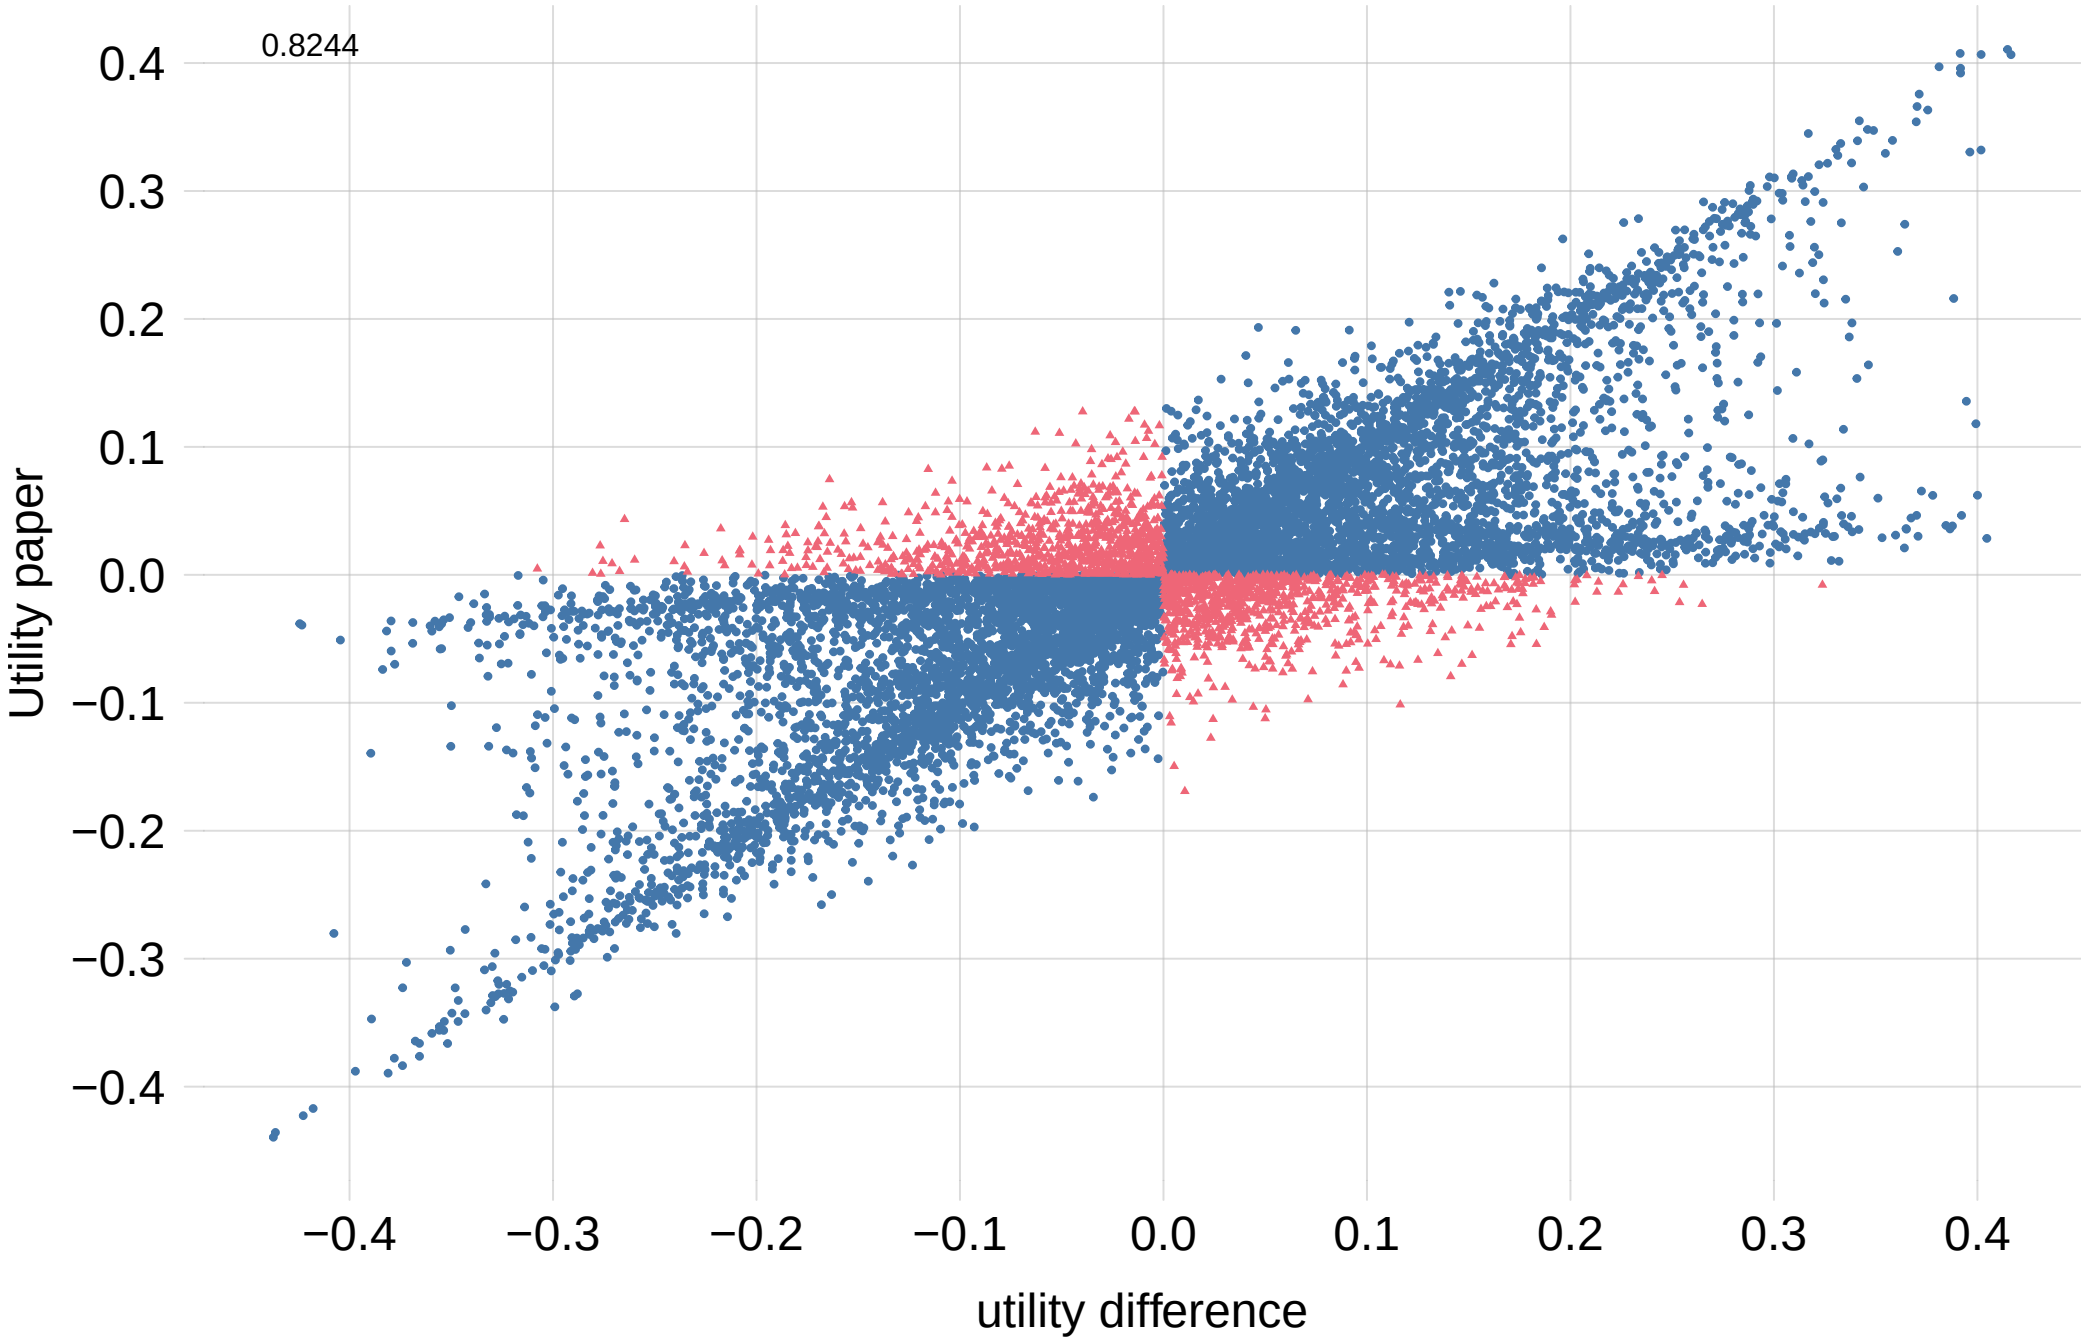
0.8244
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
Utility paper
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
utility difference