
Informe de Calibración y Mediciones por Combinación

Calibración evaluada: P3: Alcohol isopropilico | P4: Agua [Completo (acondicionado)]

Fecha de generación	13/10/2026 15:12
Combinación evaluada	P3: Alcohol isopropilico | P4: Agua [Completo (acondicionado)]
Puesto en ranking global	#38 de 144
Método de cálculo	Completo (acondicionado)
Patrón Cortocircuito / Abierto	Short: short_sonda_3mm_9oct.s1p | Open: open_sonda_3mm_9oct.s1p
Patrones líquidos	Alcohol isopropilico + Agua
Banda de frecuencias analizada	0.001 - 6.0 GHz
Intervalos de evaluación	Int 1: [0.00 - 0.01 GHz] | Int 2: [0.01 - 0.50 GHz] | Int 3: [0.50 - 6.00 GHz]
Score Promedio Global (todos)	0.6207
Score Promedio Patrones (ajuste in-sample)	n/a
Score Promedio Muestras (validación)	0.6207
Acondicionamiento de Gn	transicion_polinomica_cero (automatico)


Diagnóstico de Conductancia Normalizada Gn(f)

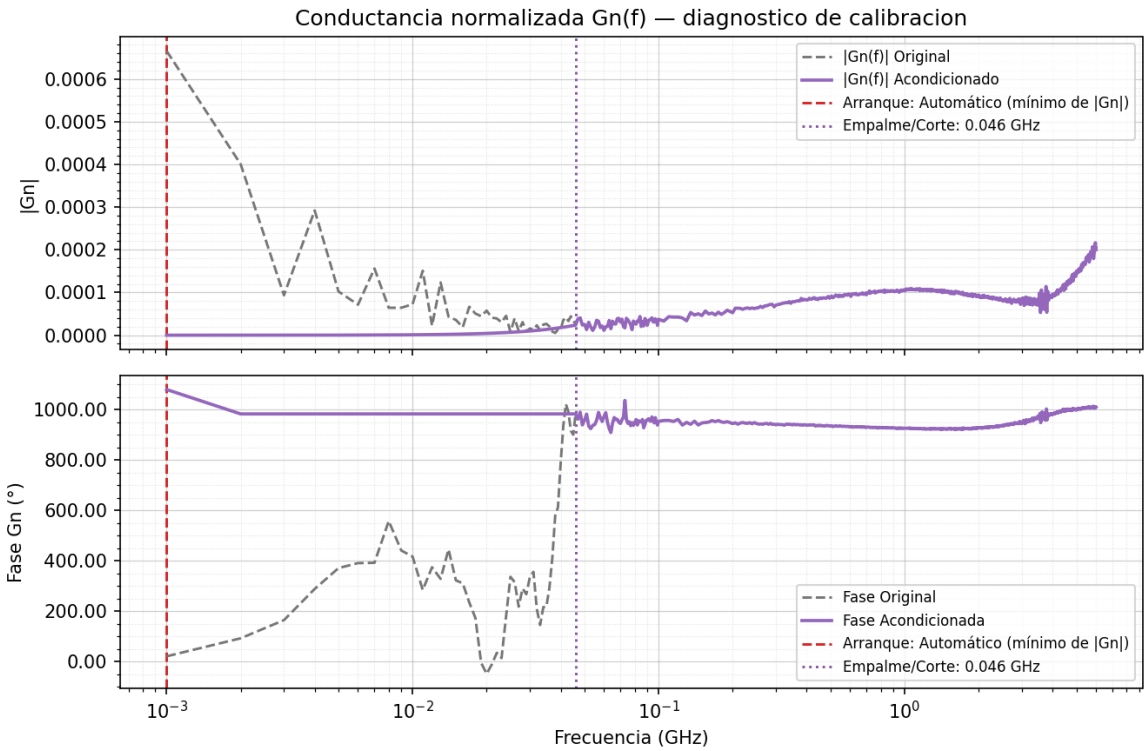

Resumen de Líquidos Evaluados con esta Calibración

Líquido / Muestra	Rol	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
Alcohol etilico	Muestra	1.1611	0.2819	0.2031	**0.5487**
Butanol	Muestra	0.7425	0.0939	0.0204	**0.2856**
Ciclohexano	Muestra	1.2111	0.1109	0.0196	**0.4472**
Acetona	Muestra	2.5058	0.3686	0.7297	**1.2014**


Medición de líquido: Alcohol etilico [Muestra]

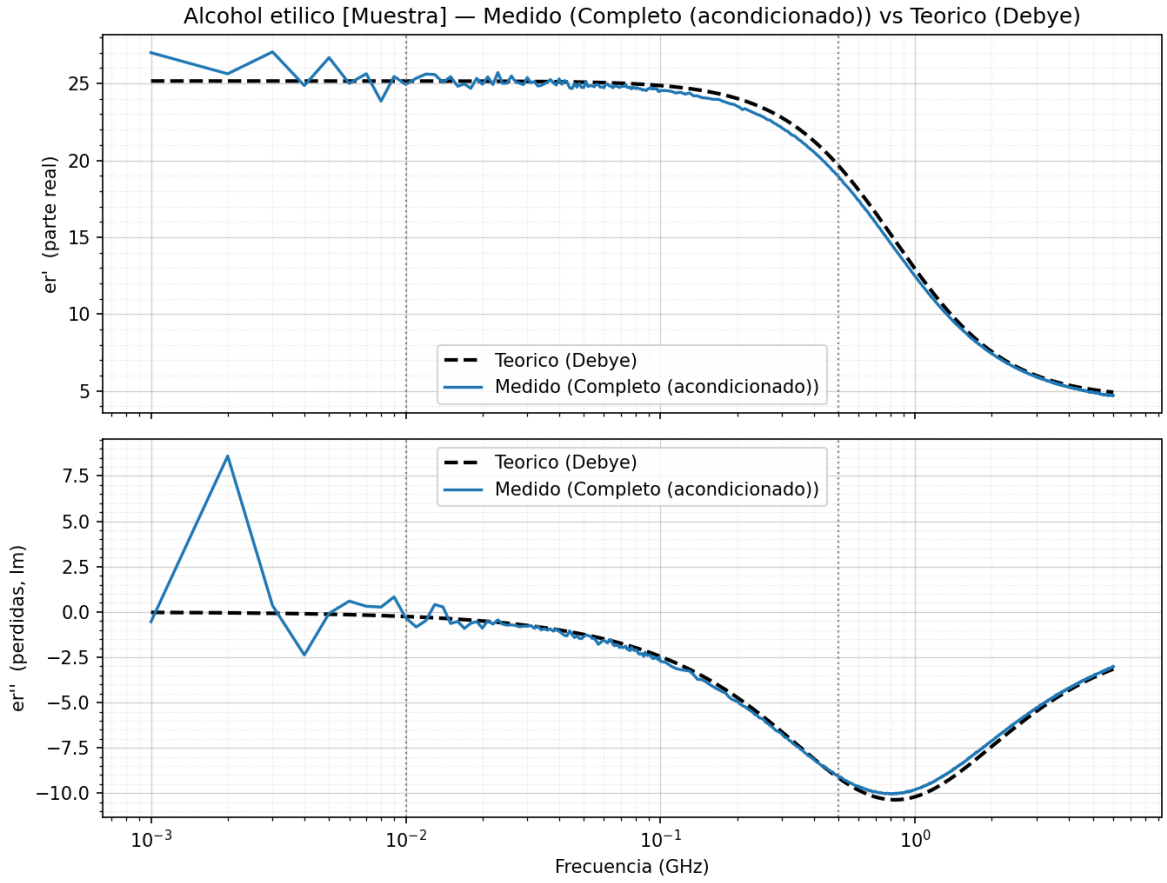

Desglose de error absoluto por intervalo — Alcohol etilico

Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
0.00 - 0.01 GHz	0.8484	1.8939	1.4738	8.6523
0.01 - 0.50 GHz	0.4073	0.7458	0.1564	0.7340
0.50 - 6.00 GHz	0.2027	0.7461	0.2036	0.4341


Medición de líquido: Butanol [Muestra]

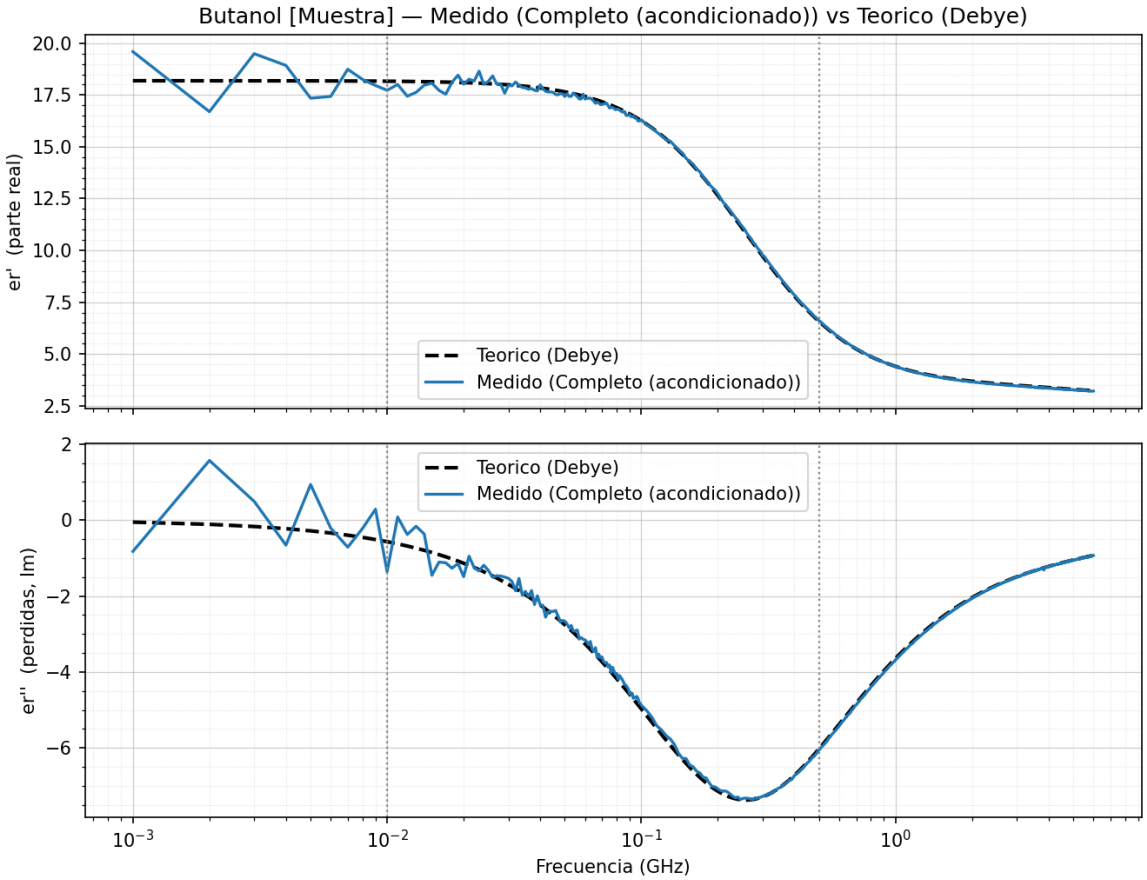

Desglose de error absoluto por intervalo — Butanol

Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
0.00 - 0.01 GHz	0.7826	1.4926	0.7024	1.6799
0.01 - 0.50 GHz	0.0950	0.7155	0.0929	0.7898
0.50 - 6.00 GHz	0.0253	0.0550	0.0155	0.0611


Medición de líquido: Ciclohexano [Muestra]

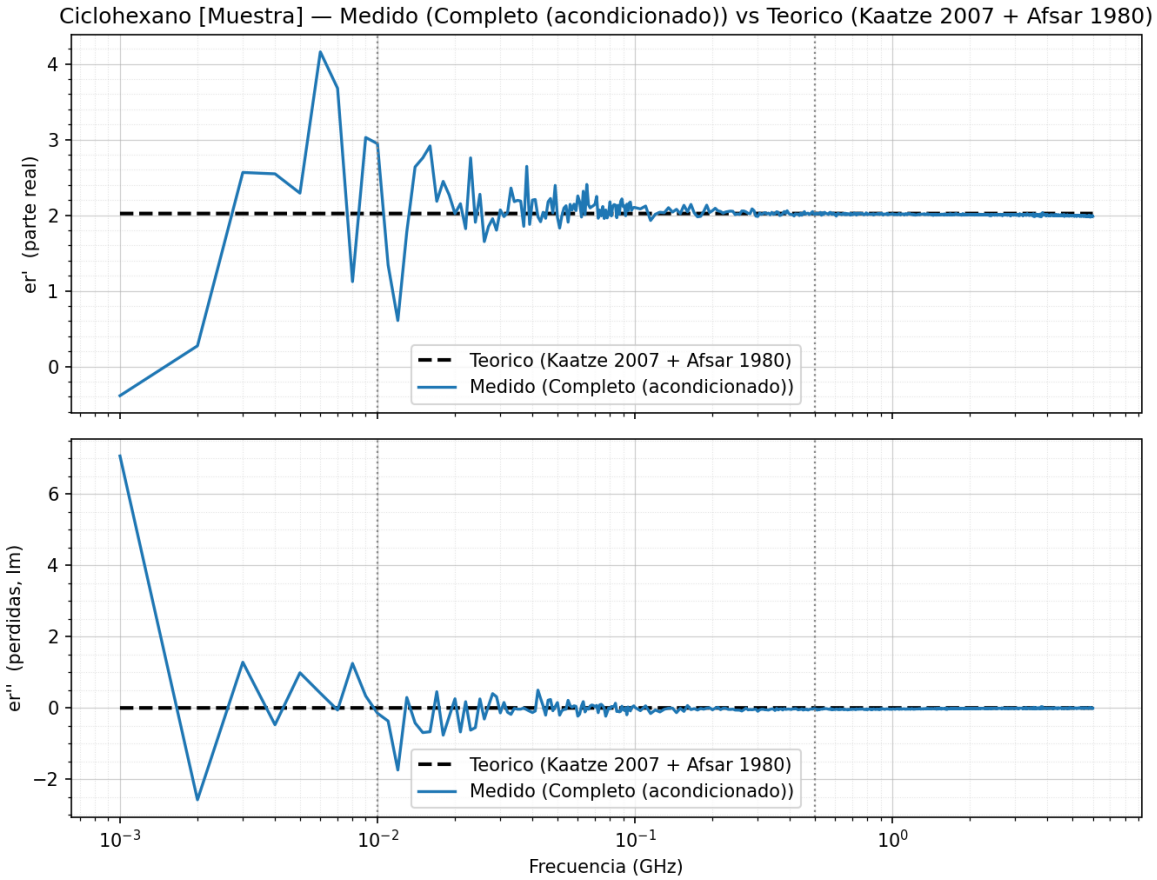

Desglose de error absoluto por intervalo — Ciclohexano

Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
0.00 - 0.01 GHz	1.2111	2.4074	n/a	n/a
0.01 - 0.50 GHz	0.1109	1.4139	n/a	n/a
0.50 - 6.00 GHz	0.0196	0.0475	n/a	n/a

Medición de líquido: Acetona [Muestra]

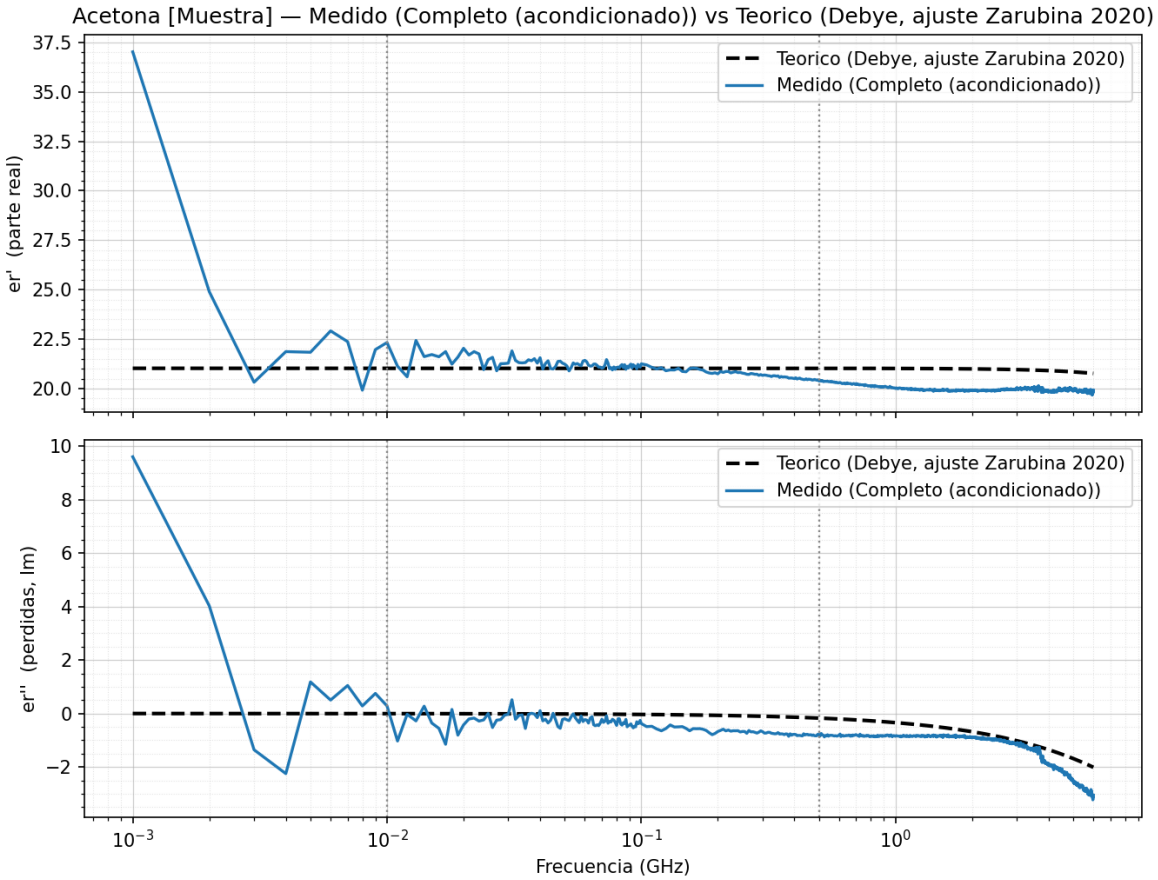

Desglose de error absoluto por intervalo — Acetona

Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
0.00 - 0.01 GHz	2.8819	15.9972	2.1297	9.6012
0.01 - 0.50 GHz	0.3037	1.4068	0.4335	1.1441
0.50 - 6.00 GHz	0.9815	1.1492	0.4779	1.2263