

Informe Comparativo de Calibraciones y Mediciones

Combinación A: **combo_A** vs. Combinación B: **combo_B**

Parámetro	Combinación A combo_A	Combinación B combo_B
Fecha de generación	14/10/2026 11:12	14/10/2026 11:12
Combinación	combo_A	combo_B
Puesto en ranking global	#1 de 2	#2 de 2
Método de cálculo	Completo (original)	Completo (acondicionado)
Patrón Corto / Abierto	Short: corto.s1p | Open: aire.s1p	Short: corto.s1p | Open: aire.s1p
Patrones líquidos	Agua + Alcohol isopropilico	Alcohol isopropilico + Agua
Banda analizada	1.0 - 5.0 GHz	1.0 - 5.0 GHz
Score Promedio Global	0.0830	0.0300
Score Patrones (ajuste)	0.0400	0.0200
Score Muestras (validación)	0.0830	0.0300
Acondicionamiento Gn	Original (sin acond.)	Original (sin acond.)

Diagnóstico de Conductancia Normalizada Gn(f)

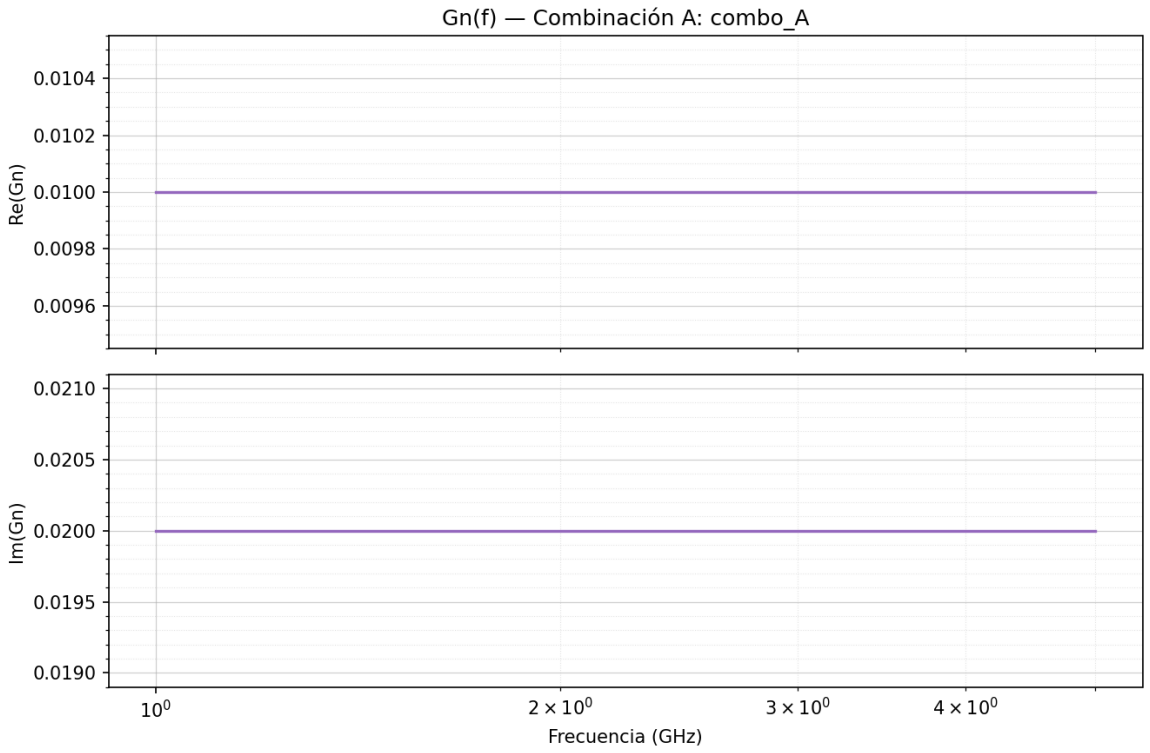


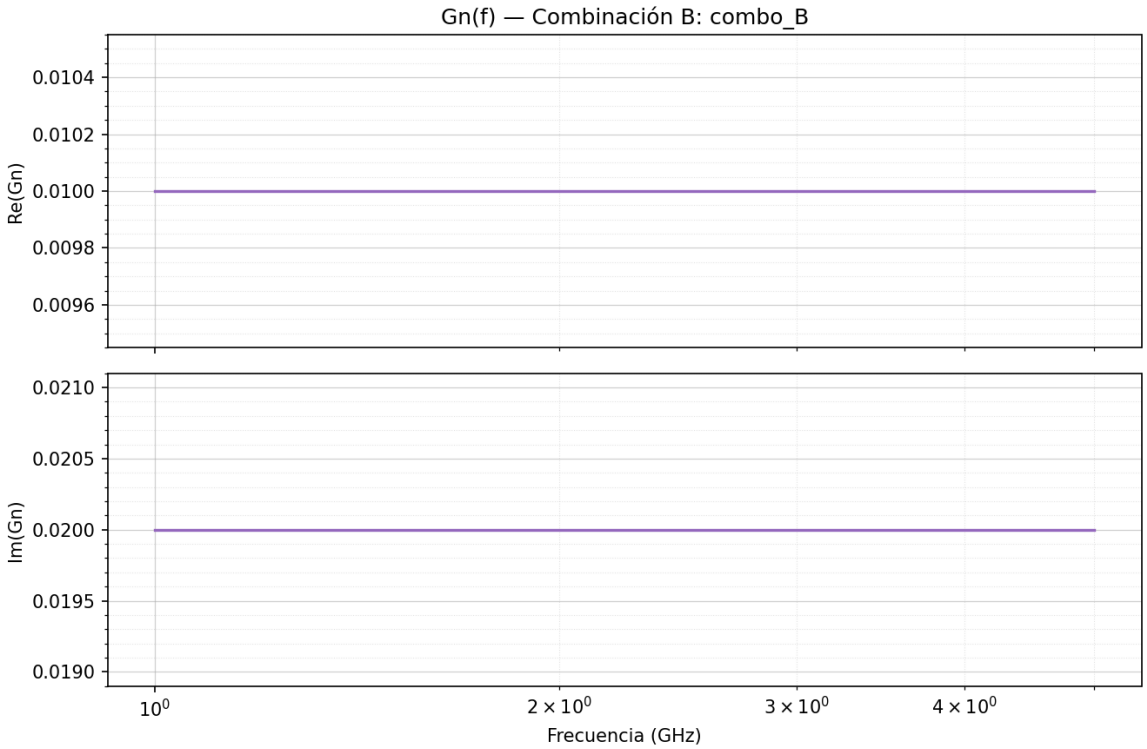

Resumen Comparativo de Líquidos Evaluados

Líquido / Muestra	Rol Combo A	Score Global Combo A	Rol Combo B	Score Global Combo B	Comparativa (Mejor score)
Ciclohexano	Muestra	0.0830	Muestra	**0.0300**	**Combo B** (+0.0530)

Comparativa para líquido: Ciclohexano

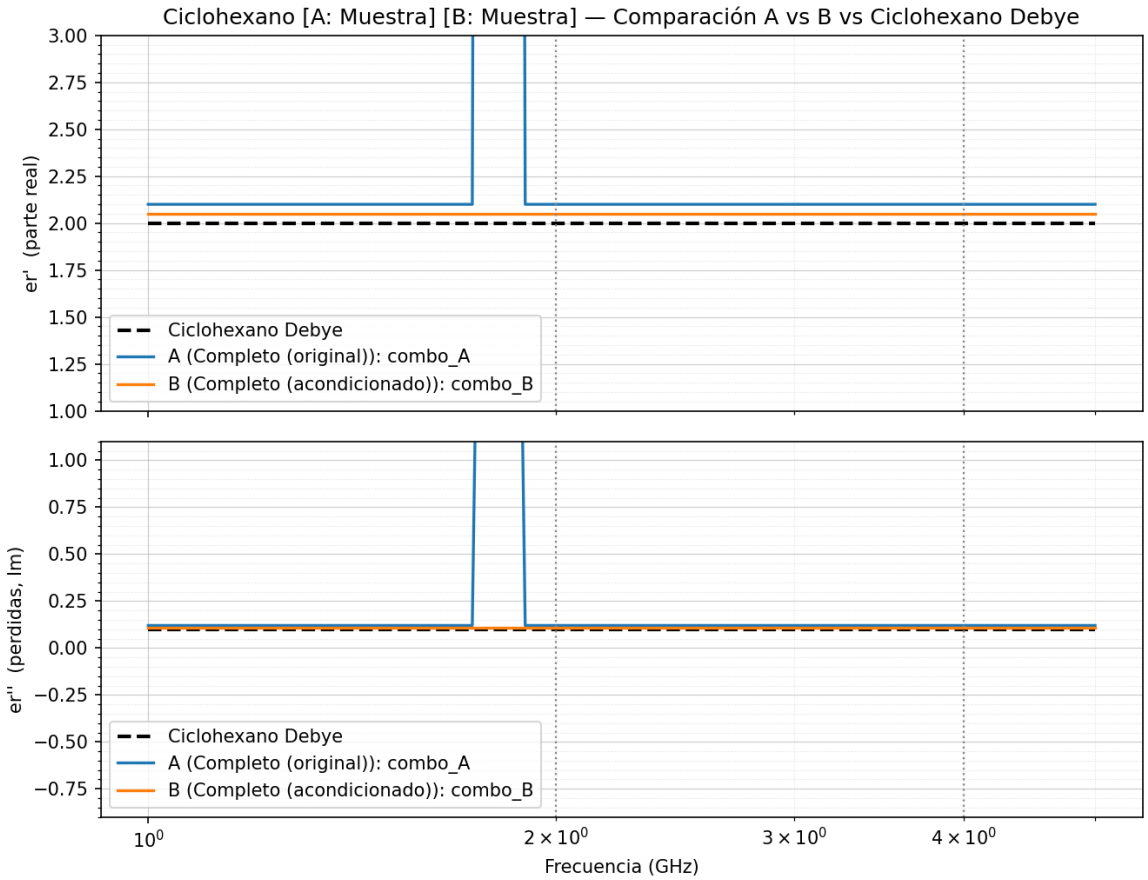

Desglose comparativo de error absoluto por intervalo — Ciclohexano

Calibración	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
Combo A combo_A	1.00 - 2.00 GHz	0.0500	0.1000	0.0200	0.0500
Combo A combo_A	2.00 - 4.00 GHz	0.0800	0.1500	0.0300	0.0600
Combo A combo_A	4.00 - 5.00 GHz	0.1200	0.2000	0.0400	0.0800
Combo B combo_B	1.00 - 2.00 GHz	0.0200	0.0400	0.0100	0.0200
Combo B combo_B	2.00 - 4.00 GHz	0.0300	0.0500	0.0100	0.0300
Combo B combo_B	4.00 - 5.00 GHz	0.0400	0.0700	0.0200	0.0400