
Informe de Calibración y Mediciones por Combinación

Calibración evaluada: combo_A

Fecha de generación	14/10/2026 11:12
Combinación evaluada	combo_A
Puesto en ranking global	#1 de 2
Método de cálculo	Completo (original)
Patrón Cortocircuito / Abierto	Short: corto.s1p | Open: aire.s1p
Patrones líquidos	Agua + Alcohol isopropilico
Banda de frecuencias analizada	1.0 - 5.0 GHz
Intervalos de evaluación	Int 1: [1.00 - 2.00 GHz] | Int 2: [2.00 - 4.00 GHz] | Int 3: [4.00 - 5.00 GHz]
Score Promedio Global (todos)	0.0830
Score Promedio Patrones (ajuste in-sample)	0.0400
Score Promedio Muestras (validación)	0.0830


Diagnóstico de Conductancia Normalizada Gn(f)

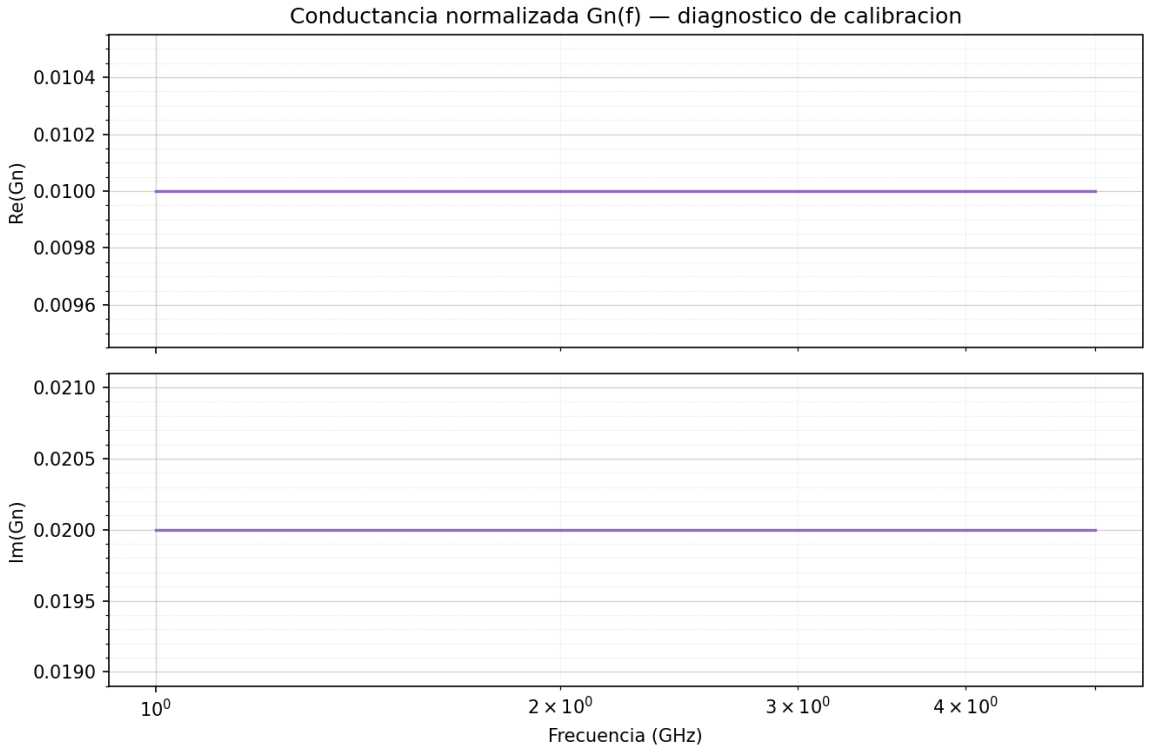

Resumen de Líquidos Evaluados con esta Calibración

Líquido / Muestra	Rol	Score Int 1 (1.00 - 2.00 GHz)	Score Int 2 (2.00 - 4.00 GHz)	Score Int 3 (4.00 - 5.00 GHz)	Score Global
Ciclohexano	Muestra	0.0500	0.0800	0.1200	**0.0830**

Medición de líquido: Ciclohexano [Muestra]

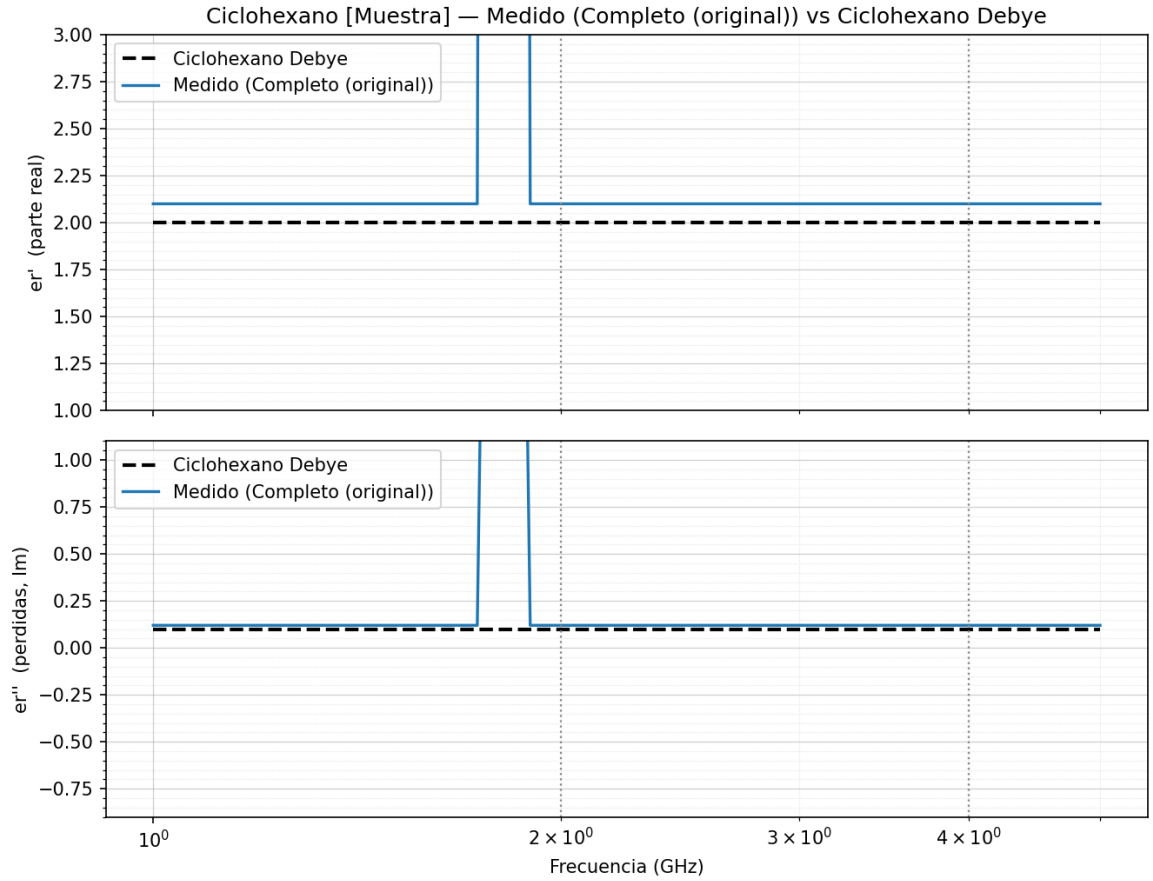

Desglose de error absoluto por intervalo — Ciclohexano

Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
1.00 - 2.00 GHz	0.0500	0.1000	0.0200	0.0500
2.00 - 4.00 GHz	0.0800	0.1500	0.0300	0.0600
4.00 - 5.00 GHz	0.1200	0.2000	0.0400	0.0800