
Informe de Calibración y Mediciones por Combinación

Calibración evaluada: P3: Agua | P4: Ciclohexano [Completo (acondicionado)]

Fecha de generación	13/10/2026 15:11
Combinación evaluada	P3: Agua | P4: Ciclohexano [Completo (acondicionado)]
Puesto en ranking global	#37 de 144
Método de cálculo	Completo (acondicionado)
Patrón Cortocircuito / Abierto	Short: short_sonda_3mm_9oct.s1p | Open: open_sonda_3mm_9oct.s1p
Patrones líquidos	Agua + Ciclohexano
Banda de frecuencias analizada	0.001 - 6.0 GHz
Intervalos de evaluación	Int 1: [0.00 - 0.01 GHz] | Int 2: [0.01 - 0.50 GHz] | Int 3: [0.50 - 6.00 GHz]
Score Promedio Global (todos)	0.5722
Score Promedio Patrones (ajuste in-sample)	n/a
Score Promedio Muestras (validación)	0.5722
Acondicionamiento de Gn	transicion_polinomica_cero (automatico)


Diagnóstico de Conductancia Normalizada Gn(f)

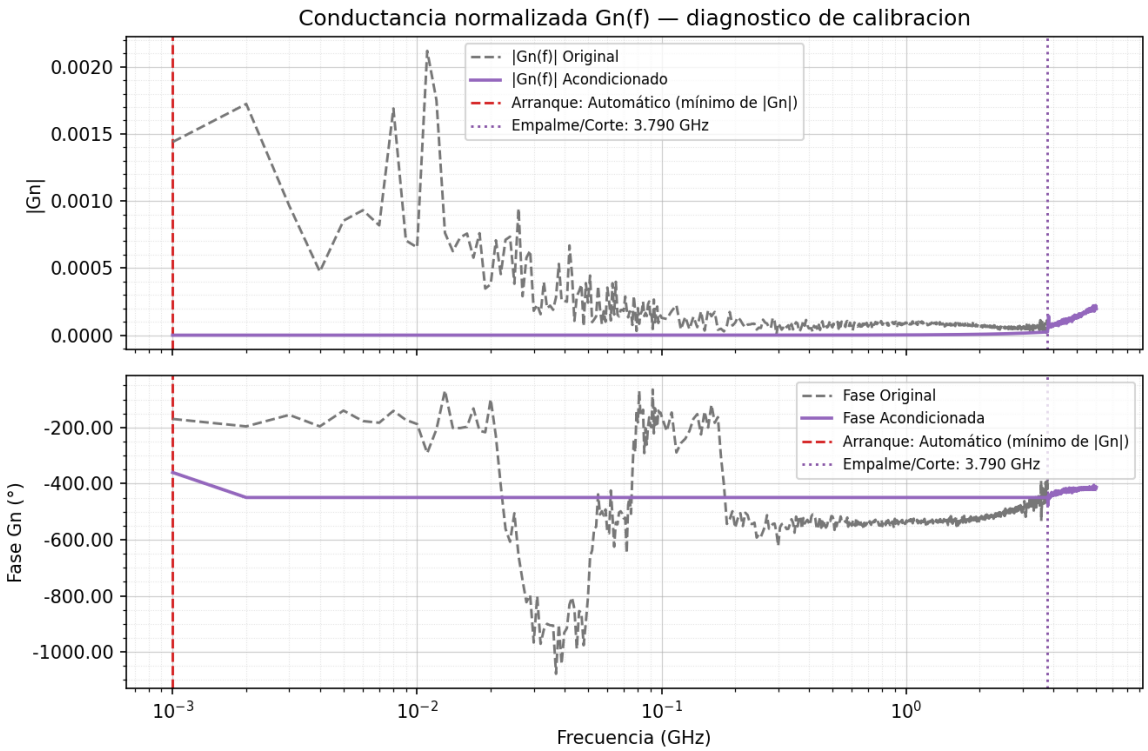

Resumen de Líquidos Evaluados con esta Calibración

Líquido / Muestra	Rol	Score Int 1 (0.00 - 0.01 GHz)	Score Int 2 (0.01 - 0.50 GHz)	Score Int 3 (0.50 - 6.00 GHz)	Score Global
Alcohol etilico	Muestra	1.2238	0.2340	0.1659	**0.5412**
Alcohol isopropilico	Muestra	1.2979	0.3260	0.1433	**0.5891**
Butanol	Muestra	1.2834	0.3143	0.1068	**0.5682**
Acetona	Muestra	1.2956	0.2244	0.2511	**0.5904**


Medición de líquido: Alcohol etilico [Muestra]

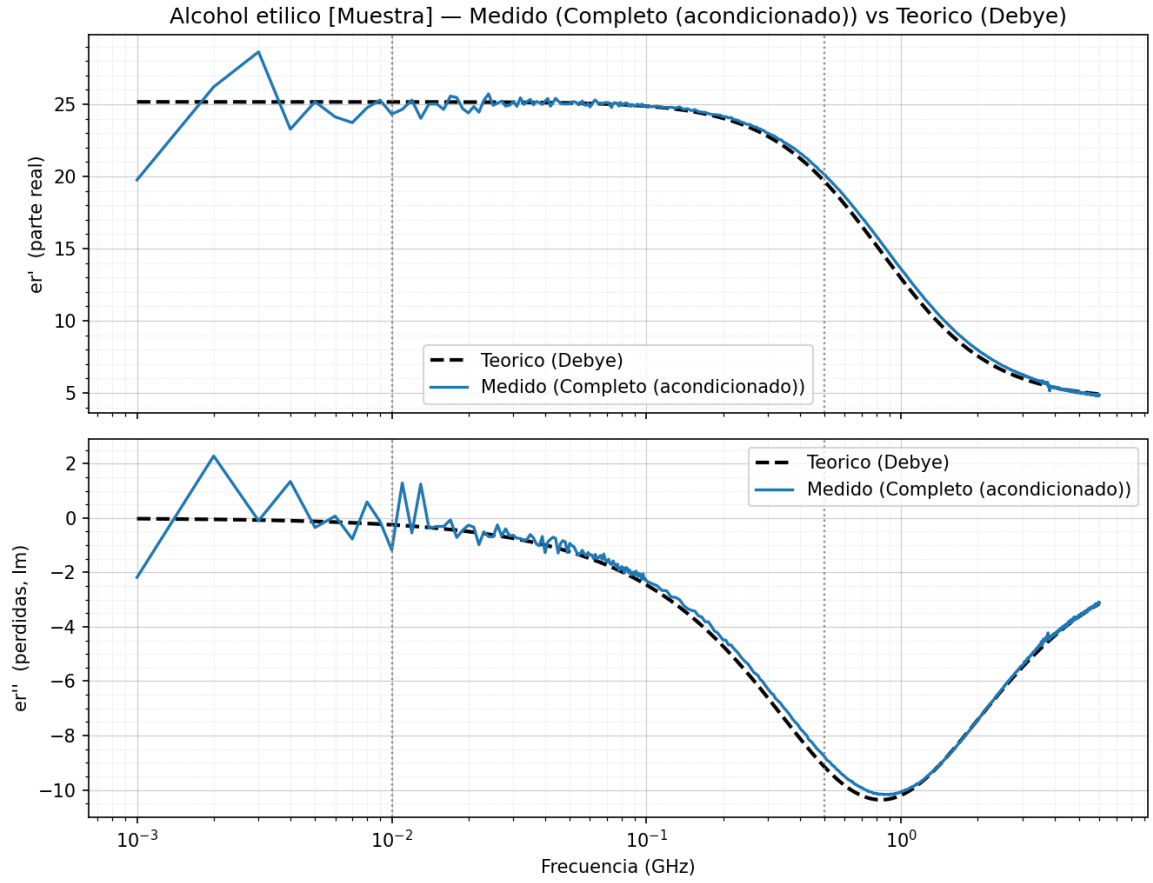

Desglose de error absoluto por intervalo — Alcohol etilico

Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
0.00 - 0.01 GHz	1.5666	5.4034	0.8810	2.3302
0.01 - 0.50 GHz	0.2017	1.1357	0.2662	1.5717
0.50 - 6.00 GHz	0.2617	0.6685	0.0701	0.3790


Medición de líquido: Alcohol isopropilico [Muestra]

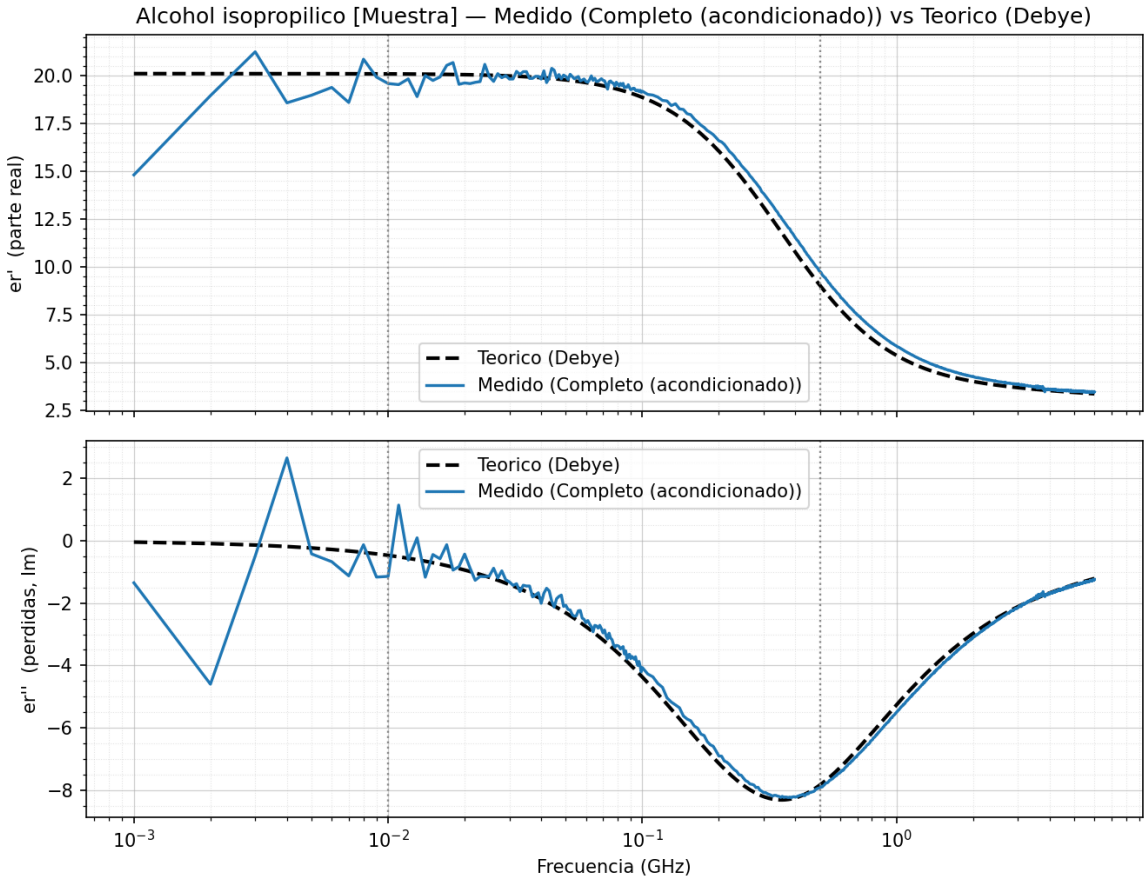

Desglose de error absoluto por intervalo — Alcohol isopropilico

Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
0.00 - 0.01 GHz	1.3914	5.3005	1.2043	4.5049
0.01 - 0.50 GHz	0.4416	1.1793	0.2105	1.6578
0.50 - 6.00 GHz	0.2036	0.7491	0.0830	0.2580


Medición de líquido: Butanol [Muestra]

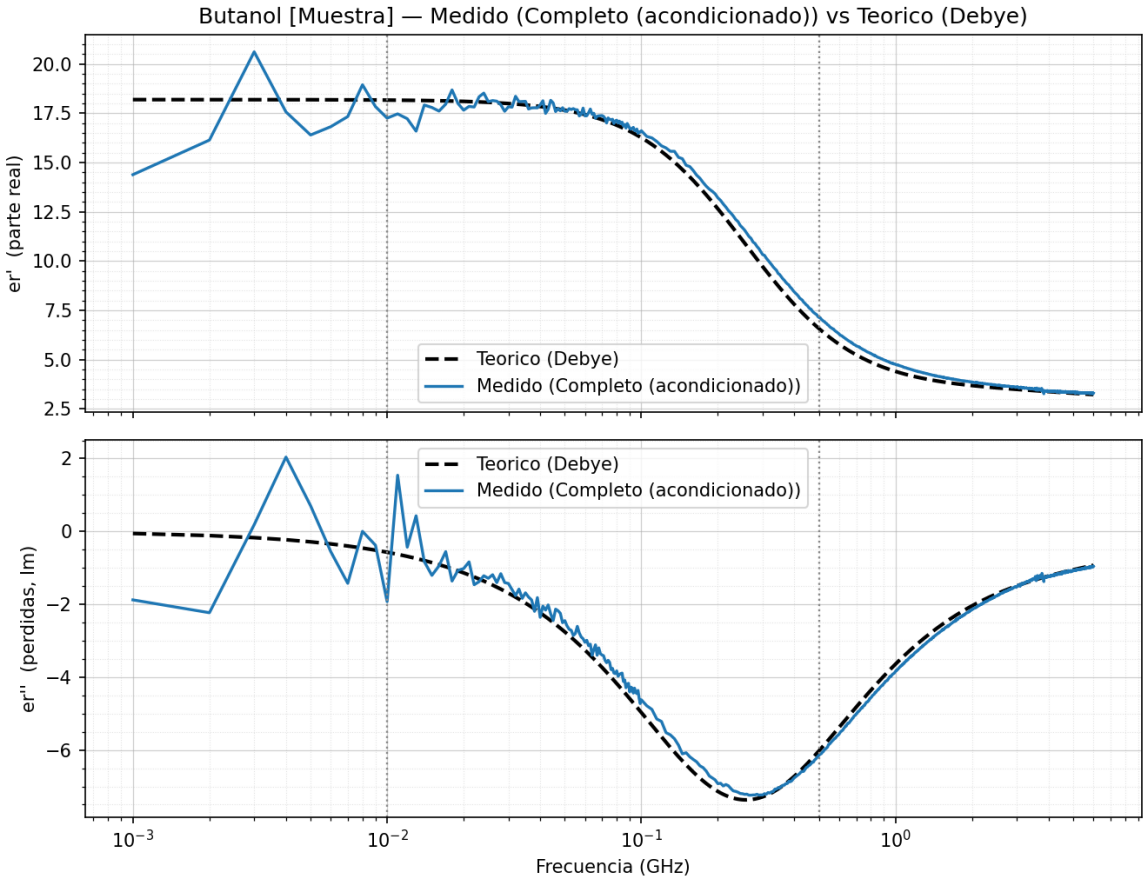

Desglose de error absoluto por intervalo — Butanol

Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
0.00 - 0.01 GHz	1.4931	3.8073	1.0738	2.2692
0.01 - 0.50 GHz	0.3929	1.5625	0.2358	2.1705
0.50 - 6.00 GHz	0.1439	0.6078	0.0697	0.2217

Medición de líquido: Acetona [Muestra]

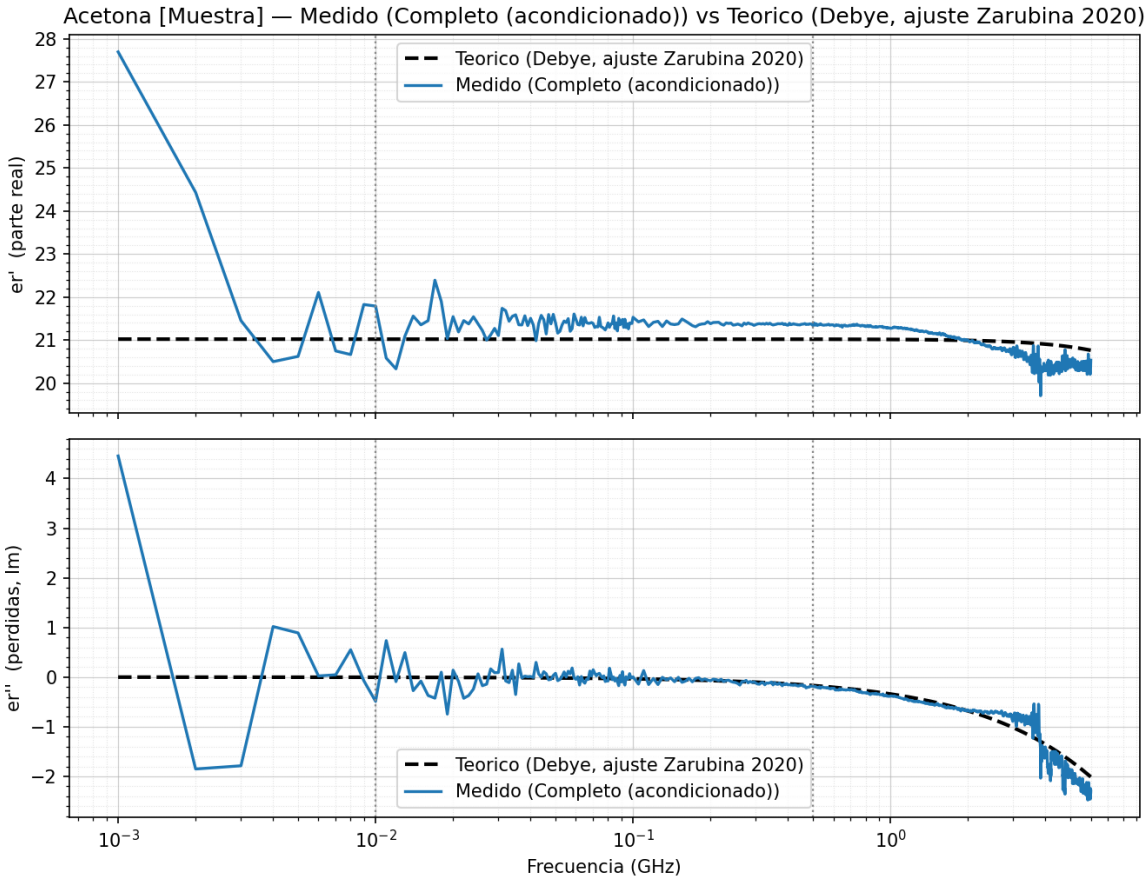

Desglose de error absoluto por intervalo — Acetona

Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
0.00 - 0.01 GHz	1.4729	6.6749	1.1183	4.4552
0.01 - 0.50 GHz	0.3686	1.3692	0.0803	0.7395
0.50 - 6.00 GHz	0.3115	1.2080	0.1907	0.7501