Informe de Selección Óptima de Patrones (Combinatoria)

Top 3 mejores combinaciones por líquido — Ordenado por: Promedio Global (los 3 intervalos)


Fecha de generación	14/10/2026 11:12
Criterio de selección (Top 3)	Promedio Global (los 3 intervalos)
Banda de frecuencias analizada	1.0 - 5.0 GHz
Intervalos de evaluación	Int 1: [1.00 - 2.00 GHz] | Int 2: [2.00 - 4.00 GHz] | Int 3: [4.00 - 5.00 GHz]
Métodos evaluados	—
Arranque de marcha Gn	Mínimo de |Gn| en el barrido (automático)
Filtrado de redundancias	Sí (se omiten permutaciones recíprocas con idéntico resultado; marcadas con *)
Evaluación en reporte	Sólo muestras independientes (excluye combinaciones donde el líquido actuó como patrón)
Patrón Cortocircuito / Abierto	Short: corto.s1p | Open: aire.s1p

Líquidos candidatos evaluados

Líquido candidato	Archivo .s1p	Modelo teórico	Temp. (°C)
Agua	agua.s1p	Agua (Liebe-Hufford-Manabe)	25.0
Alcohol isopropilico	isopropilico.s1p	Alcohol isopropilico (2-propanol)	25.0
Ciclohexano	ciclohexano.s1p	Ciclohexano (Kaatze 2007 + Afsar 1980)	25.0

El puntaje (Score) en cada intervalo se define como el promedio entre el error absoluto medio de la parte real (er') y el error absoluto medio de las pérdidas (er''): Score = (e_abs(er') + e_abs(er'')) / 2.

Muestra evaluada: Ciclohexano

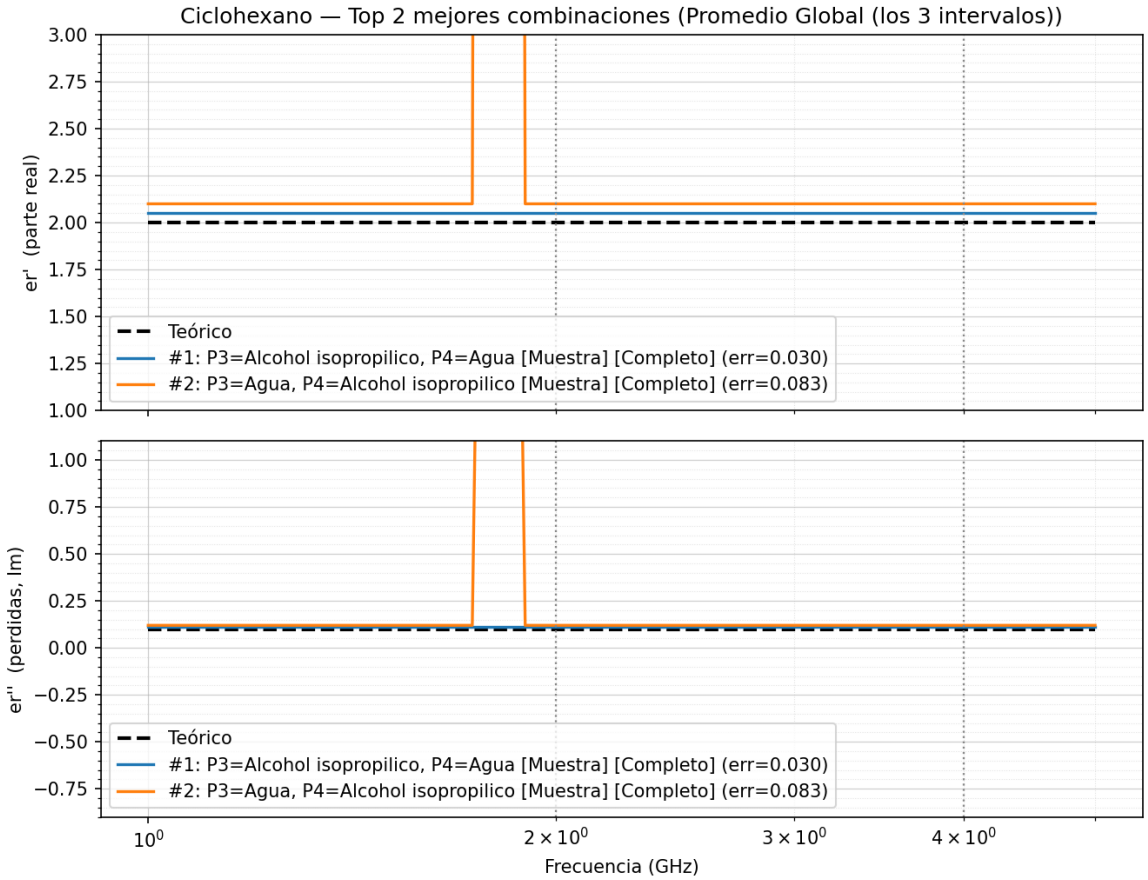

Resumen de puntajes — Top 2 combinaciones para Ciclohexano (ordenado por: Promedio Global (los 3 intervalos))

Puesto	Rol	Patrón 3 (P3)	Patrón 4 / Adic.	Método	Score Int 1 (1.00 - 2.00 GHz)	Score Int 2 (2.00 - 4.00 GHz)	Score Int 3 (4.00 - 5.00 GHz)	Score Global
#1	Muestra	Alcohol isopropilico	Agua	Completo	0.0200	0.0300	0.0400	**0.0300**
#2	Muestra	Agua	Alcohol isopropilico	Completo	0.0500	0.0800	0.1200	**0.0830**

Desglose de error absoluto por intervalo — Top 2 (Ciclohexano)

Combinación (Top 3)	Intervalo	Error medio er'	Error máx er'	Error medio er''	Error máx er''
#1 [Muestra] — P3: Alcohol isopropilico | P4: Agua *(Completo)*	1.00 - 2.00 GHz	0.0200	0.0400	0.0100	0.0200
	2.00 - 4.00 GHz	0.0300	0.0500	0.0100	0.0300
	4.00 - 5.00 GHz	0.0400	0.0700	0.0200	0.0400
#2 [Muestra] — P3: Agua | P4: Alcohol isopropilico *(Completo)*	1.00 - 2.00 GHz	0.0500	0.1000	0.0200	0.0500
	2.00 - 4.00 GHz	0.0800	0.1500	0.0300	0.0600
	4.00 - 5.00 GHz	0.1200	0.2000	0.0400	0.0800