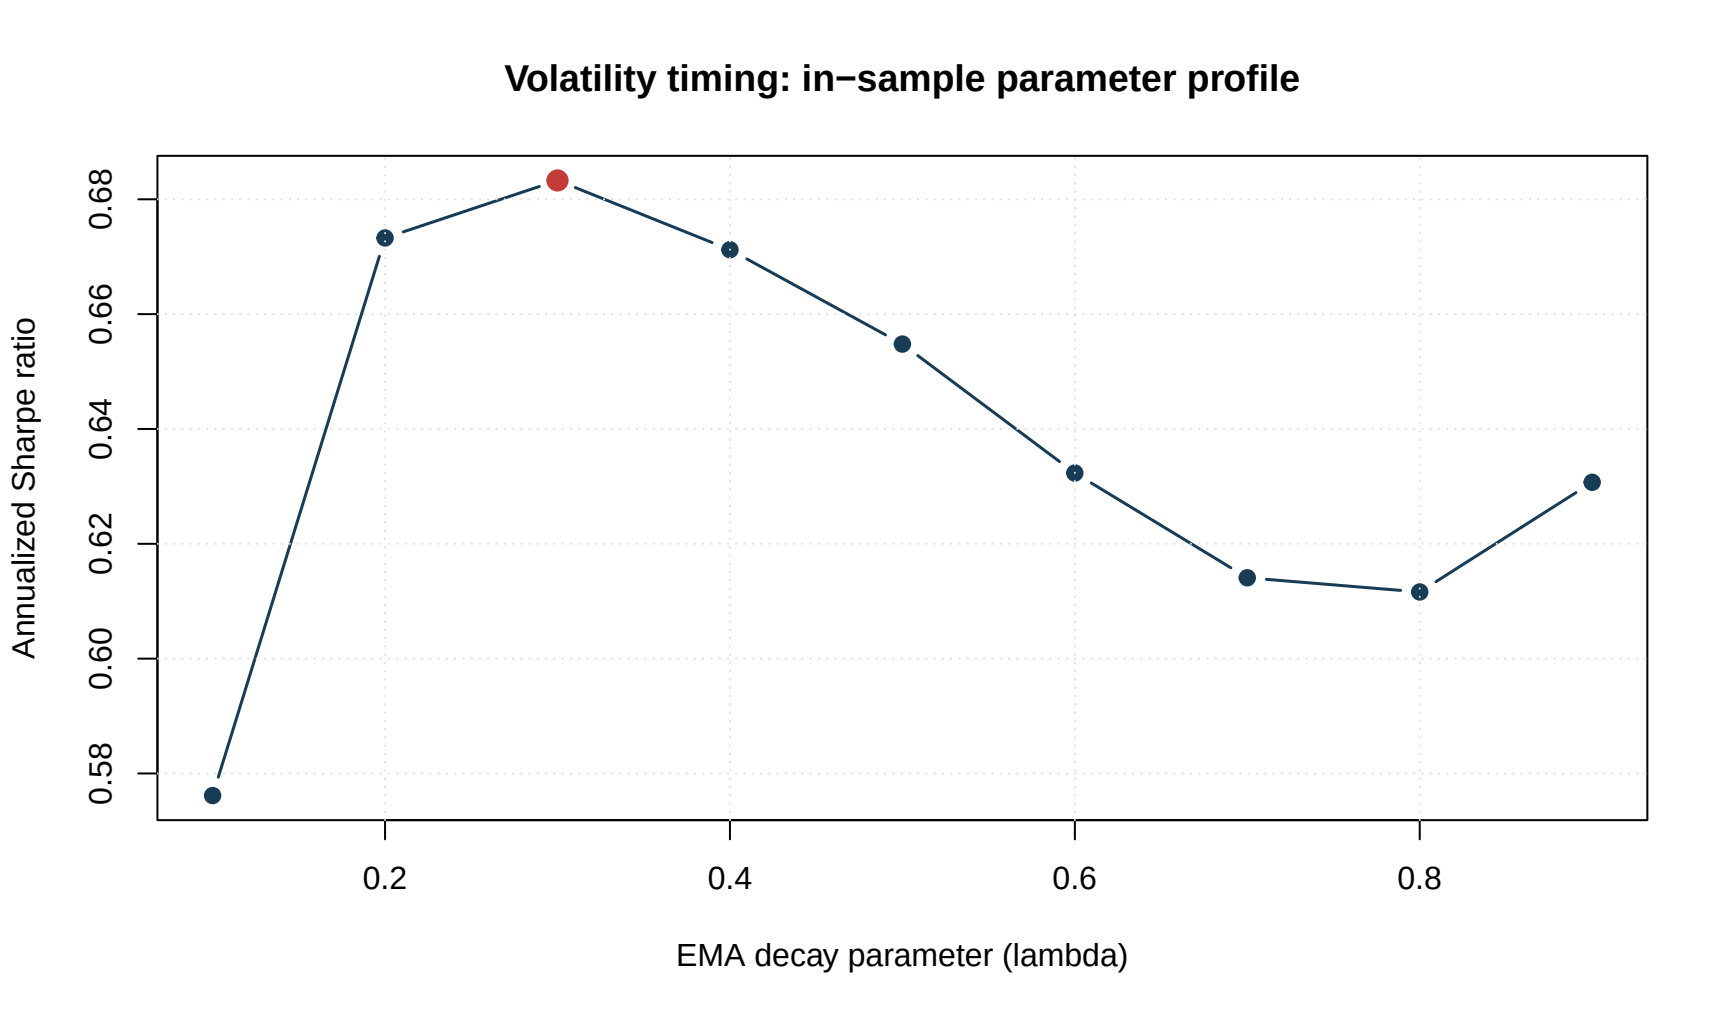
Volatility timing: in−sample parameter profile
Annualized Sharpe ratio
0.58
0.60
0.62
0.64
0.66
0.68
0.2
0.4
0.6
0.8
EMA decay parameter (lambda)