



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy Chứng Nhận Số / Certificate Number
TSG-644652



Tên Khách Hàng <i>Customer:</i>	MOONPO DEVELOPMENT (VIETNAM) LIMITED Lô CN-01, KCN Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.		
Nhà sản xuất: <i>Manufacturer:</i>	MITUTOYO	Hiệu chuẩn bởi: <i>Calibrated By:</i>	NGOC LY
Tên thiết bị: <i>Description:</i>	Feeler Gauge	Ngày hiệu chuẩn: <i>Calibration Date:</i>	03/APR/2026
Kiểu: <i>Model Number:</i>	184-303S	Ngày hiệu chuẩn sắp tới (đề nghị): <i>Recommended Due:</i>	03/APR/2027
Phạm vi đo: <i>Size / Range:</i>	All checked	Nơi hiệu chuẩn:	Tại cơ sở của Khách Hàng
Số hiệu: <i>Serial #:</i>	N/A	Điều kiện khi nhận: <i>Condition Received:</i>	Trong sai số cho phép IN TOLERANCE
Số quản lý: <i>Asset Number:</i>	50009	Điều kiện khi trả: <i>Condition Returned:</i>	Trong sai số cho phép IN TOLERANCE

Chứng nhận này xác nhận rằng thiết bị trên đã được hiệu chuẩn tuân theo các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017, phù hợp với các quy trình tham chiếu. Các thiết bị chuẩn được sử dụng để thực hiện hiệu chuẩn có thể được truy nguyên tới hệ đơn vị SI, nguồn gốc của sự truy xuất này đến từ một Viện Đo Lường Quốc Gia như NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... từ các hằng số vật lý tự nhiên, các thủ tục tiêu chuẩn đồng thuận, hoặc được bắt nguồn bởi tỉ lệ hiệu chuẩn. Báo cáo ước lượng độ không đảm bảo đo được xác định theo yêu cầu với sự phân bố tương ứng với xác suất xấp xỉ 95% (k=2). Trừ khi có những ghi chú khác thì việc hiệu chuẩn này được thực hiện theo sai số cho phép của nhà sản xuất. Tuyên bố về sự phù hợp tuân theo quy tắc quyết định chấp nhận đơn giản ILAC-G8:2019. Mẫu chứng nhận này sẽ "không được sao chép" nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Techmaster Electronics. Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp. Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (Theo yêu cầu của CV2222 TĐC-ĐL).

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the Calibration System Requirements of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with referenced procedures. Standards used to perform this calibration are traceable to SI units; their source of traceability derives from a National Metrology Institute such as NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... from natural physical constants, consensus standards or derived by the ratio type of calibrations. Collective uncertainties are determined as required with a distribution that corresponds to a probability of approximately 95% (k=2). Unless otherwise noted calibrations are performed to manufacturer's specifications. Compliance statements are in conformance with ILAC-G8:2019 simple acceptance decision rule. This form shall not be reproduced, except in full, without the expressed written consent of Techmaster Electronics. This measuring instrument shall not be used for trade, payment, safety, health, environmental, inspection, or judicial purposes. Not to be used for verification of Group 2 measuring instruments (per Official Letter No. 2222/TĐC-ĐL).

Số P.O: <i>P.O. Number:</i>	BG26/001984	Quy trình hiệu chuẩn: <i>Procedure:</i>	TEV-DI013-21
Ngày ban hành: <i>Issue date:</i>	2026-04-15 02:22:08.9430000 -07:00	Điều kiện môi trường: <i>Environment:</i>	24 °C / 51 %RH

Sai số hiệu chuẩn áp dụng: Dựa trên thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/của Khách hàng đưa ra hoặc theo chính sách quyết định của Techmaster Electronics J.S.C

Calibration Accuracy: Base on Manufacturer's Specifications/Customer's Specifications or Decision Rules for compliance statements (LAB-01) of Techmaster Policy.

Điều kiện khi trả (*): Các tuyên bố về sự phù hợp (ví dụ: Đạt / Không đạt) đối với các thông số kỹ thuật được đưa ra trong báo cáo này không tính đến độ không đảm bảo đo ngoại trừ khi khách hàng yêu cầu. Người sử dụng thiết bị có trách nhiệm xem xét đánh giá này có phù hợp với việc sử dụng thiết bị cụ thể của mình hay không.

Ghi chú (Remark) :

Các thiết bị chuẩn được sử dụng (Standards Used)

Mã số thiết bị <i>Asset Number</i>	Nhà Sản Xuất <i>Manufacturer</i>	Kiểu <i>Model</i>	Hạn hiệu chuẩn <i>Due Date</i>	Giấy C.N. Số <i>Report Number</i>	Liên kết chuẩn <i>Traceability</i>
ME0146	MITUTOYO	293-100	MAY/24/2026	TSG-0-528345	Techmaster VN

Đảm bảo chất lượng:
Quality Assurance:



Nguyễn Văn Tiến

Giám sát kỹ thuật:
Technical Manager:



Lê Nguyễn Vũ Nghiệp

540.1/Certificates.VE.Rev 11


Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-644652

Nhà sản xuất / Manufacturer:
MITUTOYO

Kiểu / Model:
184-303S

Số quản lý (Asset No.) / Số seri (SN.):
50009


Giá trị danh định, mm UUT nominal value	Giá trị chuẩn, mm Standard value				Sai lệch, mm Error	Dung sai cho phép, mm Tolerance limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng, mm Expanded uncertainty
	d1	d2	d3	Trung Bình Average		Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
0.05	0.0499	0.0496	0.0497	0.0497	-0.0003	0.0470	0.0530	Đạt/Pass	0.0004
0.06	0.0604	0.0603	0.0604	0.0604	0.0004	0.0560	0.0640	Đạt/Pass	0.0004
0.07	0.0696	0.0698	0.0694	0.0696	-0.0004	0.0660	0.0740	Đạt/Pass	0.0005
0.08	0.0792	0.0791	0.0792	0.0792	-0.0008	0.0760	0.0840	Đạt/Pass	0.0004
0.09	0.0909	0.0910	0.0910	0.0910	0.0010	0.0860	0.0940	Đạt/Pass	0.0004
0.10	0.0992	0.0992	0.0989	0.0991	-0.0009	0.0950	0.1050	Đạt/Pass	0.0004
0.11	0.1111	0.1108	0.1111	0.1110	0.0010	0.1050	0.1150	Đạt/Pass	0.0004
0.12	0.1212	0.1210	0.1211	0.1211	0.0011	0.1150	0.1250	Đạt/Pass	0.0004
0.13	0.1292	0.1295	0.1289	0.1292	-0.0008	0.1250	0.1350	Đạt/Pass	0.0005
0.14	0.1396	0.1395	0.1393	0.1395	-0.0005	0.1350	0.1450	Đạt/Pass	0.0004
0.15	0.1493	0.1492	0.1490	0.1492	-0.0008	0.1450	0.1550	Đạt/Pass	0.0004
0.20	0.2014	0.2016	0.2012	0.2014	0.0014	0.1950	0.2050	Đạt/Pass	0.0005
0.25	0.2486	0.2485	0.2486	0.2486	-0.0014	0.2450	0.2550	Đạt/Pass	0.0004
0.30	0.3004	0.3007	0.3005	0.3005	0.0005	0.2950	0.3050	Đạt/Pass	0.0004
0.35	0.3498	0.3500	0.3499	0.3499	-0.0001	0.3420	0.3580	Đạt/Pass	0.0004
0.40	0.4013	0.4013	0.4013	0.4013	0.0013	0.3920	0.4080	Đạt/Pass	0.0004
0.45	0.4502	0.4505	0.4505	0.4504	0.0004	0.4420	0.4580	Đạt/Pass	0.0004
0.50	0.4983	0.4980	0.4986	0.4983	-0.0017	0.4920	0.5080	Đạt/Pass	0.0005
0.55	0.5514	0.5514	0.5512	0.5513	0.0013	0.5420	0.5580	Đạt/Pass	0.0004
0.60	0.5994	0.5993	0.5992	0.5993	-0.0007	0.5920	0.6080	Đạt/Pass	0.0004
0.65	0.6506	0.6504	0.6506	0.6505	0.0005	0.6400	0.6600	Đạt/Pass	0.0004
0.70	0.6975	0.6975	0.6974	0.6975	-0.0025	0.6900	0.7100	Đạt/Pass	0.0004
0.75	0.7479	0.7482	0.7478	0.7480	-0.0020	0.7400	0.7600	Đạt/Pass	0.0005
0.80	0.8013	0.8013	0.8015	0.8014	0.0014	0.7900	0.8100	Đạt/Pass	0.0004
0.85	0.8519	0.8517	0.8518	0.8518	0.0018	0.8400	0.8600	Đạt/Pass	0.0004
0.90	0.9004	0.9001	0.9001	0.9002	0.0002	0.8900	0.9100	Đạt/Pass	0.0004
0.95	0.9491	0.9489	0.9492	0.9491	-0.0009	0.9400	0.9600	Đạt/Pass	0.0004
1.00	1.0027	1.0027	1.0024	1.0026	0.0026	0.9900	1.0100	Đạt/Pass	0.0004

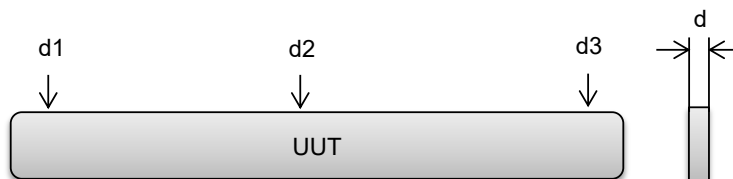

Minh họa vị trí đo/ Illustration of measuring position

• Ghi chú (Notes):

- _ UUT: Phương tiện-thiết bị-dụng cụ được hiệu chuẩn/ Unit Under Test.
- _ Dung sai cho phép theo bảng trên được tính toán theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
The tolerances limit on table above are based on manufacturer's specification.



Thực hiện bởi:
Performed by

Ly Ngoc
540.3_15/09/23