



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy Chứng Nhận Số / Certificate Number
TSG-0-672228



Tên Khách Hàng <i>Customer:</i>	MOONPO DEVELOPMENT (VIETNAM) LIMITED Lô CN-01, KCN Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.	Hiệu chuẩn bởi: <i>Calibrated By:</i>	Bach Le Quy
Nhà sản xuất: <i>Manufacturer:</i>	TOPTUL	Ngày hiệu chuẩn: <i>Calibration Date:</i>	22/JUL/2026
Tên thiết bị: <i>Description:</i>	Feeler Gauge	Ngày hiệu chuẩn sắp tới (đề nghị): <i>Recommended Due:</i>	22/JUL/2027
Kiểu: <i>Model Number:</i>	ICAA0020	Nơi hiệu chuẩn:	Tại phòng thử nghiệm của Techmaster
Phạm vi đo: <i>Size / Range:</i>	All checked	Điều kiện khi nhận: <i>Condition Received:</i>	In-Laboratory Trong sai số cho phép IN TOLERANCE
Số hiệu: <i>Serial #:</i>	N/A	Điều kiện khi trả: <i>Condition Returned:</i>	Trong sai số cho phép IN TOLERANCE
Số quản lý: <i>Asset Number:</i>	03254		

Chứng nhận này xác nhận rằng thiết bị trên đã được hiệu chuẩn tuân theo các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017, phù hợp với các quy trình tham chiếu. Các thiết bị chuẩn được sử dụng để thực hiện hiệu chuẩn có thể được truy nguyên tới hệ đơn vị SI, nguồn gốc của sự truy xuất này đến từ một Viện Đo Lường Quốc Gia như NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... từ các hằng số vật lý tự nhiên, các thủ tục tiêu chuẩn đồng thuận, hoặc được bắt nguồn bởi tỉ lệ hiệu chuẩn. Báo cáo ước lượng độ không đảm bảo đo được xác định theo yêu cầu với sự phân bố tương ứng với xác suất xấp xỉ 95% (k=2). Trừ khi có những ghi chú khác thì việc hiệu chuẩn này được thực hiện theo sai số cho phép của nhà sản xuất. Tuyên bố về sự phù hợp tuân theo quy tắc quyết định chấp nhận đơn giản ILAC-G8:2019. Mẫu chứng nhận này sẽ "không được sao chép" nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Techmaster Electronics. Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp. Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (Theo yêu cầu của CV2222 TĐC-ĐL).

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the Calibration System Requirements of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with referenced procedures. Standards used to perform this calibration are traceable to SI units; their source of traceability derives from a National Metrology Institute such as NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... from natural physical constants, consensus standards or derived by the ratio type of calibrations. Collective uncertainties are determined as required with a distribution that corresponds to a probability of approximately 95% (k=2). Unless otherwise noted calibrations are performed to manufacturer's specifications. Compliance statements are in conformance with ILAC-G8:2019 simple acceptance decision rule. This form shall not be reproduced, except in full, without the expressed written consent of Techmaster Electronics. This measuring instrument shall not be used for trade, payment, safety, health, environmental, inspection, or judicial purposes. Not to be used for verification of Group 2 measuring instruments (per Official Letter No. 2222/TĐC-ĐL).

Số P.O: <i>P.O. Number:</i>	BG26/005026	Quy trình hiệu chuẩn: <i>Procedure:</i>	TEV-DI013-21
Ngày ban hành: <i>Issue date:</i>	2026-07-30 19:03:02.9000000 -07:00	Điều kiện môi trường: <i>Environment:</i>	20 ± 2 °C / 50 ± 5 %RH

Sai số hiệu chuẩn áp dụng: Dựa trên thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/của Khách hàng đưa ra hoặc theo chính sách quyết định của Techmaster Electronics J.S.C

Calibration Accuracy: Base on Manufacturer's Specifications/Customer's Specifications or Decision Rules for compliance statements (LAB-01) of Techmaster Policy.

Điều kiện khi trả (*): Các tuyên bố về sự phù hợp (ví dụ: Đạt / Không đạt) đối với các thông số kỹ thuật được đưa ra trong báo cáo này không tính đến độ không đảm bảo đo ngoại trừ khi khách hàng yêu cầu. Người sử dụng thiết bị có trách nhiệm xem xét đánh giá này có phù hợp với việc sử dụng thiết bị cụ thể của mình hay không.

Ghi chú (Remark) :

Các thiết bị chuẩn được sử dụng (Standards Used)

Mã số thiết bị <i>Asset Number</i>	Nhà Sản Xuất <i>Manufacturer</i>	Kiểu <i>Model</i>	Hạn hiệu chuẩn <i>Due Date</i>	Giấy C.N. Số <i>Report Number</i>	Liên kết chuẩn <i>Traceability</i>
ME0146	MITUTOYO	293-100	APR/21/2027	TSG-0-646662	NMI

Đảm bảo chất lượng:
Quality Assurance:



Nguyễn Văn Tiến

Giám sát kỹ thuật:
Technical Manager:



Lê Nguyễn Vũ Nghiệp

540.1/Certificates.VE.Rev 11




Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-0-672228

Nhà sản xuất / Manufacturer:
TOPTUL

Kiểu / Model:
ICAA0020

Số quản lý (Asset No.) / Số seri (SN.):
03254

Giá trị danh định, mm UUT nominal value	Giá trị chuẩn, mm Standard value				Sai lệch, mm Error	Dung sai cho phép, mm Tolerance limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng, mm Expanded uncertainty
	d1	d2	d3	Trung Bình Average		Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
0.05	0.0511	0.0515	0.0514	0.0513	0.0013	0.0460	0.0540	Đạt/Pass	0.0005
0.10	0.1023	0.1011	0.1013	0.1016	0.0016	0.0960	0.1040	Đạt/Pass	0.0008
0.15	0.1506	0.1507	0.1510	0.1508	0.0008	0.1450	0.1550	Đạt/Pass	0.0005
0.20	0.2016	0.2027	0.2024	0.2022	0.0022	0.1940	0.2060	Đạt/Pass	0.0008
0.25	0.2541	0.2548	0.2549	0.2546	0.0046	0.2440	0.2560	Đạt/Pass	0.0006
0.30	0.3023	0.3029	0.3020	0.3024	0.0024	0.2930	0.3070	Đạt/Pass	0.0007
0.35	0.3518	0.3517	0.3506	0.3514	0.0014	0.3430	0.3570	Đạt/Pass	0.0009
0.40	0.4043	0.4049	0.4044	0.4045	0.0045	0.3920	0.4080	Đạt/Pass	0.0005
0.45	0.4578	0.4575	0.4568	0.4574	0.0074	0.4410	0.4590	Đạt/Pass	0.0007
0.50	0.5057	0.5063	0.5058	0.5059	0.0059	0.4910	0.5090	Đạt/Pass	0.0005
0.55	0.5565	0.5568	0.5576	0.5570	0.0070	0.5400	0.5600	Đạt/Pass	0.0008
0.60	0.6084	0.6087	0.6089	0.6087	0.0087	0.5890	0.6110	Đạt/Pass	0.0005
0.65	0.6569	0.6578	0.6590	0.6579	0.0079	0.6390	0.6610	Đạt/Pass	0.0013
0.70	0.7086	0.7089	0.7095	0.7090	0.0090	0.6880	0.7120	Đạt/Pass	0.0007
0.75	0.7592	0.7619	0.7611	0.7607	0.0107	0.7380	0.7620	Đạt/Pass	0.0017
0.80	0.8091	0.8072	0.8095	0.8086	0.0086	0.7870	0.8130	Đạt/Pass	0.0015
0.85	0.8593	0.8614	0.8602	0.8603	0.0103	0.8360	0.8640	Đạt/Pass	0.0013
0.90	0.9118	0.9122	0.9132	0.9124	0.0124	0.8860	0.9140	Đạt/Pass	0.0010
0.95	0.9619	0.9614	0.9615	0.9616	0.0116	0.9350	0.9650	Đạt/Pass	0.0005
1.00	1.0028	1.0030	1.0044	1.0034	0.0034	0.9840	1.0160	Đạt/Pass	0.0011

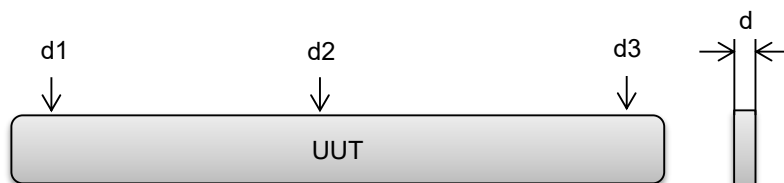


Minh họa vị trí đo / Illustration of measuring position

● Ghi chú (Notes):

- _ UUT: Phương tiện-thiết bị-dụng cụ được hiệu chuẩn/ Unit Under Test.
 - _ Dung sai cho phép theo bảng trên được áp dụng theo DIN 2275
- The tolerances limit on table above are based on DIN 2275

Thực hiện bởi:
Performed by



Le Quy Bach