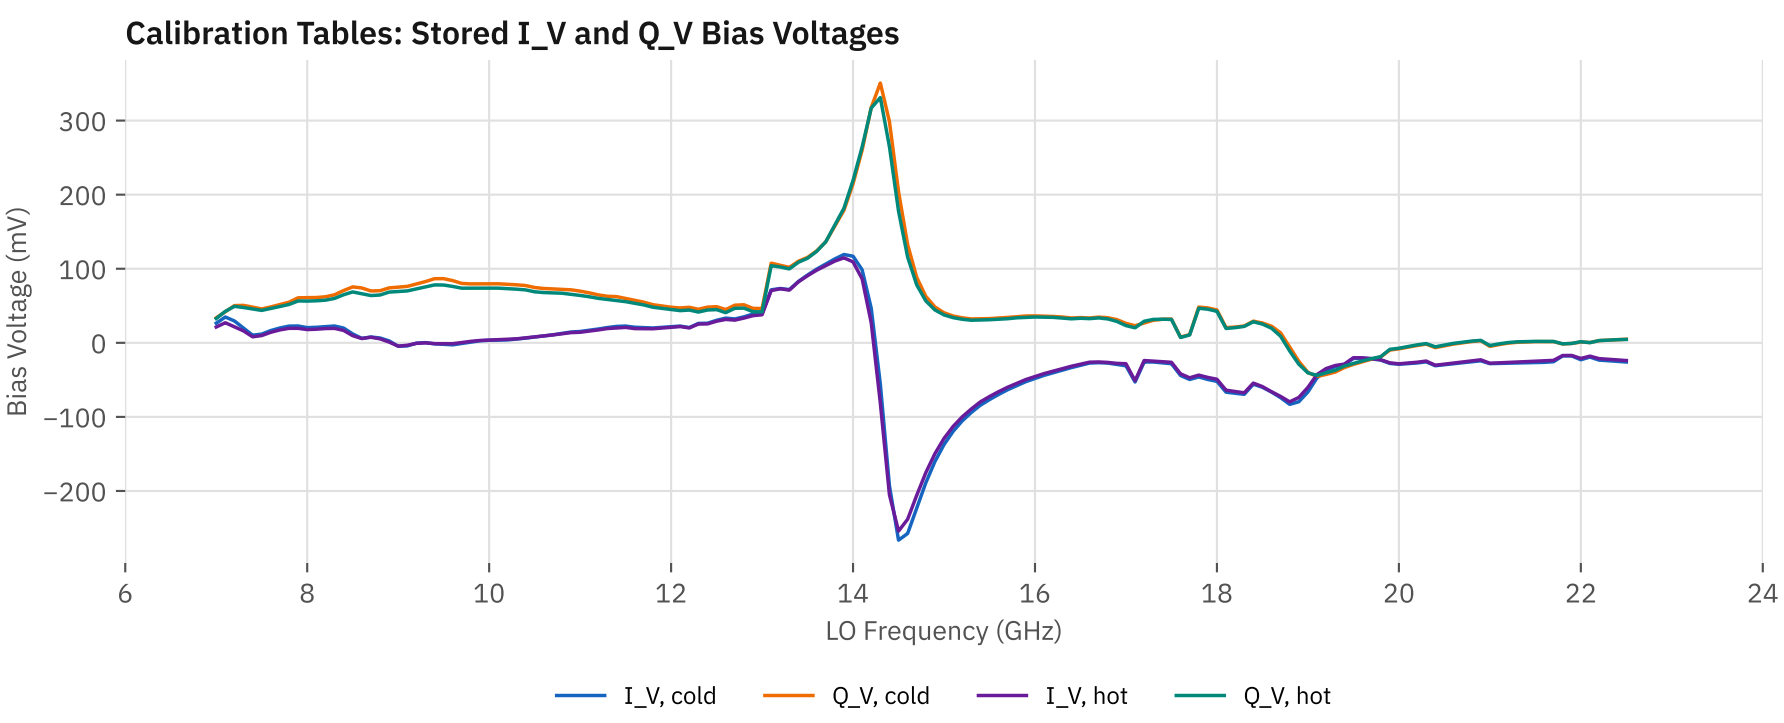
Calibration Tables: Stored I_V and Q_V Bias Voltages
Bias Voltage (mV)
300
200
100
0
−100
−200
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
LO Frequency (GHz)
I_V, cold
Q_V, cold
I_V, hot
Q_V, hot