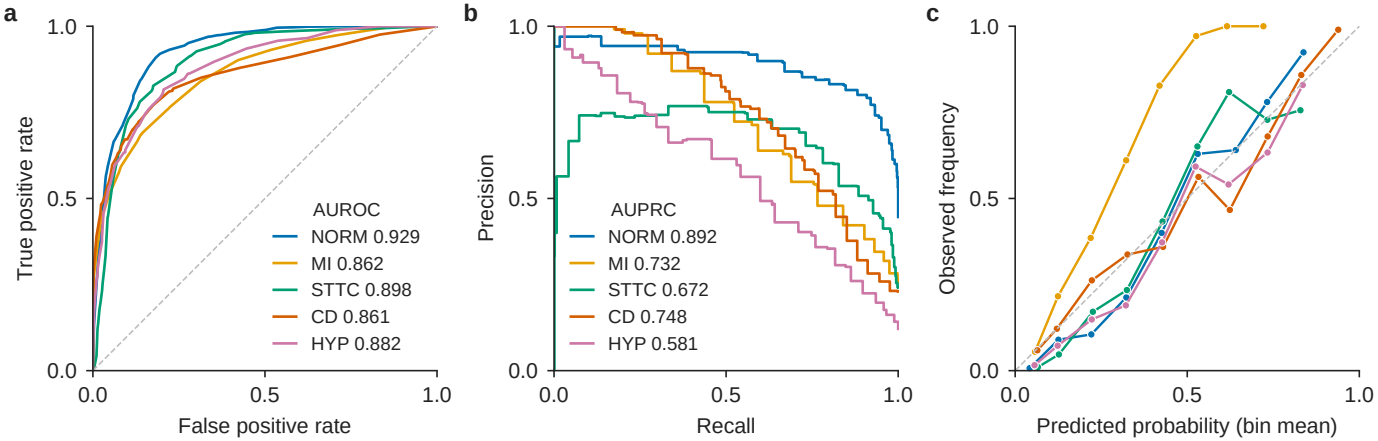
a
1.0
0.5
0.0
True positive rate
0.0
0.5
1.0
False positive rate
AUROC
NORM 0.929
MI 0.862
STTC 0.898
CD 0.861
HYP 0.882
b
1.0
0.5
0.0
Precision
0.0
0.5
1.0
Recall
AUPRC
NORM 0.892
MI 0.732
STTC 0.672
CD 0.748
HYP 0.581
c
1.0
0.5
0.0
Observed frequency
0.0
0.5
1.0
Predicted probability (bin mean)