


【도 21】

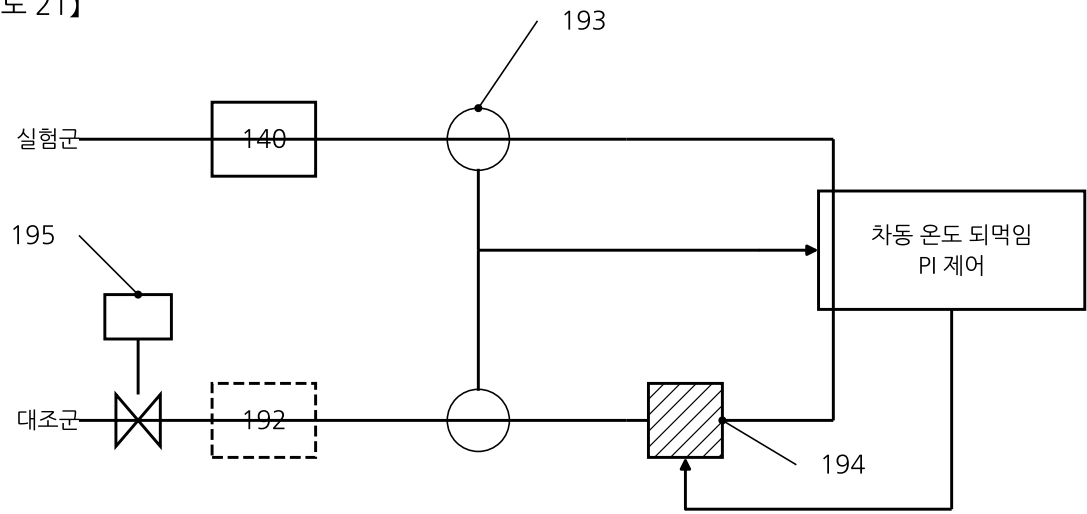

제1단 전동 트림 밸브(195) : 유량 비대칭을 10분의 1로 축소
제2단 차동 온도 센서쌍(193) + 트림 히터(194) : 잔차를 이중맹검 한계 이내로 유지
트림 히터는 대조군 측에만 배치한다. 실험군에 발열체를 두면 그 자체가 자기장과
상관된 열원이 되어 열 인공물의 판별이 다시 불가능해진다.