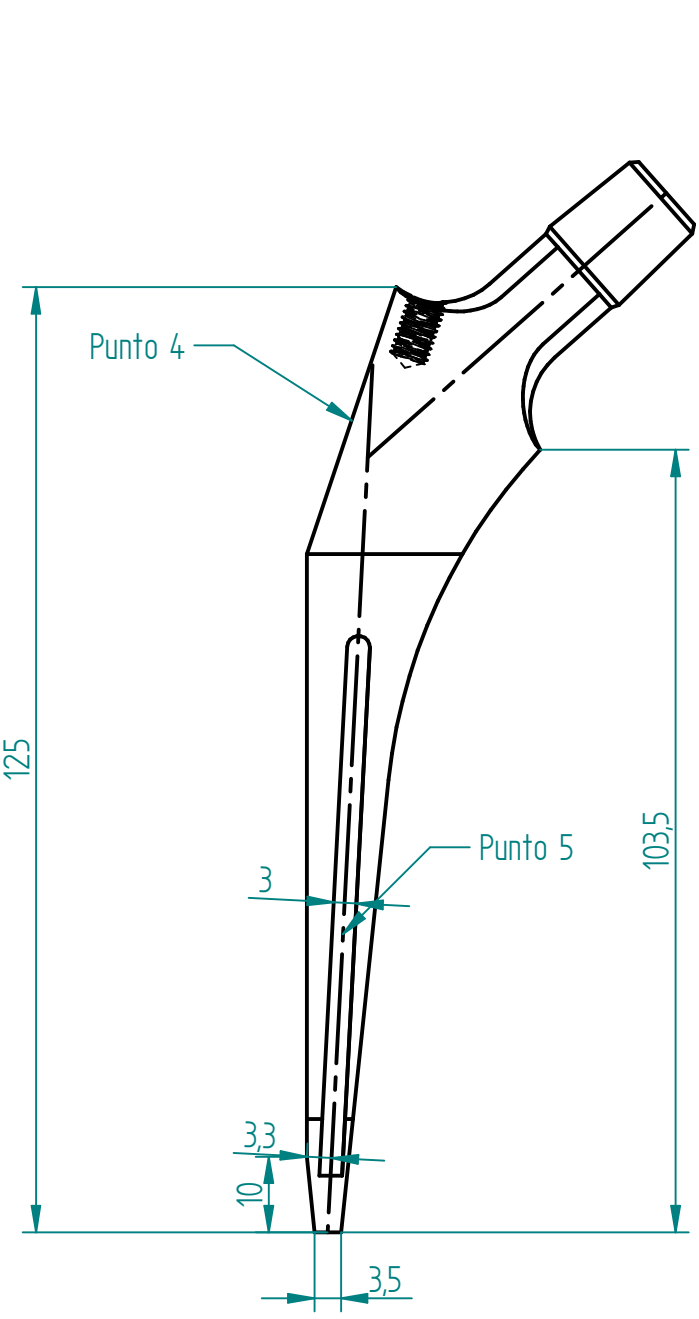


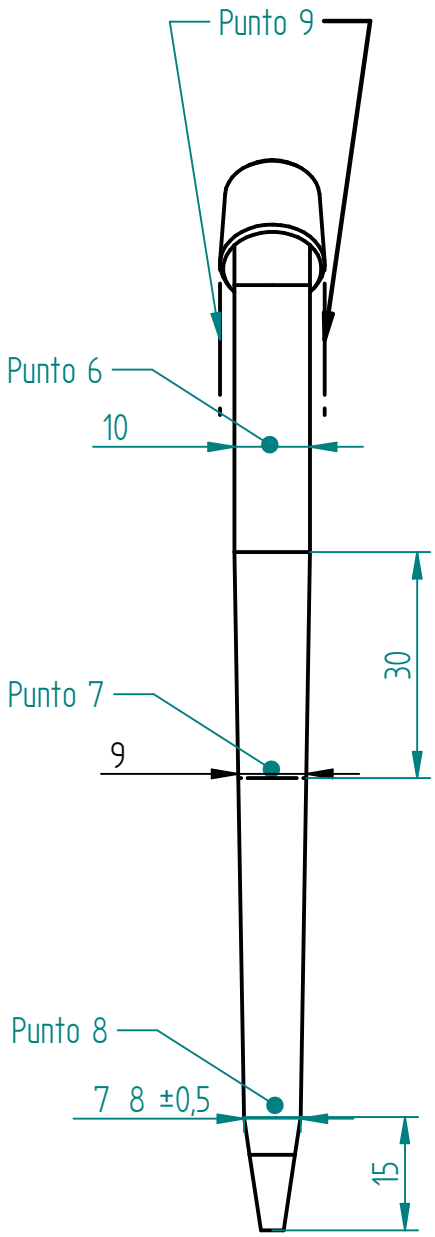


| Notas Generales | Hoja | Nombre/Firma | Fecha | Rev. | Alteración | Fecha | Resp. | Aprov. | IC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interpretar GD&T según **ASME Y14.5-2018**. | Dibujó: | Hatchadourian N. | 19/06/2026 | | | | | | |
| Todas las dimensiones en mm. | Controló: | | | | | | | | |
| Quitar rebabas y aristas vivas. | Aprobó: | | | | | | | | |
| Romper aristas 0,2-0,5 mm. | Material: | | | | | | | | |
| Escala: 1:1 ISO A | Trat.Term: | | | Denominación: Plano Control - Tallo Hip-Lock 5 | | | | | |
| Tol. No Especif. / Terminación Superficial | Trat. Sup: | | | Código de pieza: | | Revisión | | | |
| X ±0,20 ~ En Bruto 25 µ | Ensayo: | | | Número de plano: | | | | | |
| X.X ±0,10 ▽ Mecanizado Grueso 12,5 µ | Peso: | | | | | | | | |
| X.XX ±0,05 ▽▽ Mecanizado Fino 3,2 µ | | | | | | | | | |
| Ángulos ±0,5° ▽▽▽ Pulido o Rectificado 1,6 µ | | | | | | | | | |

**Villalba Hnos. Implantes**