


^exo

Andrea M DSC-UV 20CAR FINE 3DP 1

10.02.2020 12:28:20

Method: DSC UV 3min 30% 0.1 SI
dt 0,10 s
25,0°C 5,0 min TRG<60 s; 180 s>
Synchronization disabled

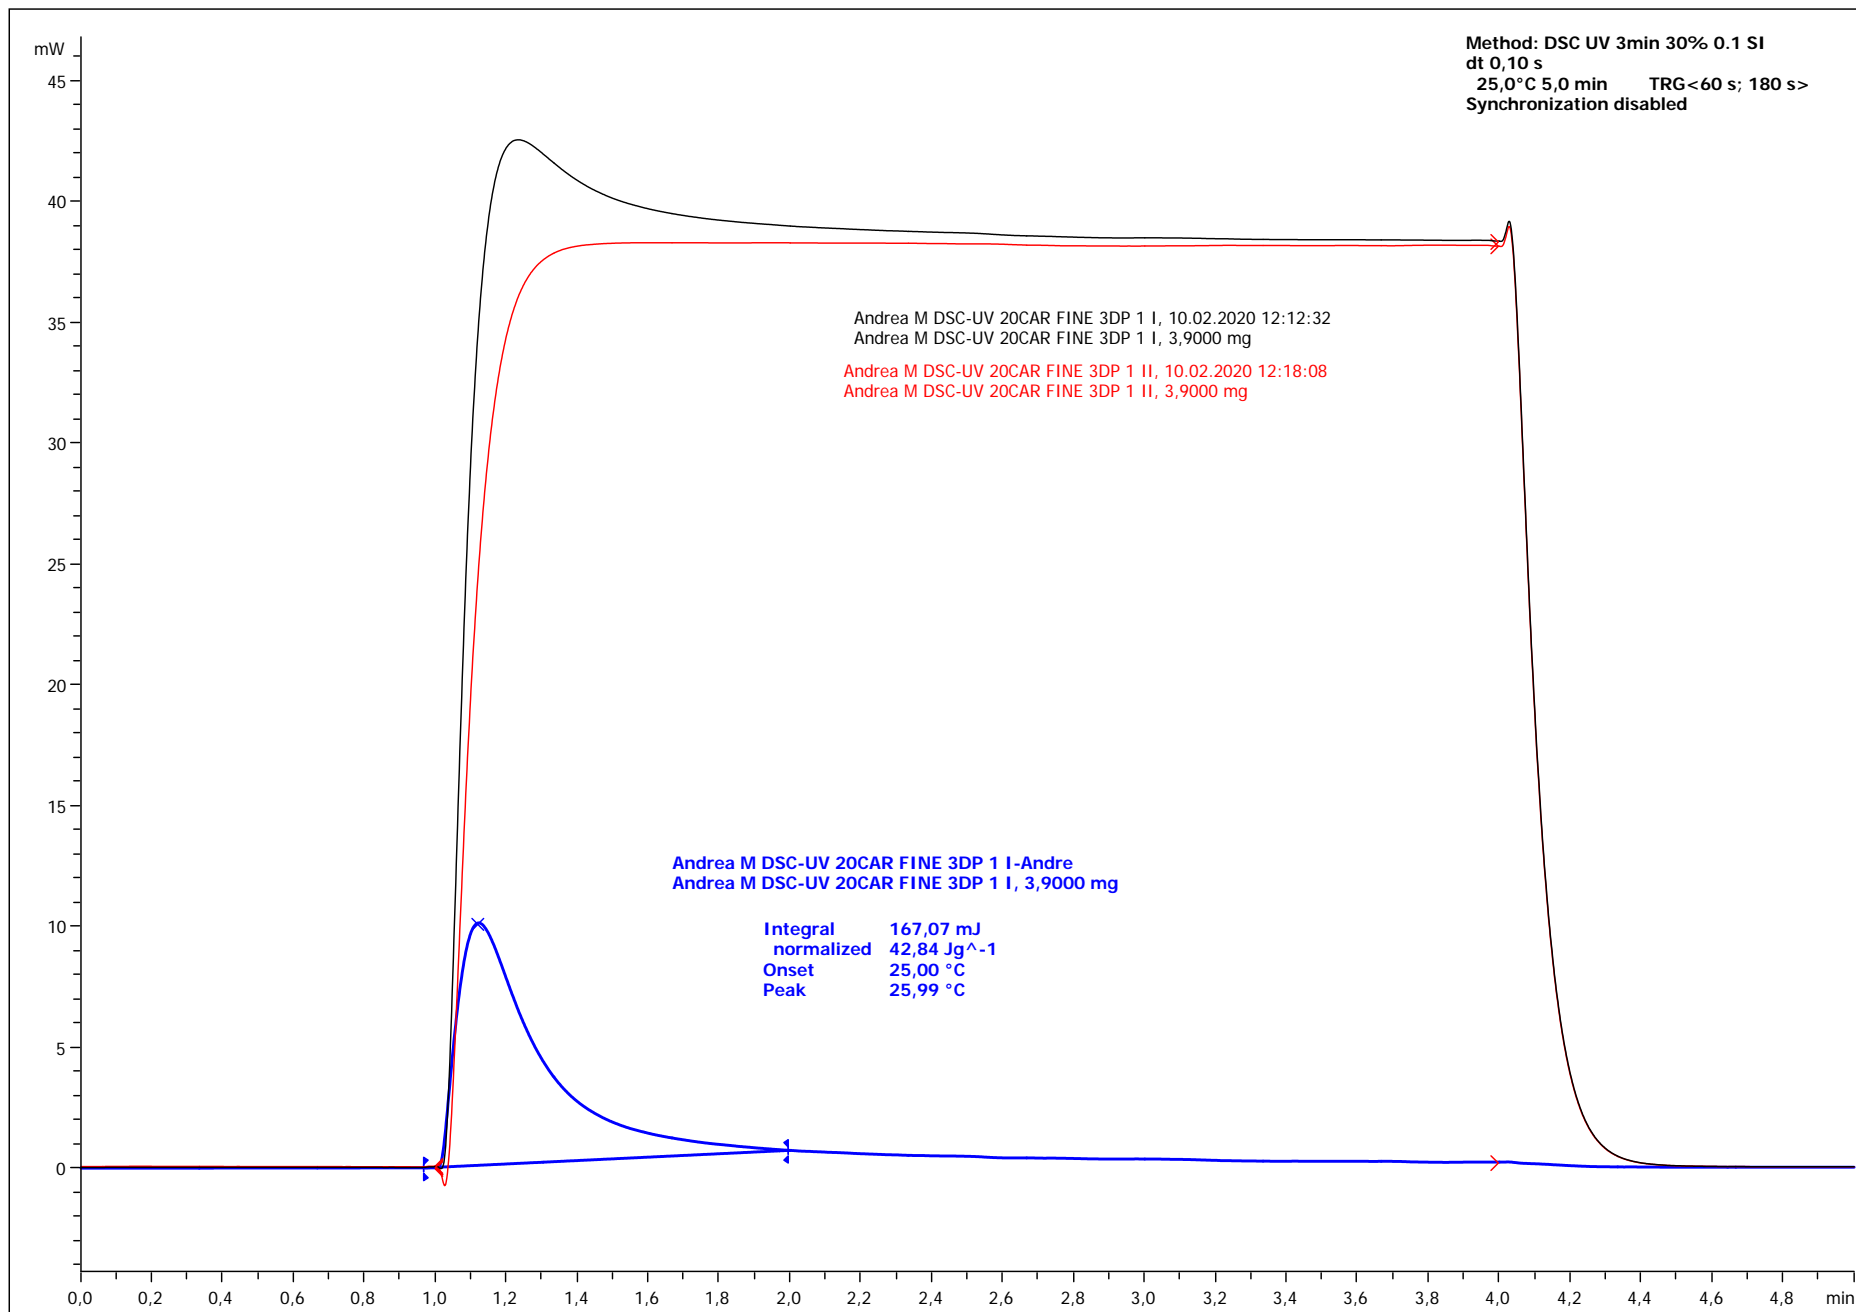

Lab: METTLER

STAR^e SW 9.30