

Gestión de Alertas

Se explican la ventana detalle y todo el proceso para gestionar alertas por medio de ella.




Escrito por WIN Software

Ventana Detalle

Para ingresar al detalle del Activo y hacer gestión de la alerta ingrese dando un clic sobre el registro en el visor, el cual muestra la siguiente ventana detalle:

Imagen 8. Tecnovigilancia - Ventana Detalle

El usuario puede actualizar el estado de la alerta del Activo por medio del botón **ACTUALIZAR** .

En caso de aplicar accione el switch **No Aplica/Aplica** y guarde los cambios:

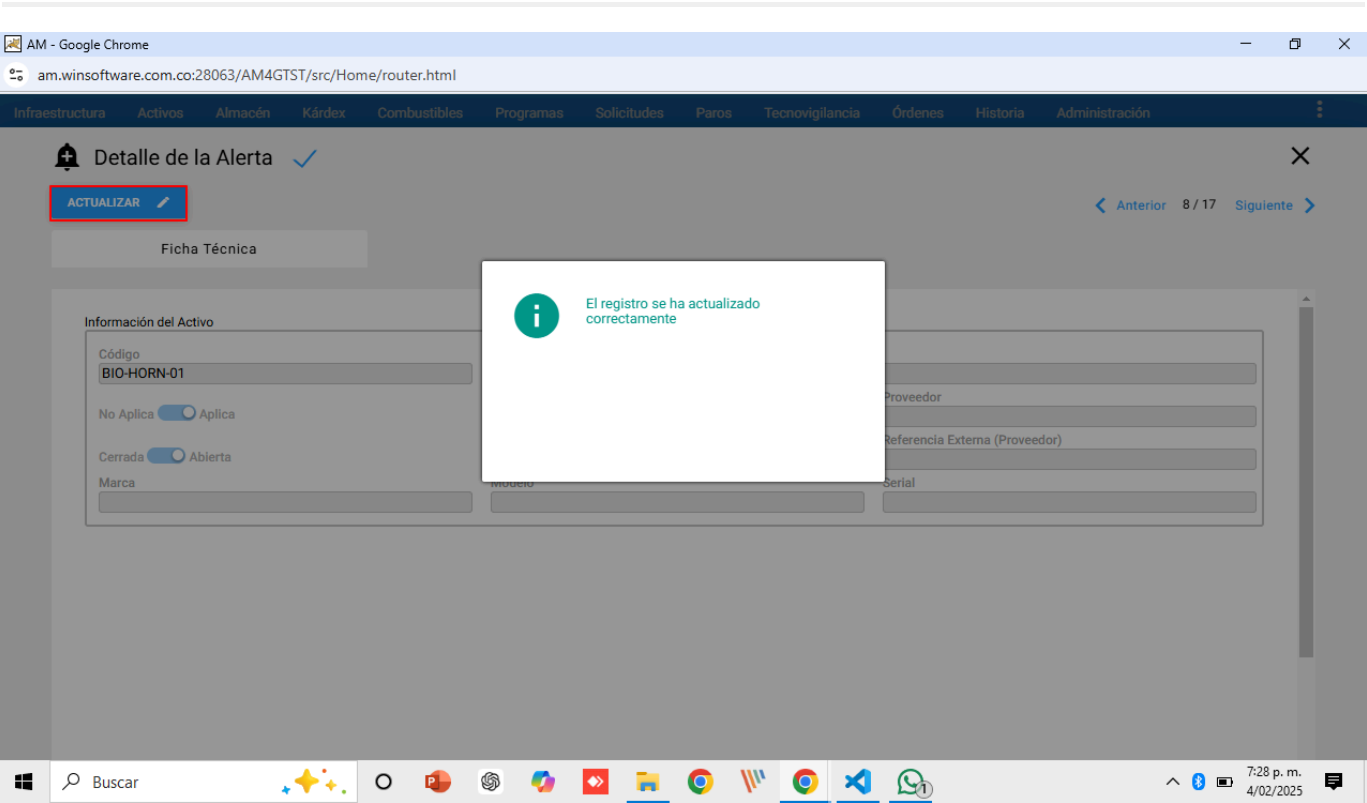


Imagen 9. Tecnovigilancia - Actualizar Alerta

A medida que se actualizan las alertas se actualizan los indicadores:

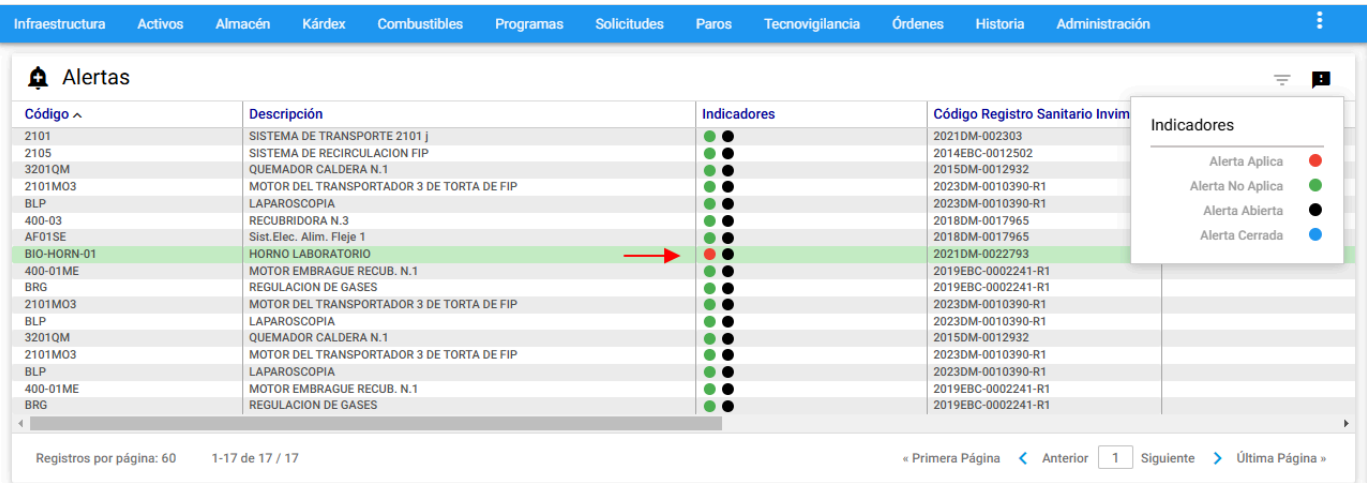





Imagen 10. Tecnovigilancia - Alerta

De esta manera al ingresar se visualizan los siguientes detalles para la alerta que aplica:

[Infraestructura](#) [Activos](#) [Almacén](#) [Kárdex](#) [Combustibles](#) [Programas](#) [Solicitudes](#) [Paros](#)

[Tecnovigilancia](#) [Órdenes](#) [Historia](#) [Administración](#)

 **Detalle de la Alerta** 

ACTUALIZAR 

[< Anterior](#) 8 / 17 [Siguiete >](#)

Ficha Técnica

Información del Activo

Código BIO-HORN-01	Descripción HORNO LABORATORIO	
No Aplica <input checked="" type="checkbox"/> Aplica	Código Registro Sanitario Invima 2021DM-0022793	Proveedor
Cerrada <input checked="" type="checkbox"/> Abierta	Ubicación Física Laboratorio Químico	Referencia Externa (Proveedor)
Marca	Modelo	Serial

Información de la Alerta

Asunto Alerta sanitaria sobre: SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS - SISTEMA DE PREPARACIÓN		
Nombre del Producto SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS - SISTEMA DE		Risarth DA2412-00795
Estado de la Alerta FF Publicación	Fuente	Lote
SEGUIMIENTO 2025-01-08	IMPORTADOI	1911011136

Visualizar Alerta

Comentarios y Acciones Realizadas

Comentario	Acciones Realizadas
<div></div> <div>Agregar Comentario</div>	<div></div> <div>Agregar Accion Realizada</div>

Imagen 11. Tecnovigilancia - Detalle Alerta

Es posible hacer la visualización completa del INVIMA accionando el botón

Visualizar Alerta



Imagen 12. Tecnovigilancia - Detalle Alerta INVIMA

Es necesario que se registren los comentarios y las acciones realizadas con respecto a la alerta, accionando el botón **Agregar Comentario** y **Agregar Acción Realizada**:

Infraestructura

Activos

Almacén

Kárdex

Combustibles

Programas

Solicitudes

Paros

Tecnovigilancia

Órdenes

Historia

Administración

Detalle de la Alerta

ACTUALIZAR

< Anterior 8 / 17 Siguiente >

Ficha Técnica

Información del Activo

Código

BIO-HORN-01

Descripción

HORNO LABORATORIO

No Aplica

☒

Aplica

Código Registro Sanitario Invima

2021DM-0022793

Proveedor

Cerrada

☒

Abierta

Ubicación Física

Laboratorio Quimico

Referencia Externa (Proveedor)

Marca

Modelo

Serial

Información de la Alerta

Asunto

Alerta sanitaria sobre: SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS - SISTEMA DE PREPARACIÓN

Nombre del Producto

SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS - SISTEMA DE

Risarth

DA2412-00795

Estado de la Alerta

FF Publicación

Fuente

Lote

SEGUIMIENTO

2025-01-08

IMPORTADOI

1911011136

Visualizar Alerta

Comentarios y Acciones Realizadas

Comentario

Se inician procedimientos de revisiones.

Agregar Comentario

Acciones Realizadas

Se procede a retirar el equipo del servicio para revisión, estudio y monitoreo.

Agregar Accion Realizada

Imagen 13. Tecnovigilancia - Agregar Comentarios y Acciones

Los comentarios van quedando agregados en una ventana tipo chat:

Infraestructura

Activos

Almacén

Kárdex

Combustibles

Programas

Solicitudes

Paros

Tecnovigilancia

Órdenes

Historia

Administración

Detalle de la Alerta

ACTUALIZAR

< Anterior

8 / 17

Siguiente >

Ficha Técnica

Información del Activo

Código

BIO-HORN-01

Descripción

HORNO LABORATORIO

No Aplica

Aplica

Cerrada

Abierta

Marca

Código Registro Sanitario Invima

2021DM-0022793

Proveedor

Ubicación Física

Laboratorio Quimico

Referencia Externa (Proveedor)

Modelo

Serial

Información de la Alerta

Asunto

Alerta sanitaria sobre: SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS - SISTEMA DE PREPARACIÓN

Nombre del Producto

SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS - SISTEMA DE

Risarth

DA2412-00795

Estado de la Alerta

FF

Publicación

SEGUIMIENT

2025-01-08

Fuente

IMPORTADOI

Lote

1911011136

Visualizar Alerta

Comentarios y Acciones Realizadas

Comentario

Agregar Comentario

Acciones Realizadas

Agregar Accion Realizada

Administrador de la Compañía - 2025-02-04 19:53

Se inician procedimientos de revisiones.

Administrador de la Compañía - 2025-02-04 19:53

Se procede a retirar el equipo del servicio para revisión, estudio y monitoreo.

Imagen 14. Tecnovigilancia - Agregar Comentarios y Acciones

Además, una vez que una alerta aplique y se encuentre abierta se genera una Orden de Trabajo, todo esto permite agregar documentación y trazabilidad a la gestión de la alerta:

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Combustibles Programas Solicitudes Paros Tecnovigilancia Órdenes Historia Administración									
Ordenes de Trabajo NUEVO									
Número	Descripción	F/H Creación	Responsable	Pri	F/H Programada	Estado	Indicadores	Cod. Activo	Desc. Act
2025-142	Orden Generada desde Tecnovigilancia por Alerta sanita...	2025-02-04 19:28		2	2025-02-04 19:28	EJ		BIO-HORN-01	HORNO LA...
2025-141	Orden Generada desde Tecnovigilancia por Alerta sanita...	2025-02-04 13:19		2	2025-02-04 13:19	EJ		3201QM	QUEMADOI...
2025-140	Orden Generada por lectura ALTA en la característica te...	2025-01-30 14:38		2	2025-01-30 14:38	EJ		BMO-MSV-9359	Monitor de...
2025-139	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-31 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-138	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-30 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-137	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-29 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-136	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-28 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-135	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-27 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-134	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-26 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-133	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-25 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-132	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-24 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-131	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-23 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-130	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-22 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-129	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-21 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-128	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-20 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-127	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-19 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-126	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-18 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-125	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-17 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-124	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-16 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-123	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-15 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-122	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-14 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-121	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-13 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-120	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-12 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-119	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-11 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-118	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-10 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-117	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-09 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR
2025-116	prueba AM4G	2025-01-10 16:13		3	2025-01-08 00:00	EJ		** FT NKR **	FICHA NKR

Imagen 15. Tecnovigilancia - Generación de OT

En el Activo también se visualiza el indicador de alerta sanitaria INVIMA:

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Combustibles Programas Solicitudes Paros Tecnovigilancia Órdenes Historia Administración									
Activos NUEVO									
Código	Descripción	Estado	Indicadores	Centro de Costo	Ubicación Física	Activo F			
BID	RX IMÁGENES DIAGNOSTICAS	A - En Operación		CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA				
BIO-CAB-01	CABINA DE FLUJO LAMINAR	A - En Operación		CENTRO LABORATORIOS	Laboratorio Químico				
BIO-EST-VA01	ESTERILIZADOR A VAPOR	A - En Operación		WIN Software	CLIS-P01-URGENCIAS.C...				
BIO-HORN-01	HORNO LABORATORIO	A - En Operación		CENTRO LABORATORIOS	Laboratorio Químico				
BIO-TER-01	TERMOSINFECTADORA	A - En Operación		LB-Laboratorio	Man-PExt.Esterilización	Prueba			
BIO-UTC-01	ULTRACONGELADOR 578 LITROS	A - En Operación		WIN Software	Laboratorio Químico				
BIQ	INSTRUMENTAL QUIRURGICO	A - En Operación		CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA				
BL03	Balanceadora Schenk 110	A - Dado en Présta...		BP-Bascula y Pesaje	Adm.-Personal				
BL03MT	Motor Bal Schenk	A - En Operación		BP-Bascula y Pesaje	Taller Mantenimiento				
BL03MT02	Motor Bal Schenk 02	A - En Operación		BP-Bascula y Pesaje	Taller Mantenimiento				
BLA	LABORATORIO	A - En Operación		CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA				
BLP	LAPAROSCOPIA	A - En Operación		CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA				
BM-MAN-5678	Máquina de Anestesia	A - En Operación		HO-Servicios Médicos	CLIS-P03-QUIROFANO 1	5678.			
BMAIH300	Bomba Aire Honeywell 300	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Planta de Fosfato				
BMAIH300-1	Bomba Aire Honeywell 300-1	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Planta de Fosfato				
BMAIH321	Bomba Aire Honeywell 321	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Planta de Fosfato				
BMAIH324	Bomba Aire Honeywell 324	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Planta de embragues				
BMAIH327	Bomba Aire Honeywell 327	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Planta de Fosfato				
BMAIH329	Bomba Aire Honeywell 329	A - En Operación		Clinica Nueva Sede Poblado	HMF5-P1.S. Oxigenotera...	8723098	8723098		ygbkigig
BMAIH335	Bomba Aire Honeywell 335	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Planta de Fosfato				ytiututut
BMAIH524	Bomba Aire Honeywell 524	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Taller Mantenimiento				8766hbgvf
BMAIH525	Bomba Aire Honeywell 525	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Taller Mantenimiento				8766hbgvf
BMAIH529	Creado en la importación de Historia	A - En Operación		CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA				
BMAIH875	Bomba Aire Honeywell 875	A - En Operación		DS-Departamento Servicios	Planta de embragues				886644123
BMAIH999	Creado en la importación de Historia	A - En Operación		CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA				
BMO	MONITOREO	A - En Operación		CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA				
BMO-MSV-9359	Monitor de signos vitales	A - En Operación		Clinica Nueva Sede Centro	CLIS-P03-QUIROFANO 3	93590	1234567890		HK00693CFEER1

Imagen 16. Tecnovigilancia - Indicador Alerta Activos

Nota: Para actualizar la alerta ingrese nuevamente al módulo de **Tecnovigilancia** y accione nuevamente el botón **Activos con Alertas**.

Tecnovigilancia

Activos con Alertas

Para dar cierre actualice la alerta accionando el switch Cerrada/Abierta y a medida que se cierren las alertas los indicadores se actualizan:

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Combustibles Programas Solicitudes Paros Tecnovigilancia Órdenes Historia Administración						
Alertas						
Código ^	Descripción	Indicadores	Código Registro Sanitario Invi	Proveedor		
2101	SISTEMA DE TRANSPORTE 2101	● ● ●	2021DM-002303	DELL CORP		
2105	SISTEMA DE RECIRCULACION FIP	● ● ●	2014EBC-0012502			
3201QM	QUEMADOR CALDERA N.1	● ● ●	2015DM-0012932			
2101M03	MOTOR DEL TRANSPORTADOR 3 DE TO...	● ● ●	2023DM-0010390-R1			
BLP	LAPAROSCOPIA	● ● ●	2023DM-0010390-R1			
400-03	RECUBRIDORA N.3	● ● ●	2018DM-0017965	WH Nichols CO		
AF01SE	Sist.Elec. Alim. Fleje 1	● ● ●	2018DM-0017965	The Trenth Engin DIV. V.A		
BIO-HORN-01	HORNO LABORATORIO	● ● ●	2021DM-0022793			
400-01ME	MOTOR EMBRAGUE RECUB. N.1	● ● ●	2019EBC-0002241-R1			
BRG	REGULACION DE GASES	● ● ●	2019EBC-0002241-R1			
2101M03	MOTOR DEL TRANSPORTADOR 3 DE TO...	● ● ●	2023DM-0010390-R1			
BLP	LAPAROSCOPIA	● ● ●	2023DM-0010390-R1			
3201QM	QUEMADOR CALDERA N.1	● ● ●	2015DM-0012932			
2101M03	MOTOR DEL TRANSPORTADOR 3 DE TO...	● ● ●	2023DM-0010390-R1			
BLP	LAPAROSCOPIA	● ● ●	2023DM-0010390-R1			
400-01ME	MOTOR EMBRAGUE RECUB. N.1	● ● ●	2019EBC-0002241-R1			
BRG	REGULACION DE GASES	● ● ●	2019EBC-0002241-R1			

Indicadores

- Alerta Aplica ●
- Alerta No Aplica ●
- Alerta Abierta ●
- Alerta Cerrada ●

Registros por página: 60 1-17 de 17 / 17

« Primera Página Anterior 1 Siguiente Última Página »

Imagen 17. Tecnovigilancia - Cierre Alertas

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Combustibles Programas Solicitudes Paros Tecnovigilancia Órdenes Historia Administración								
Activos NUEVO								
BIO-HORN-01								
Código ^	Descripción	Estado	Indicadores	Centro de Costo	Ubicación Física	Activo Fijo	Cod. Barras Int.	Serial
BID	RX IMÁGENES DIAGNOSTICAS	A - En Operación	● ● ●	CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA			
BIO-CAB-01	CABINA DE FLUJO LAMINAR	A - En Operación	● ● ●	CENTRO LABORATORIOS	Laboratorio Químico			
BIO-EST-VA01	ESTERILIZADOR A VAPOR	A - En Operación	● ● ●	WIN Software	CLIS-P01-URGENCIAS.C...			
BIO-HORN-01	HORNO LABORATORIO	A - En Operación	● ● ●	CENTRO LABORATORIOS	Laboratorio Químico			
BIO-TER-01	TERMOMESINFECTADORA	A - En Operación	● ● ●	LB-Laboratorio	Man-Pext.Esterilización	Prueba		
BIO-UTC-01	ULTRACONGELADOR 578 LITROS	A - En Operación	● ● ●	WIN Software	Laboratorio Químico			
BIQ	INSTRUMENTAL QUIRURGICO	A - En Operación	● ● ●	CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA			
BL03	Balanceadora Schenk 110	A - Dado en Presta...	● ● ●	BP-Bascula y Pesaje	Adm.-Personal			130191
BL03MT	Motor Bal Schenk	A - En Operación	● ● ●	BP-Bascula y Pesaje	Taller Mantenimiento			8761234
BL03MT02	Motor Bal Schenk 02	A - En Operación	● ● ●	BP-Bascula y Pesaje	Taller Mantenimiento			
BLA	LABORATORIO	A - En Operación	● ● ●	CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA			
BLP	LAPAROSCOPIA	A - En Operación	● ● ●	CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA			
BM-MAN-5678	Máquina de Anestesia	A - En Operación	● ● ●	HO-Servicios Médicos	CLIS-P03-QUIROFANO 1	5678.		GHK2637448
BMAIHW300	Bomba Aire Honeywell 300	A - En Operación	● ● ●	DS-Departamento Servicios	Planta de Fosfato			ytiutiutut
BMAIHW300-1	Bomba Aire Honeywell 300-1	A - En Operación	● ● ●	DS-Departamento Servicios	Planta de Fosfato			ytiutiutut
BMAIHW321	Bomba Aire Honeywell 321	A - En Operación	● ● ●	DS-Departamento Servicios	Planta de Fosfato			ytiutiutut
BMAIHW324	Bomba Aire Honeywell 324	A - En Operación	● ● ●	DS-Departamento Servicios	Planta de embragues			ygkygig
BMAIHW327	Bomba Aire Honeywell 327	A - En Operación	● ● ●	DS-Departamento Servicios	Planta de Fosfato			ytiutiutut
BMAIHW329	Bomba Aire Honeywell 329	A - En Operación	● ● ●	Clinica Nueva Sede Poblado	HMFS-P1.S. Oxigenotera...	8723098	8723098	HBJ-4398
BMAIHW335	Bomba Aire Honeywell 335	A - En Operación	● ● ●	DS-Departamento Servicios	Planta de Fosfato			ytiutiutut
BMAIHW524	Bomba Aire Honeywell 524	A - En Operación	● ● ●	DS-Departamento Servicios	Taller Mantenimiento			8766hbgf
BMAIHW525	Bomba Aire Honeywell 525	A - En Operación	● ● ●	DS-Departamento Servicios	Taller Mantenimiento			8766hbgf
BMAIHW529	Creado en la importación de Historia	A - En Operación	● ● ●	CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA			
BMAIHW875	Bomba Aire Honeywell 875	A - En Operación	● ● ●	DS-Departamento Servicios	Planta de embragues			88644123
BMAIHW999	Creado en la importación de Historia	A - En Operación	● ● ●	CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA			
BMO	MONITOREO	A - En Operación	● ● ●	CC-GENÉRICO	UF-GENÉRICA			
BMO-MSV-9359	Monitor de signos vitales	A - En Operación	● ● ●	Clinica Nueva Sede Centro	CLIS-P03-QUIROFANO 3	93590	1234567890	HK00693CFEET1

Registros por página: 60 121-180 de 574 / 574

« Primera Página Anterior 3 Siguiente Última Página »

Imagen 18. Tecnovigilancia - Cierre Alertas Activos