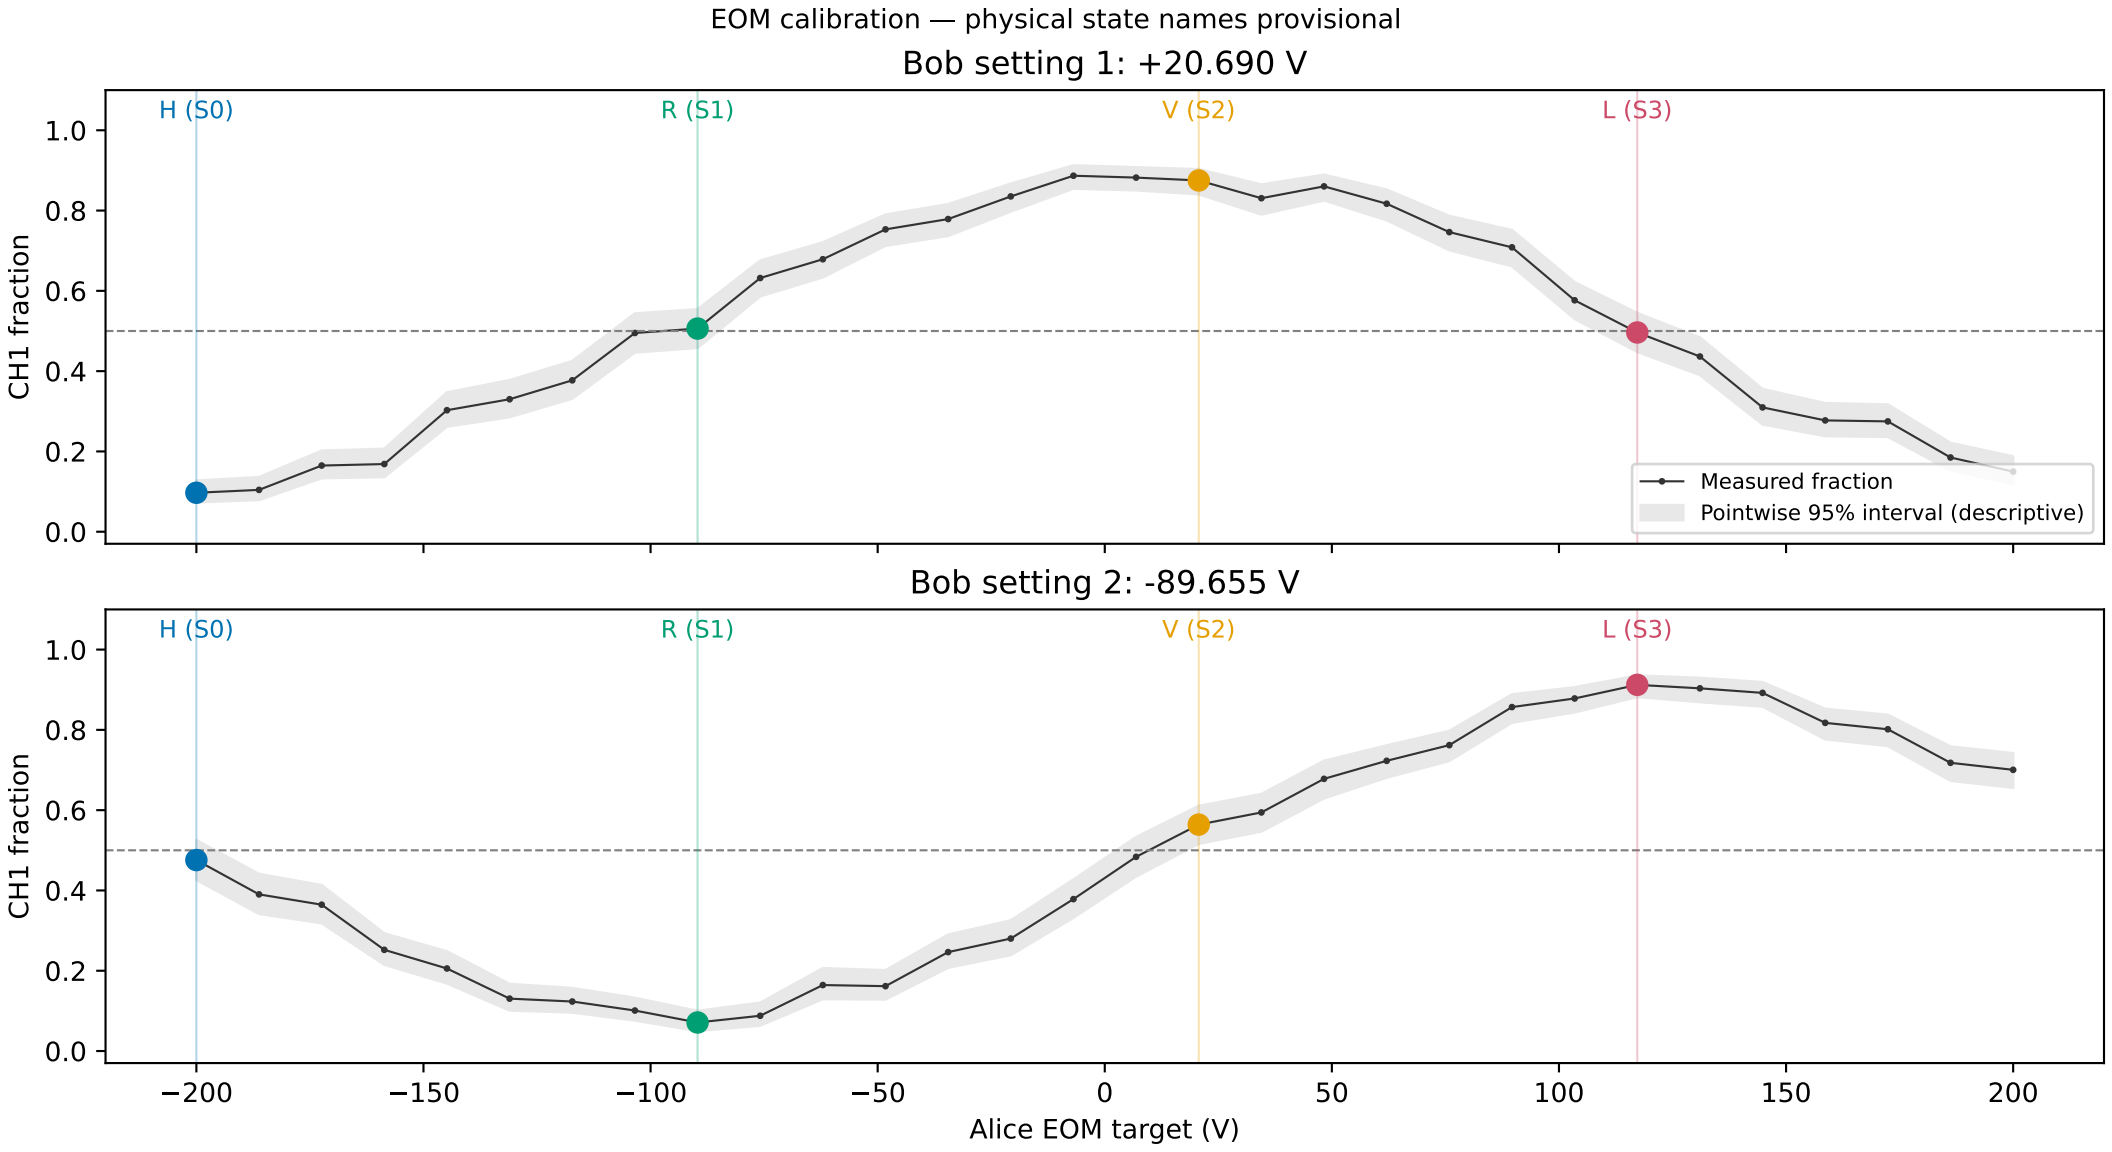
EOM calibration — physical state names provisional
Bob setting 1: +20.690 V
H (S0)
R (S1)
V (S2)
L (S3)
CH1 fraction
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Measured fraction
Pointwise 95% interval (descriptive)
Bob setting 2: -89.655 V
H (S0)
R (S1)
V (S2)
L (S3)
CH1 fraction
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−200
−150
−100
−50
0
50
100
150
200
Alice EOM target (V)