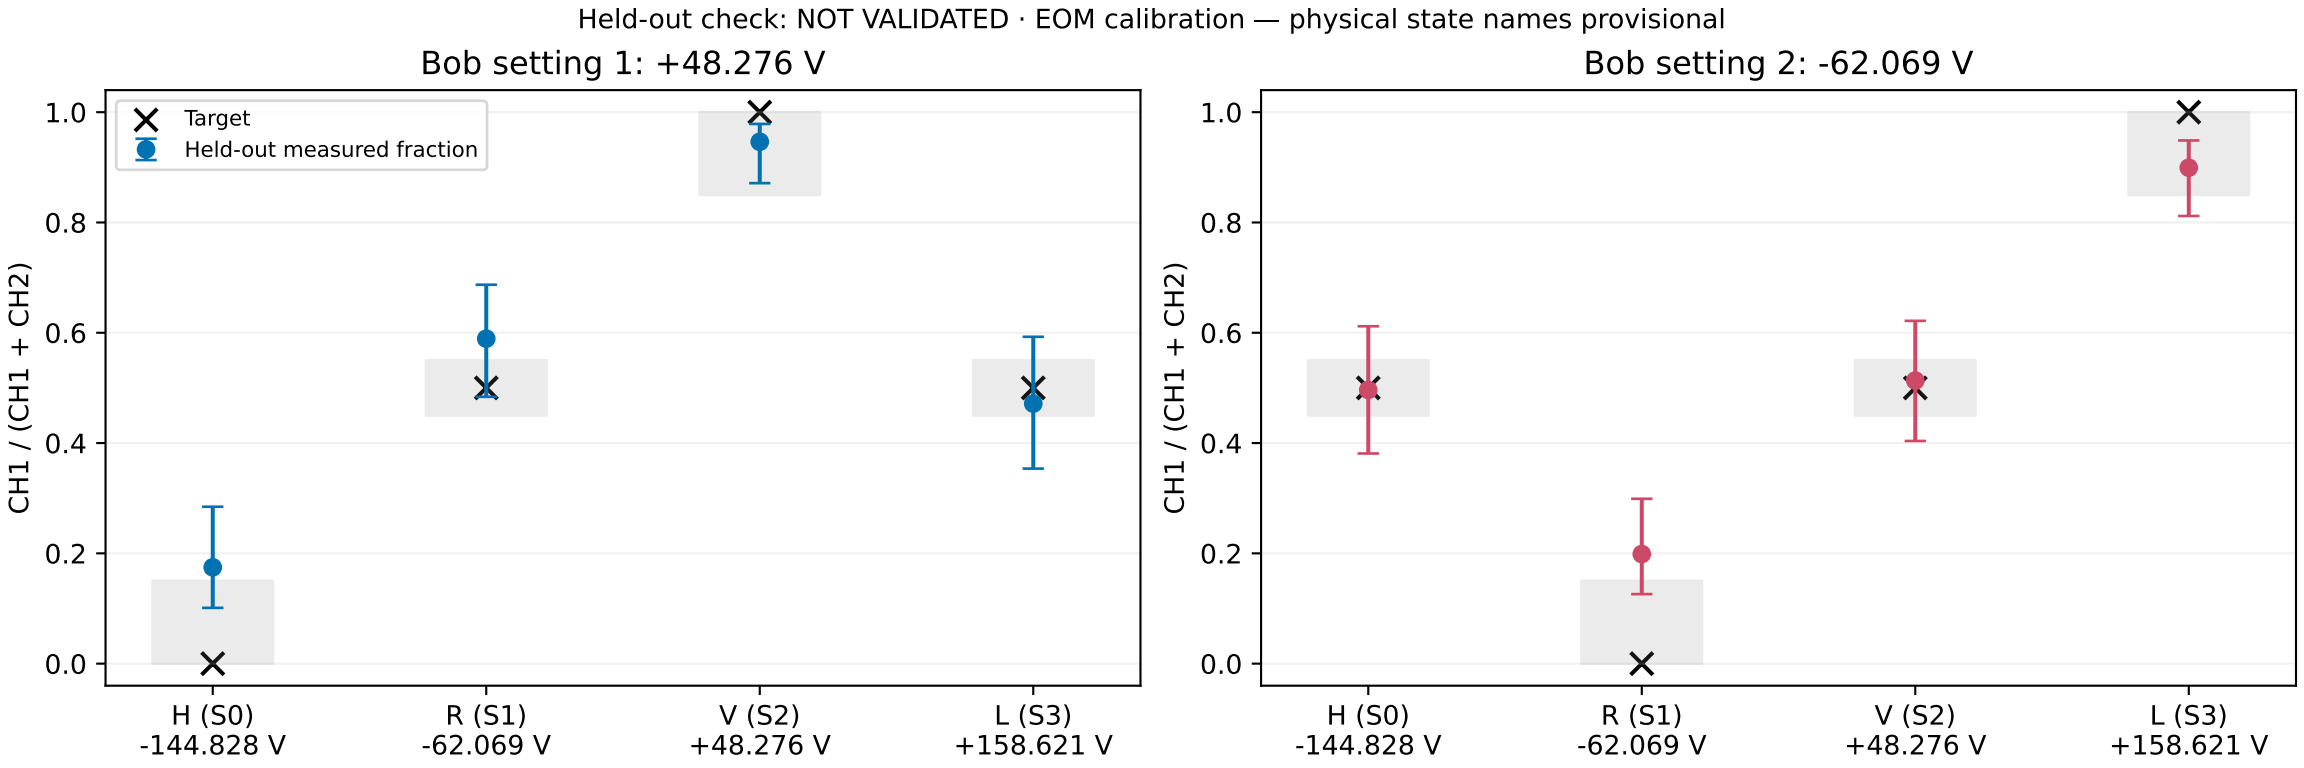
Held-out check: NOT VALIDATED · EOM calibration — physical state names provisional
Bob setting 1: +48.276 V
Bob setting 2: -62.069 V
Target
Held-out measured fraction
CH1 / (CH1 + CH2)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
H (S0)
-144.828 V
R (S1)
-62.069 V
V (S2)
+48.276 V
L (S3)
+158.621 V