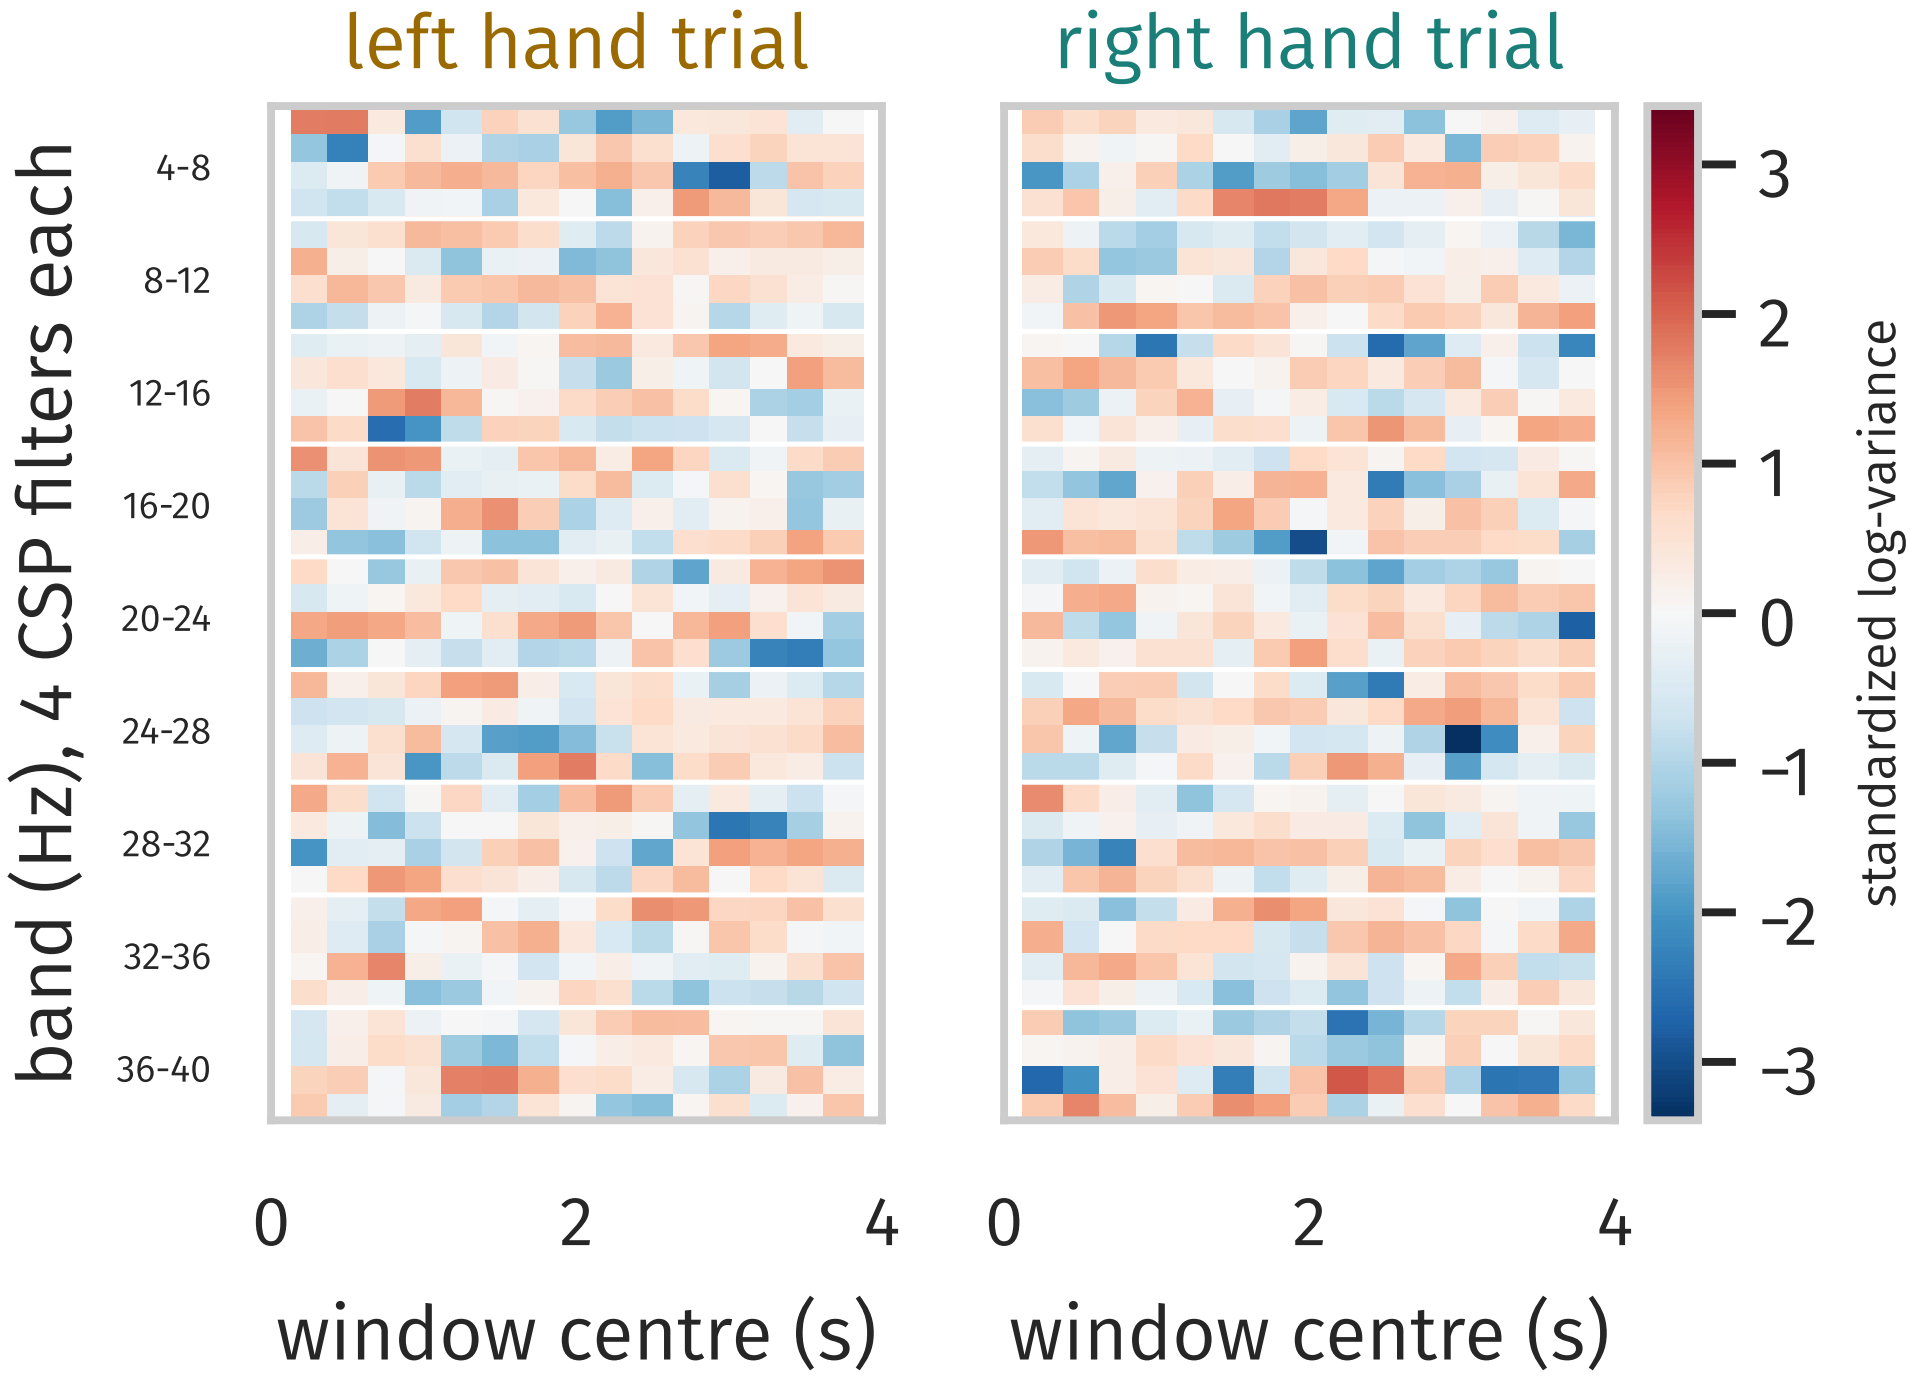
left hand trial
right hand trial
band (Hz), 4 CSP filters each
4-8
8-12
12-16
16-20
20-24
24-28
28-32
32-36
36-40
0
2
4
window centre (s)
0
2
4
window centre (s)
3
2
1
0
−1
−2
−3
standardized log-variance