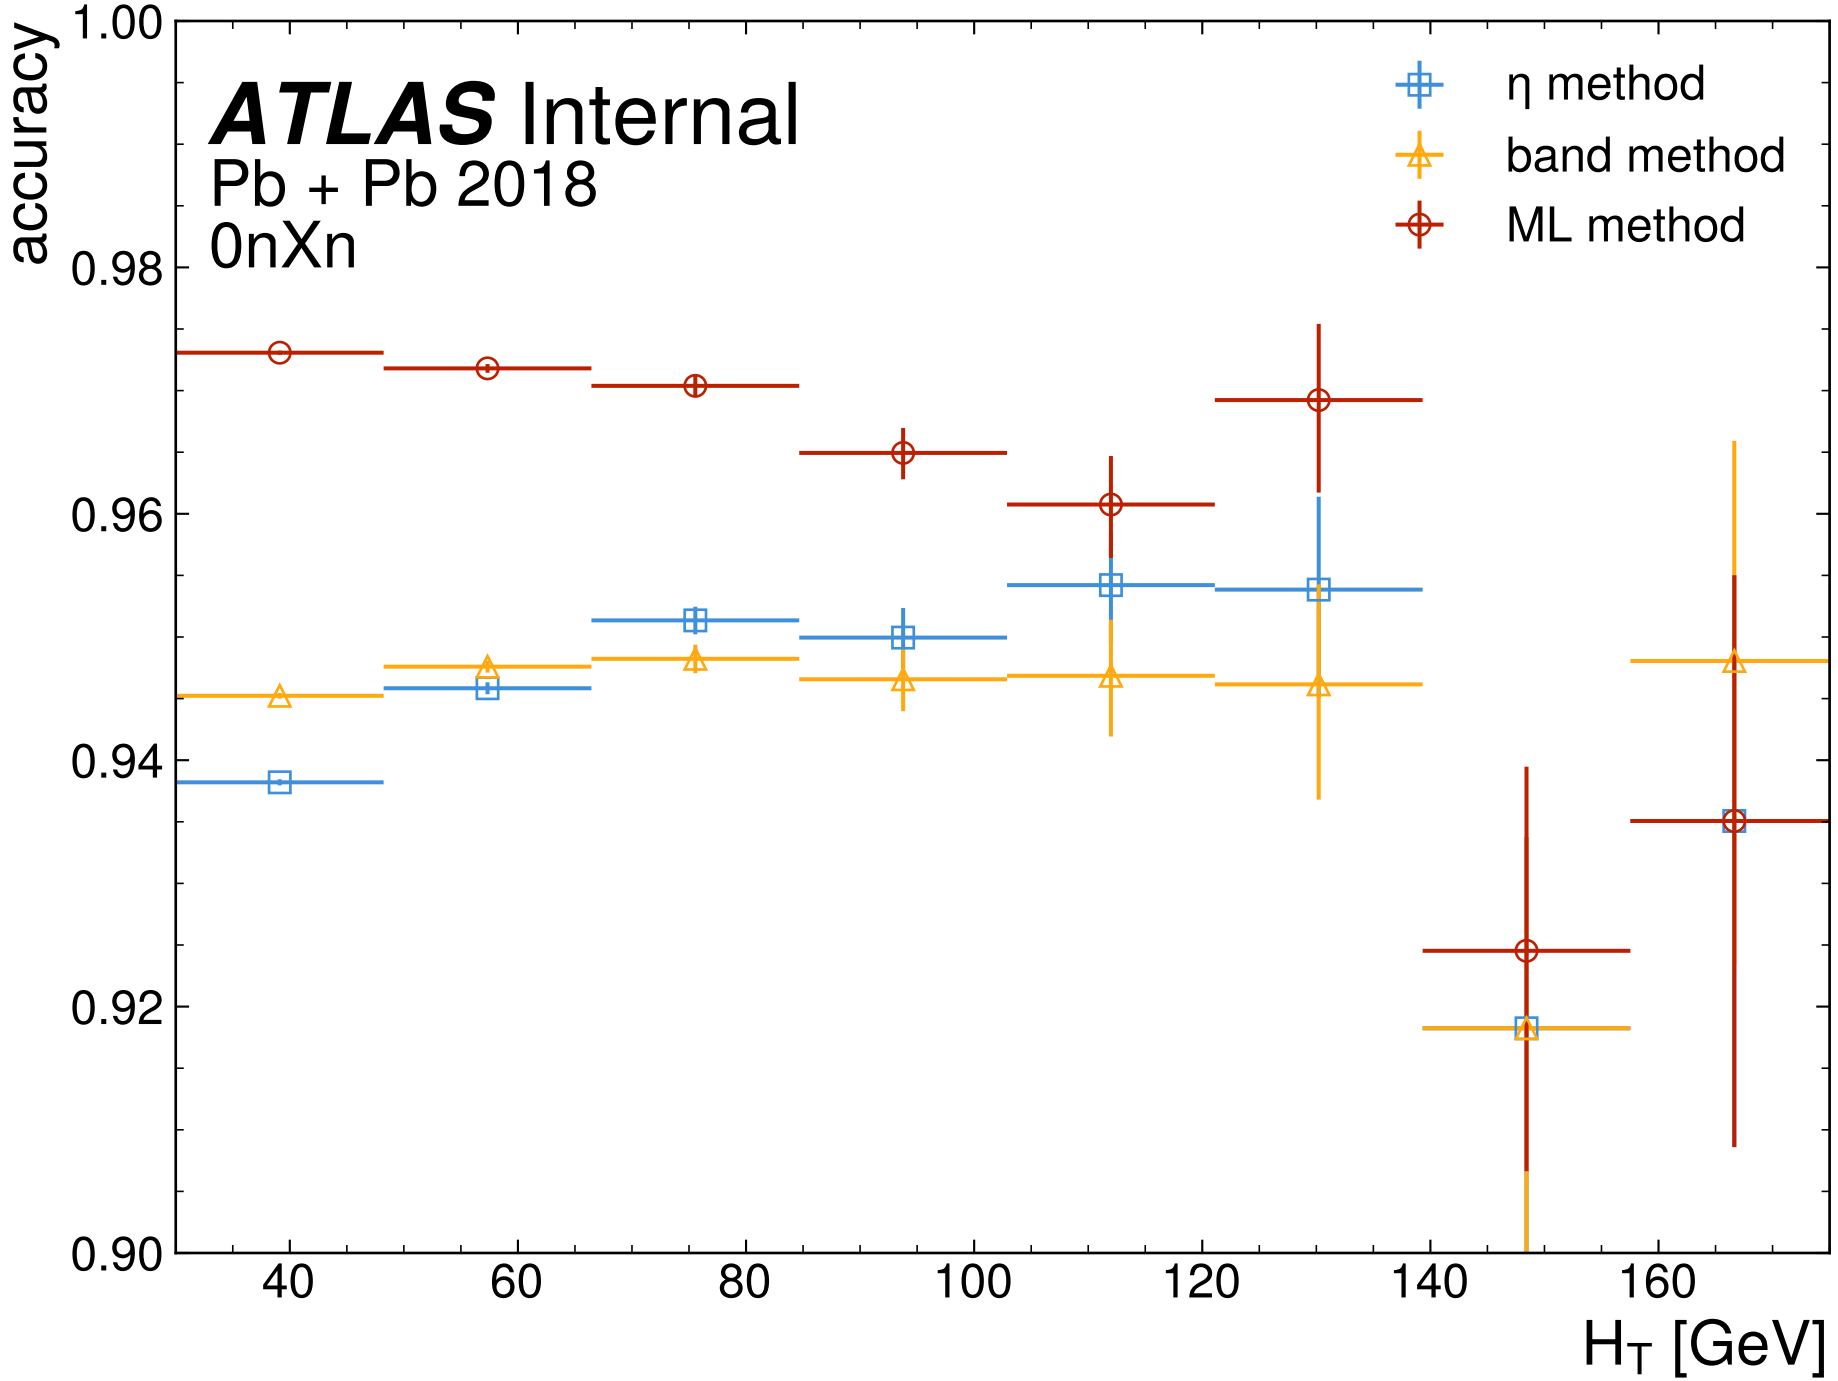
ATLAS Internal
Pb + Pb 2018
0nXn
η method
band method
ML method
accuracy
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
40
60
80
100
120
140
160
H_T [GeV]