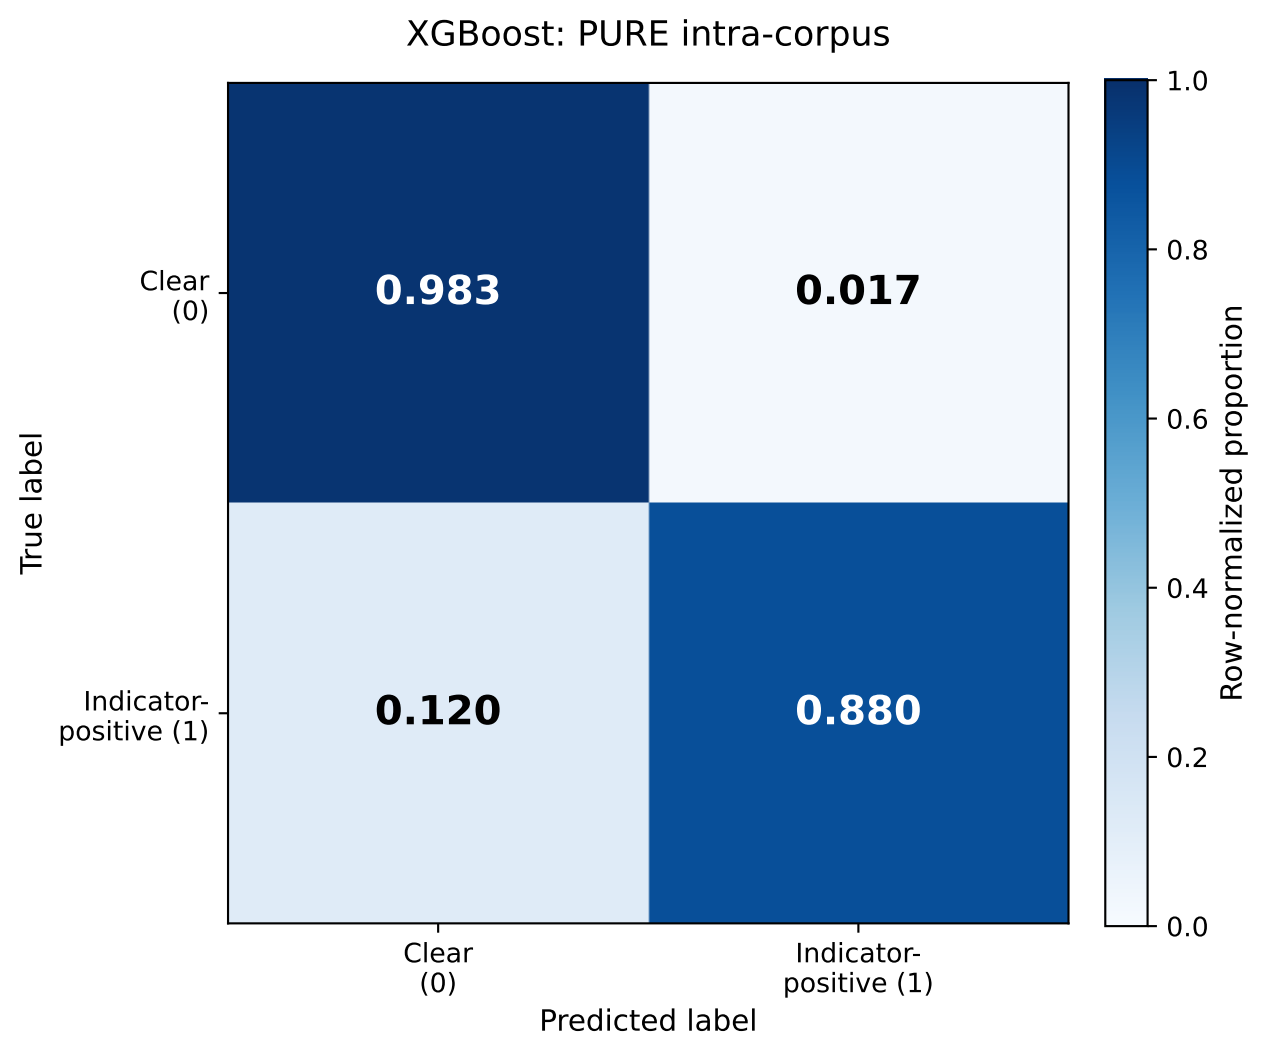
XGBoost: PURE intra-corpus
0.983
0.017
0.120
0.880
Clear (0)
Indicator-positive (1)
True label
Clear (0)
Indicator-positive (1)
Predicted label
Row-normalized proportion
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0