

Laporan Pengujian Sterilisator Kering

No. Label : 365693

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : Puskesmas Abiansema I
2. Merek : My Life
3. Model/Tipe : ZTP80-15
4. No. Seri : -

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat / Ruangan : Ruangan Tindakan
2. Tanggal : 21 Juli 2022

C. Kondisi Ruang

1. Suhu : 24.4 °C
2. Kelembaban Relatif : 58.0 %RH

D. Alat yang Digunakan

1. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N : 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)
2. Temperature Data Logger, Merk : Madgetech, Model/Type : Hi Temp 150, S/N N35106 (Tertelusur melalui LK-032-IDN)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat


Bagian Alat	Fisik	Fungsi	Keterangan
Power Cord	Baik	Baik	-
Switch On Off	Baik	Baik	-
Panel Switch	Baik	Baik	-
Indikator Suhu	Baik	Baik	-
Indikator Tekanan Chamber	Baik	Baik	-
Temperatur Adjuster	Baik	Baik	-
Regulator Tekanan	Baik	Baik	-

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

1. Hasil pengukuran keselamatan listrik tidak dilakukan karena tidak memungkinkan untuk dilakukan pengukuran

G. Hasil Pengukuran Kinerja Autoclave

Setting Alat	Date and Time (UTC+07:00)	Channel 1 Probe Temperature (°C)
Fix	13:17:29	105.90
	13:17:59	105.80
	13:18:29	105.90
	13:18:59	105.80
	13:19:29	105.70
	13:19:59	105.60
	13:20:29	105.50
	13:20:59	105.30
	13:21:29	105.20
	13:22:59	105.10

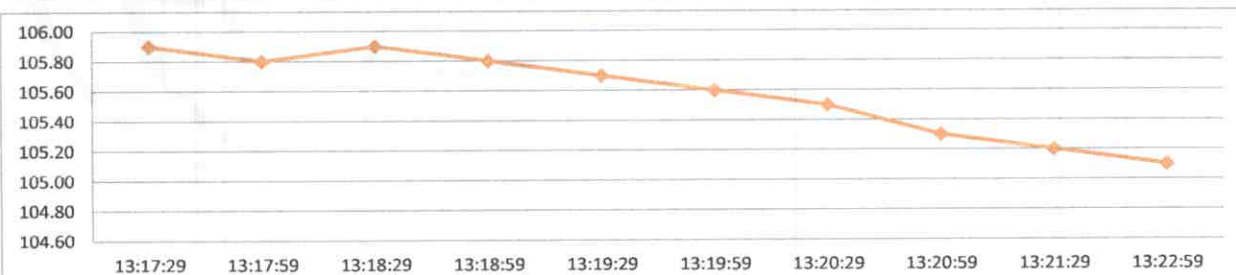

H. Keterangan

1. Alat ini diuji menggunakan metode pengujian MP/UJI/T-02

I. Kesimpulan

1. Berdasarkan MP/UJI/T-02 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : **ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN**

J. Saran

1. Lakukan maintenance dan pengujian ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seijin PT.GPS

Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464

Fax. : (021) 5701468, 5743280