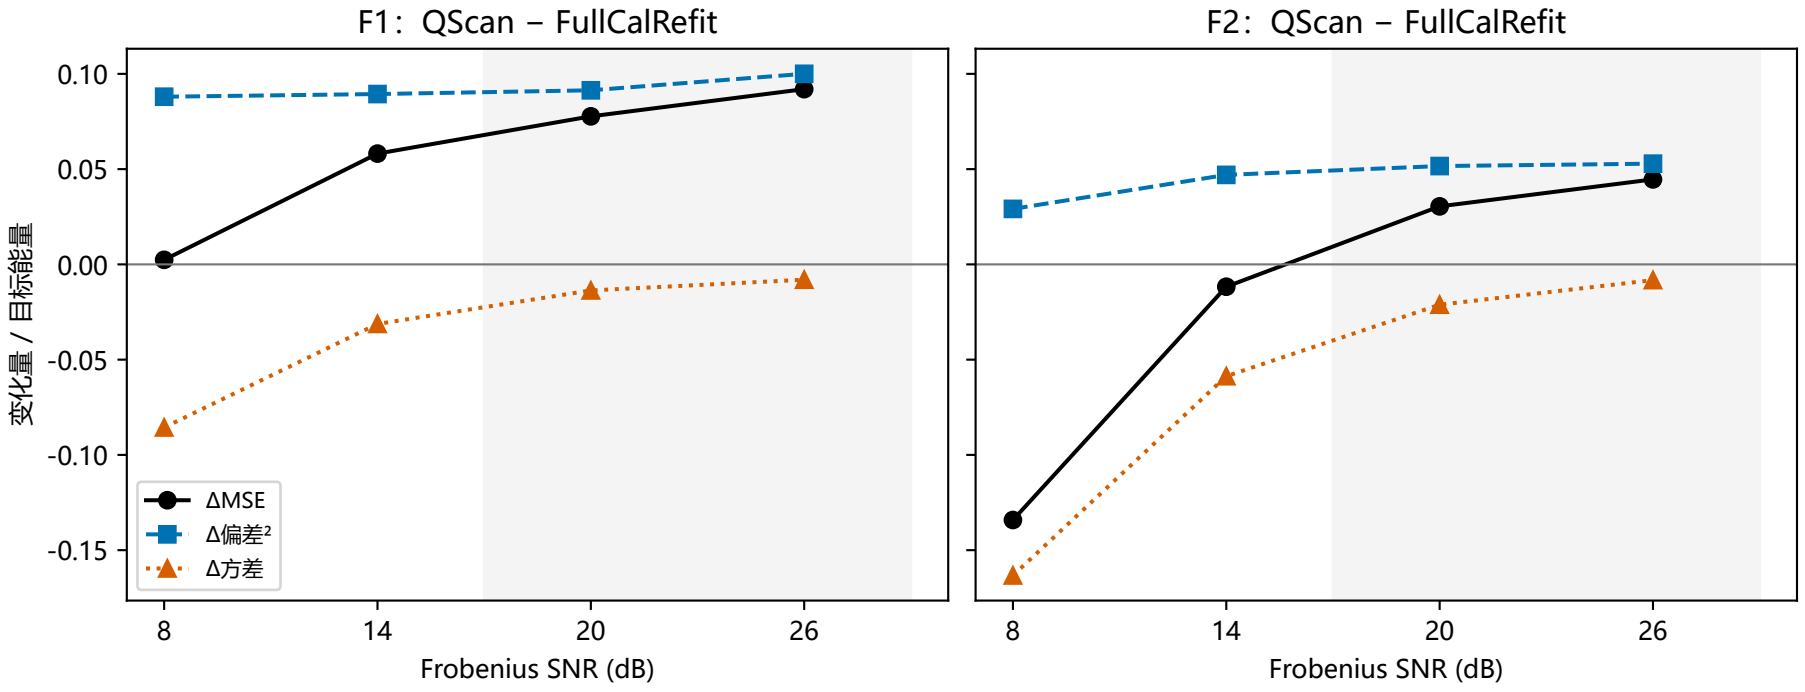
F1：QScan − FullCalRefit
F2：QScan − FullCalRefit
变化量 / 目标能量
0.10
0.05
0.00
-0.05
-0.10
-0.15
ΔMSE
Δ偏差²
Δ方差
8
14
20
26
Frobenius SNR (dB)