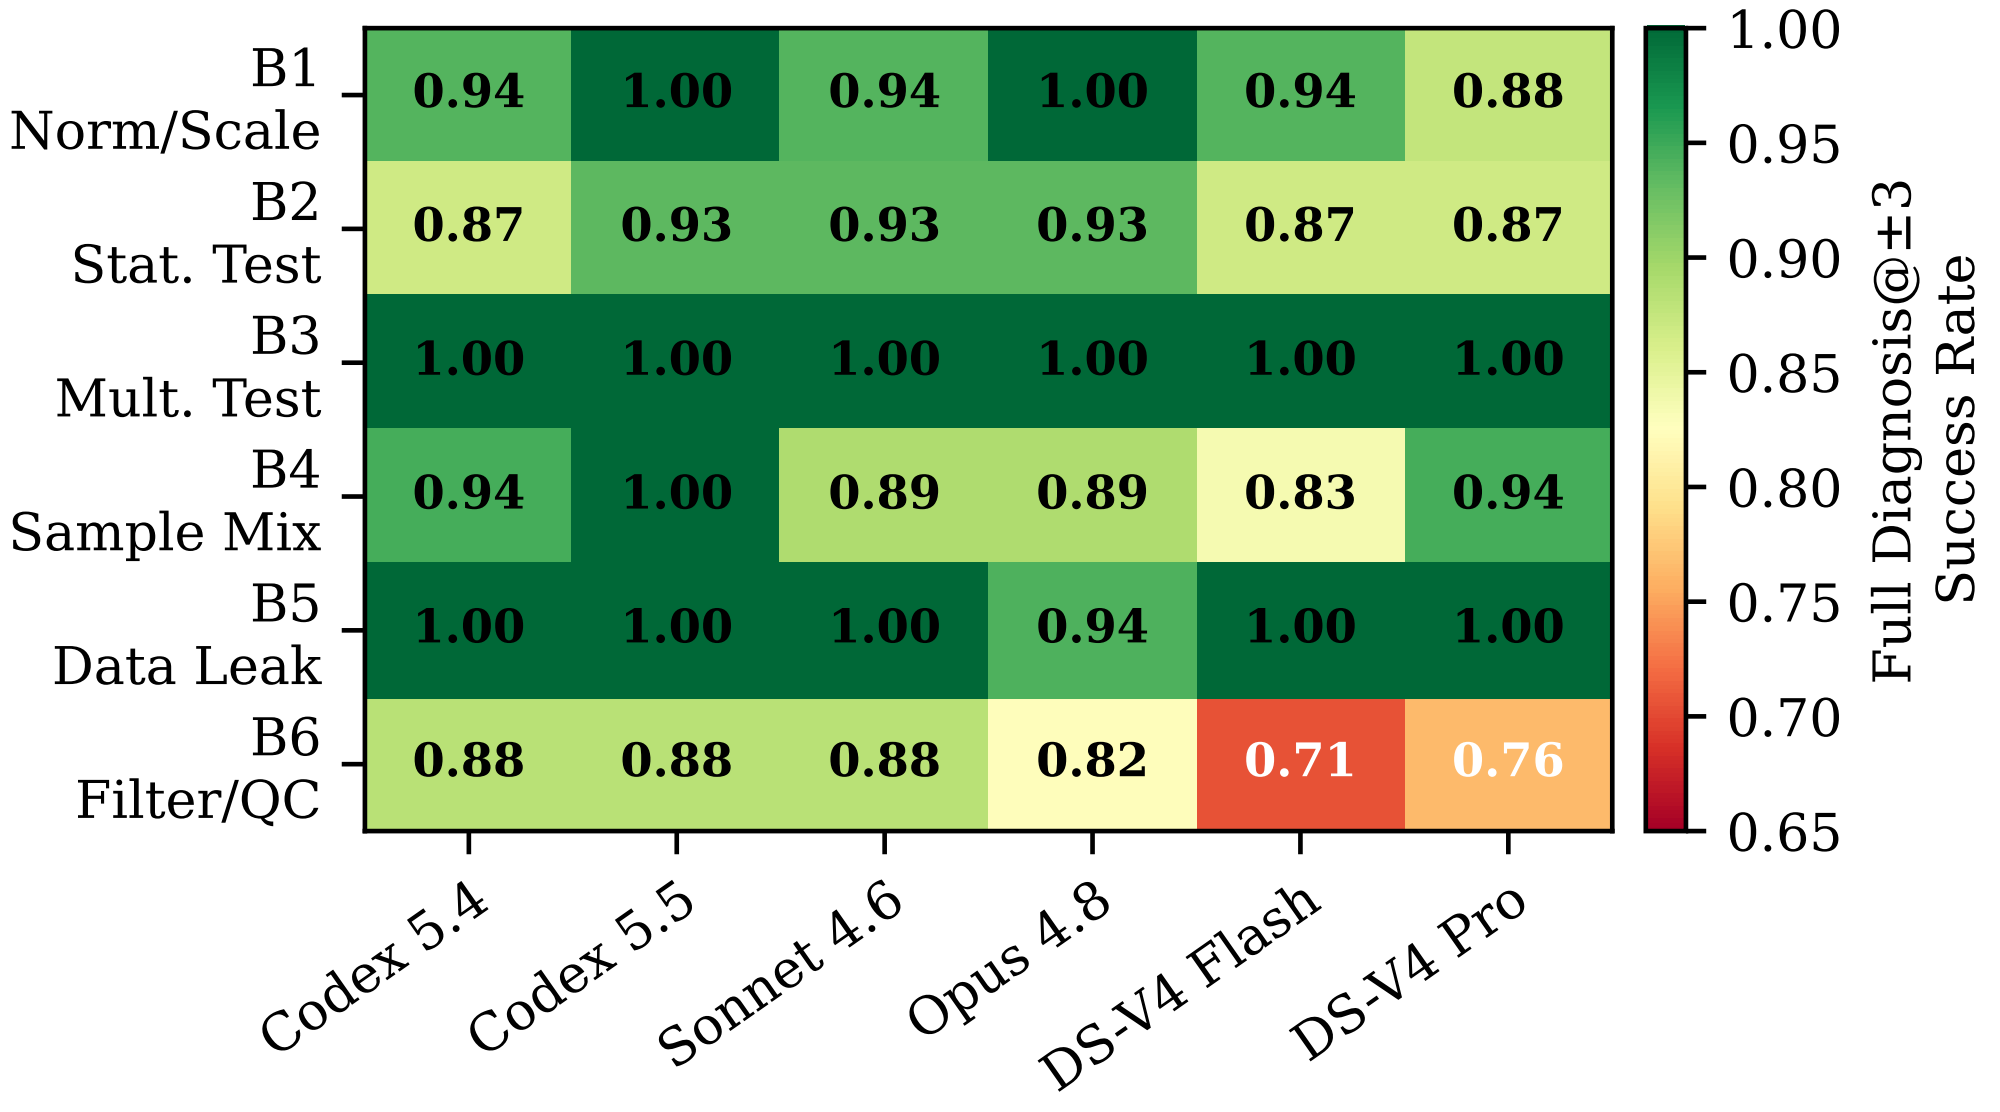
B1
Norm/Scale
B2
Stat. Test
B3
Mult. Test
B4
Sample Mix
B5
Data Leak
B6
Filter/QC
0.94 1.00 0.94 1.00 0.94 0.88
0.87 0.93 0.93 0.93 0.87 0.87
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.94 1.00 0.89 0.89 0.83 0.94
1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00
0.88 0.88 0.88 0.82 0.71 0.76
Codex 5.4
Codex 5.5
Sonnet 4.6
Opus 4.8
DS-V4 Flash
DS-V4 Pro
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
Full Diagnosis@±3
Success Rate