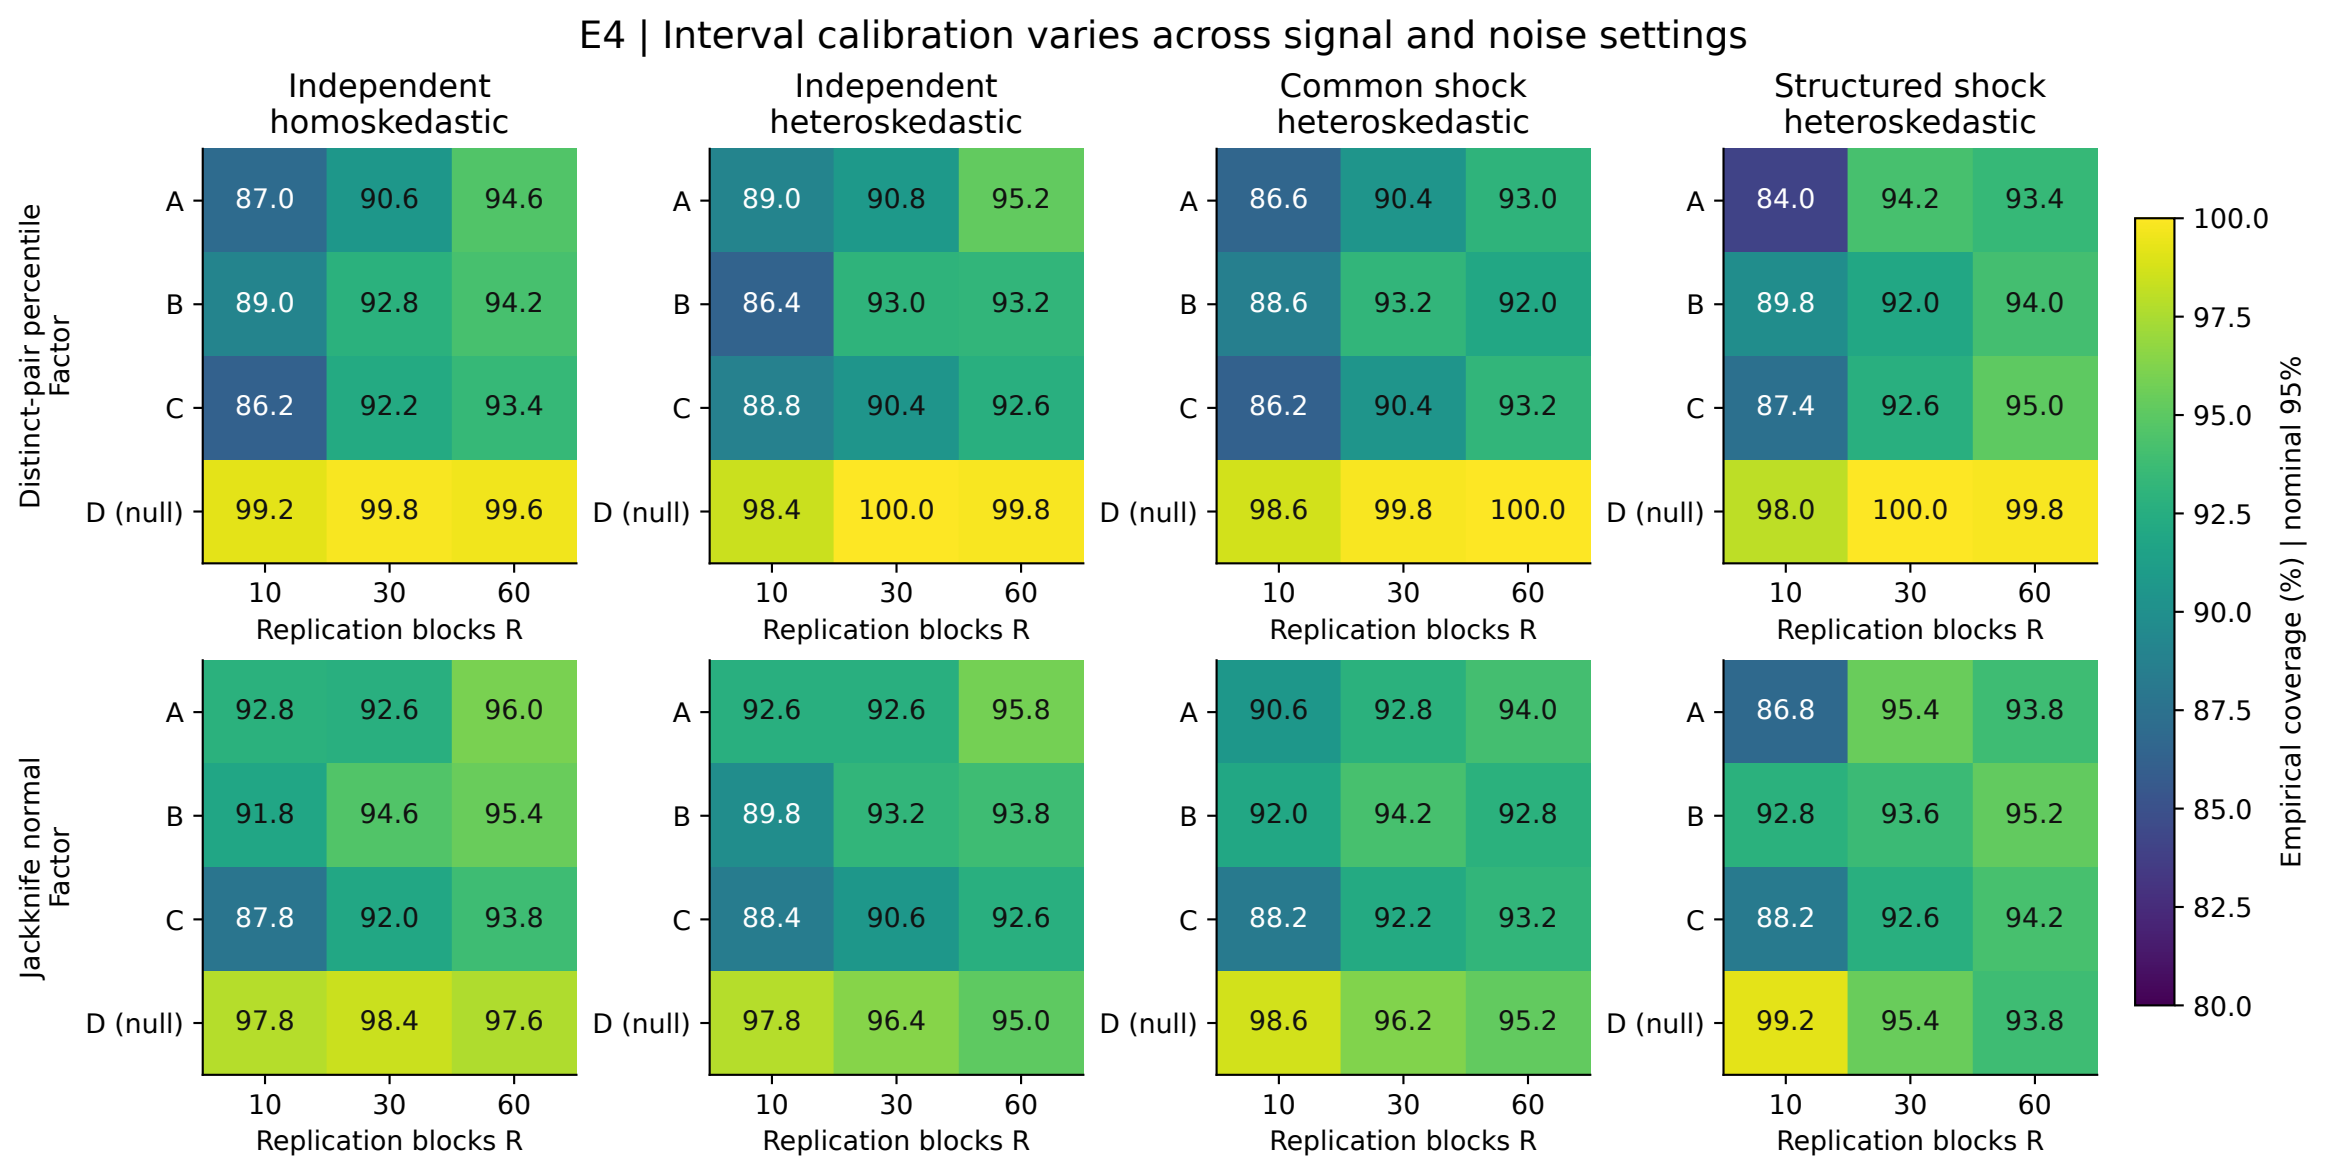
E4 | Interval calibration varies across signal and noise settings
Independent homoskedastic
Independent heteroskedastic
Common shock heteroskedastic
Structured shock heteroskedastic
Distinct-pair percentile Factor
Jackknife normal Factor
A
B
C
D (null)
87.0 90.6 94.6
89.0 92.8 94.2
86.2 92.2 93.4
99.2 99.8 99.6
89.0 90.8 95.2
86.4 93.0 93.2
88.8 90.4 92.6
98.4 100.0 99.8
86.6 90.4 93.0
88.6 93.2 92.0
86.2 90.4 93.2
98.6 99.8 100.0
84.0 94.2 93.4
89.8 92.0 94.0
87.4 92.6 95.0
98.0 100.0 99.8
92.8 92.6 96.0
91.8 94.6 95.4
87.8 92.0 93.8
97.8 98.4 97.6
92.6 92.6 95.8
89.8 93.2 93.8
88.4 90.6 92.6
97.8 96.4 95.0
90.6 92.8 94.0
92.0 94.2 92.8
88.2 92.2 93.2
98.6 96.2 95.2
86.8 95.4 93.8
92.8 93.6 95.2
88.2 92.6 94.2
99.2 95.4 93.8
10 30 60
Replication blocks R
Empirical coverage (%) | nominal 95%
100.0
97.5
95.0
92.5
90.0
87.5
85.0
82.5
80.0