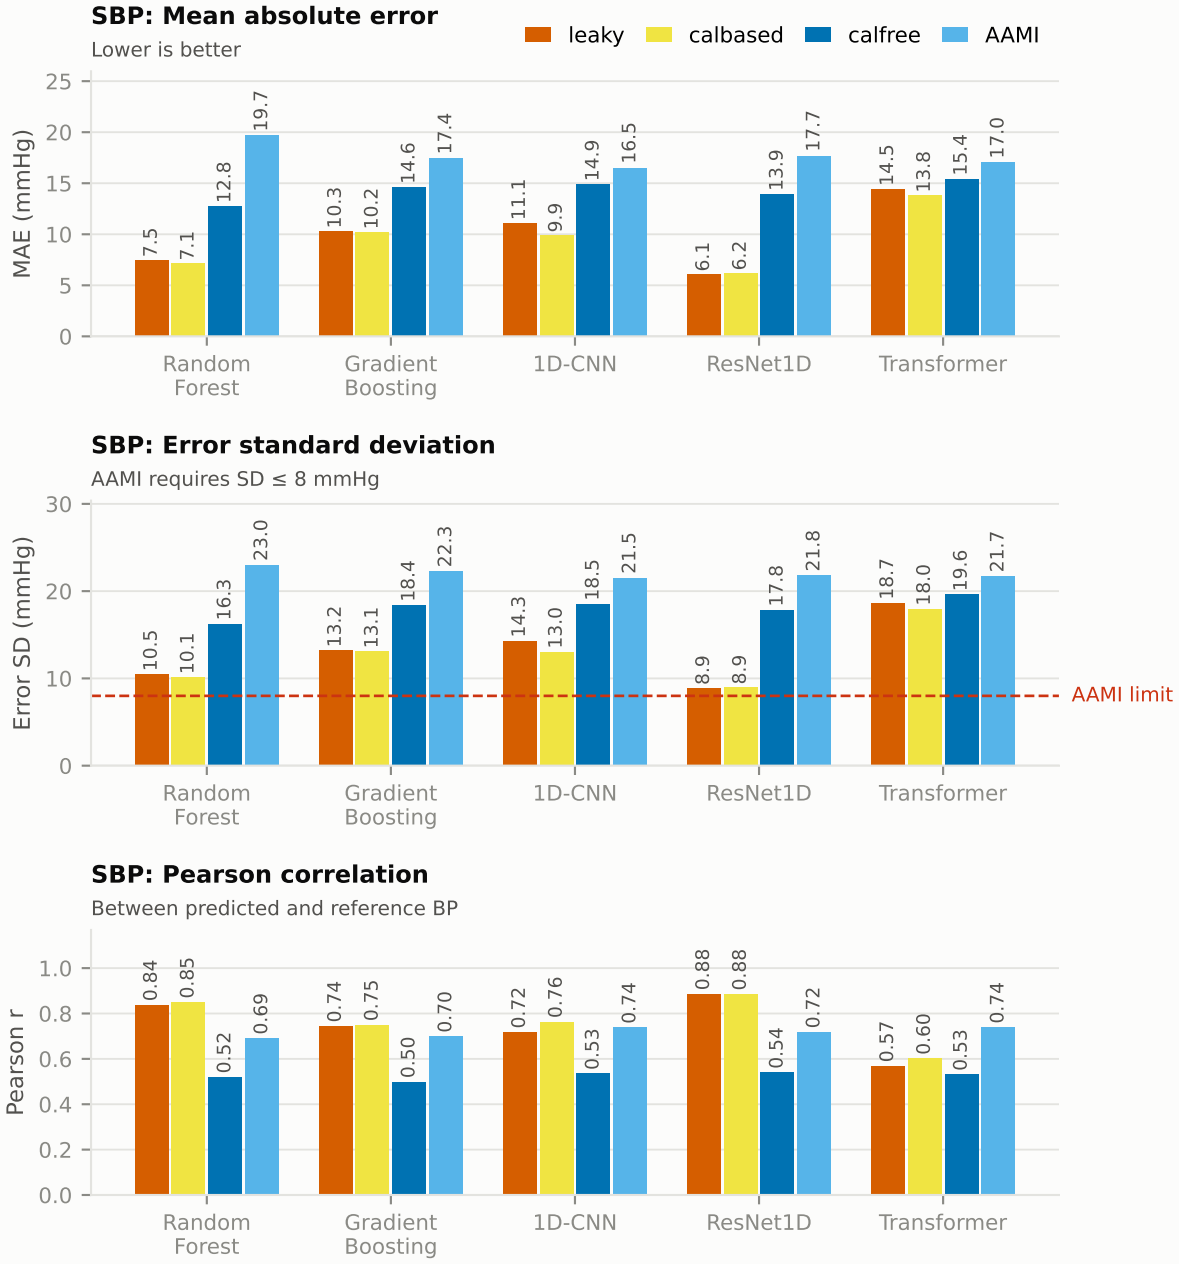
SBP: Mean absolute error
Lower is better
leaky
calbased
calfree
AAMI
MAE (mmHg)
25
20
15
10
5
0
7.5
7.1
12.8
19.7
10.3
10.2
14.6
17.4
11.1
9.9
14.9
16.5
6.1
6.2
13.9
17.7
14.5
13.8
15.4
17.0
Random Forest
Gradient Boosting
1D-CNN
ResNet1D
Transformer
SBP: Error standard deviation
AAMI requires SD ≤ 8 mmHg
Error SD (mmHg)
30
20
10
0
10.5
10.1
16.3
23.0
13.2
13.1
18.4
22.3
14.3
13.0
18.5
21.5
8.9
8.9
17.8
21.8
18.7
18.0
19.6
21.7
AAMI limit
Random Forest
Gradient Boosting
1D-CNN
ResNet1D
Transformer
SBP: Pearson correlation
Between predicted and reference BP
Pearson r
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.84
0.85
0.52
0.69
0.74
0.75
0.50
0.70
0.72
0.76
0.53
0.74
0.88
0.88
0.54
0.72
0.57
0.60
0.53
0.74
Random Forest
Gradient Boosting
1D-CNN
ResNet1D
Transformer